＊ 使用に際してはこの電子添文をよくお読みください。

**2025年 6月改訂（第4版）
＊2024年11月改訂（第3版）

G6C04T

体外診断用医薬品

製造販売認証番号：305AEZX00021000

Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキット

ルミパルス® Ⅳ型コラーゲン·7S

■全般的な注意


1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3. 本書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。

＊5. 洗浄液、基質液および検体希釈液には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

＊6. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせ、各試薬の添付文書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

1. **抗体結合粒子**[注1]**（使用時液状、２５０μＬ／免疫反応カートリッジ）**
抗Ⅳ型コラーゲン・７Ｓモノクローナル抗体(マウス)結合フェライト粒子を含みます。
2. **酵素標識抗体（液状、３２０μＬ／免疫反応カートリッジ）**
アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）標識抗Ⅳ型コラーゲン・７Ｓモノクローナル抗体(マウス)を含みます。

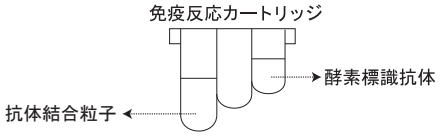

3. **Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータ：２濃度×１**
(1) ０ｎｇ／ｍＬ Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータ（液状、１.５ｍＬ×１）
(2) ８０ｎｇ／ｍＬ Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータ（液状、１.５ｍＬ×１）
4. **基質液（液状、１００ｍＬ×６、５０ｍＬ×６）**
基質としてＡＭＰＰＤ[注2]を含みます。
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
5. **洗浄液（濃縮液、１０００ｍＬ×１）**
6. **検体希釈液（液状、３００ｍＬ×４、８０ｍＬ×４）**
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

注１）１５℃以下の温度ではゲル化しています。
注２）AMPPD：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3"-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt ／ 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3"-ホスホリルオキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン･2ナトリウム塩

■使用目的

血清又は血漿中のⅣ型コラーゲン・７Ｓの測定

■測定原理

本試薬は２ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定法によるⅣ型コラーゲン・７Ｓ測定試薬です[7),8)]。

＜反応プロトコール；２ステップモード＞

試薬・検体のセット

第一反応
抗体結合粒子に結合した抗Ⅳ型コラーゲン・７Ｓモノクローナル抗体（マウス）と検体中に含まれるⅣ型コラーゲン・７Ｓによる免疫複合体が形成されます。
抗体結合粒子２５０μＬ、検体またはⅣ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータ５０μＬが混合されます。反応液は、撹拌後３７℃で１０分間インキュベートされます。

洗浄
反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。
粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液注入、洗浄液の除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

第二反応
抗Ⅳ型コラーゲン・７Ｓモノクローナル抗体（マウス）を介して結合した検体中のⅣ型コラーゲン・７Ｓと、アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）標識抗Ⅳ型コラーゲン・７Ｓモノクローナル抗体（マウス）（酵素標識抗体）による免疫複合体が形成されます。
酵素標識抗体２５０μＬと抗体結合粒子が混合されます。反応液は３７℃で１０分間インキュベートされます。

洗浄
再び反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。
粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液注入、洗浄液の除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

酵素反応
基質液２００μＬを粒子に加え撹拌後、３７℃で５分間反応させます。

測光
＊波長４７７ｎｍに発光極大を持つ光の発光量を測定します。
基質液に含まれるＡＭＰＰＤは、抗体結合粒子に間接的に結合したアルカリホスファターゼの触媒作用により分解します。分解に伴って放出される光は、粒子に結合したⅣ型コラーゲン・７Ｓ量を反映するため、これを測定することによってⅣ型コラーゲン・７Ｓ濃度の測定を行うことができます。

検体中のⅣ型コラーゲン・７Ｓ濃度が測定範囲を超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し、再測定してください。

■操作上の注意

1. **測定検体の性質、採取法**
＊(1) 検体の採取は使用する採血管の電子添文をよく確認し、指定された方法（採血量、遠心分離方法など）により採取してください。
(2) 検体は、血清、血漿いずれでも測定できます。血清検体は、遠心分離を行う前に十分に凝固させてください。
(3) 可能な限り新鮮な検体を用い、血清または血漿検体を保存する場合は、細胞、血餅、分離剤を除去してください。
検体は2～10℃に保存した場合は15日間、－20℃以下に保存した場合は3ヵ月間安定です。
(4) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
(5) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
(6) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
(7) 非働化した検体は使用しないでください。
(8) 検体に抗凝固剤（ＥＤＴＡ－二カリウム、ＥＤＴＡ－二ナトリウム、ヘパリンリチウム、ヘパリンナトリウム、クエン酸ナトリウム）を添加して試験した結果、それぞれ６.４ｍｇ／ｍＬ、６.４ｍｇ／ｍＬ、６９Ｕ／ｍＬ、６９Ｕ／ｍＬ、７.６ｍｇ／ｍＬまで測定値に影響は認められませんでしたが、液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。

2. **妨害物質・妨害薬剤**
検体に以下の物質を添加して試験した結果、記載の濃度まで測定値に影響は認められませんでした。

添加物質	添加濃度
ビリルビンＣ	１９.５ｍｇ／ｄＬ
ビリルビンＦ	２０.４ｍｇ／ｄＬ
ヘモグロビン	４８０ｍｇ／ｄＬ
トリグリセリド	２０００ｍｇ／ｄＬ
総タンパク質	４～１２ｇ／ｄＬ
乳ビ	１７００ホルマジン濁度
リウマトイド因子	６６２ＩＵ／ｍＬ
HAMA	１２１７ｎｇ／ｍＬ

3. **交差反応性**
交差反応性について検討した結果、以下の結果が得られました。

添加物質	添加濃度	交差反応率
ヒトⅠ型コラーゲン	１ μｇ／ｍＬ	１%
ヒトⅡ型コラーゲン	１ μｇ／ｍＬ	０%
ヒトⅢ型コラーゲン	１ μｇ／ｍＬ	０%
ヒトⅣ型コラーゲン(分子全体)	１ μｇ／ｍＬ	１４%
ヒトⅤ型コラーゲン	１ μｇ／ｍＬ	１%
ラミニン	１ μｇ／ｍＬ	０%

*4. その他
本試薬は全自動化学発光酵素免疫測定システム用試薬です。
（代表例：ルミパルス　Ｇ１２００※1）
※1：本製品の製造販売元は富士レビオ株式会社です。

■用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製法
(1) 抗体結合粒子、酵素標識抗体
免疫反応カートリッジには、抗体結合粒子および酵素標識抗体が充填されています。
カートリッジケースの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
・免疫反応カートリッジを取扱う際に、振動を加えたり、逆さまにしたりしないでください。
・免疫反応カートリッジを装置にセットする際は、カートリッジケースの透明フィルムを必ず剥がしてください。剥がし忘れや剥がし残りがある場合、装置の動作異常の原因となります。
・試薬項目および試薬ロットはカートリッジケースのバーコードによって管理されています。カートリッジケース間の免疫反応カートリッジの入れ替えは試薬の誤認識に繋がる可能性がありますので行わないでください。
(2) Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータ
常温（１５～２５℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。
デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要量を滴下します。
・溶液１滴あたりのおよその滴下量は４５μＬです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しい試薬を使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。
・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。
一例としてルミパルス　Ｇ１２００でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは１００μＬとなります。
(3) 基質液
冷蔵庫から出してそのまま使用します。
・基質液の漏れがないように装置にセットしてください。
・基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液の注ぎ足しはしないでください。基質液がアルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
(4) 洗浄液
濃縮液のため精製水で１０倍に希釈し、よく撹拌します。希釈した洗浄液は、常温（１５～２５℃）に戻してから使用します。
(5) 検体希釈液
１５～３０℃に戻してからそのまま使用します。
ルミパルス　Ｇ１２００にセットする場合は、冷蔵庫から出してそのまま使用してください。
2. 必要な器具・器材・試料等
(1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ
(2) 全自動化学発光酵素免疫測定システム
(3) ＬＰコントロール・Ⅳ型コラーゲン・７Ｓ（別売品）
精度管理用試料として、ＬＰコントロール・Ⅳ型コラーゲン・７Ｓを推奨いたします。
使用に際しては、ＬＰコントロール・Ⅳ型コラーゲン・７Ｓの取扱説明書を参照してください。
3. 測定法
(1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。（サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。）
(2) Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータおよび検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
(3) 測定を開始する前に、免疫反応カートリッジ、基質液、洗浄液、検体希釈液、サンプリングチップの残量を確認します。
(4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコール」の項をご参照ください。
4. 濃度の算出法
マスターキャリブレーションデータは、カートリッジケースの２次元バーコードに記録されています。検体中のⅣ型コラーゲン・７Ｓ濃度は、Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータの発光量をもとに較正された検量線から自動的に算出されます。また複数装置をお使いの場合は１台ごとに検量線を作成してください。

Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータの測定は以下の場合に行います。
・免疫反応カートリッジが、新しいロットに切り替わった場合。
・検量線を更新後、３０日が経過した場合。
上記以外においても必要が生じた場合は、Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータを測定し検量線を更新してください。

検体中のⅣ型コラーゲン・７Ｓ濃度が８０.０ｎｇ／ｍＬを超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し、再測定してください。なお、希釈は４０倍希釈までの範囲で行ってください。

■測定結果の判定法

**1. 参考基準値
健常人８５名から血清検体を採取し、ＣＬＳＩガイドラインＥＰ２８－Ａ３ｃ[1]に従い、ロバスト法を用いて測定値の９７.５パーセンタイル値を算出した結果、４.４ｎｇ／ｍＬとなりました。
2. 判定上の注意
(1) 基準値は、測定条件や検体によって異なることがありますので、各施設に適した基準値を設定してください。
(2) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
(3) 自己免疫疾患患者の検体では非特異的な反応がおこる可能性がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。

■臨床的意義

Ⅳ型コラーゲン・７Ｓは基底膜構成成分であるⅣ型コラーゲンのＮ末端ペプチド７Ｓドメインで、蛋白分解酵素の影響を受けにくいため血中では安定しています。正常な肝の類洞中には基底膜は存在しませんが、肝線維化が起こると基底膜構成成分が分泌され沈着し[2),3)]、一部が血中に漏出します。Ⅳ型コラーゲン・７Ｓは肝線維化の比較的早期から血中に増加することが知られています[4),5)]。肝疾患の慢性化に伴い，肝において増生・蓄積される線維化の量を知ることは，疾患の治癒や，予後の判定に極めて重要です。
本試薬は、化学発光基質（ＡＭＰＰＤ）を用いた化学発光酵素免疫測定法[6)]（ＣＬＥＩＡ；chemiluminescent enzyme immunoassay）に基づく試薬です。

■性能

1. 性能
(1) 感度
Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータを所定の操作で測定するとき、Ⅳ型コラーゲン・７Ｓ　キャリブレータによる３ｎｇ／ｍＬの較正値と０ｎｇ／ｍＬ　Ⅳ型コラーゲン・７Ｓキャリブレータの発光量の比は３以上になります。
(2) 正確性
自家管理検体３例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±２０％以内になります。
(3) 同時再現性（併行精度）
自家管理検体３例を所定の操作で６回繰り返し測定するとき、測定値の変動係数（ＣＶ値）は１０％以下になります。
(4) 測定範囲
本試薬の測定範囲は１.０～８０.０ｎｇ／ｍＬです。
(5) 検出限界
ＣＬＳＩガイドラインＥＰ１７－Ａ２[9)]に従って検出限界（ＬｏＤ）の算出を行った結果、値は０.０９４ｎｇ／ｍＬとなりました。
(6) 定量限界
ＣＬＳＩガイドラインＥＰ１７－Ａ２[9)]に従って定量限界（ＬｏＱ）の算出を行った結果、値は０.３９４ｎｇ／ｍＬとなりました。
(7) 血清検体と血漿検体の相関性に関する試験成績
① 同一人から採取した血清・血漿ペア検体７０例（抗凝固剤：ヘパリンリチウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝７０
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝１.００ｘ－３.０
（ｘ：血清、ｙ：ヘパリンリチウム血漿）
② 同一人から採取した血清・血漿ペア検体７０例（抗凝固剤：ヘパリンナトリウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝７０
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝０.９９ｘ－０.３
（ｘ：血清、ｙ：ヘパリンナトリウム血漿）
③ 同一人から採取した血清・血漿ペア検体７０例（抗凝固剤：ＥＤＴＡ－二カリウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に 示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝７０
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝０.９９ｘ－０.３
（ｘ：血清、ｙ：ＥＤＴＡ－二カリウム血漿）
④ 同一人から採取した血清・血漿ペア検体７０例（抗凝固剤：ＥＤＴＡ－二ナトリウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝７０
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝１.００ｘ＋０.２
（ｘ：血清、ｙ：ＥＤＴＡ－二ナトリウム血漿）
⑤ 同一人から採取した血清・血漿ペア検体７０例（抗凝固剤：クエン酸ナトリウム）を使用し、本試薬にて測定値を比較検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝７０
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝０.９９ｘ－０.６
（ｘ：血清、ｙ：クエン酸ナトリウム血漿）

2. **相関性試験成績**
血清検体１２３例を使用し、既存体外診断用医薬品（ルミパルスプレスト試薬）との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝１２３
相関係数：ｒ＝０.９７
回帰式　：ｙ＝０.９７ｘ
（ｘ：ルミパルスプレスト試薬、ｙ：本品）

3. **較正用の基準物質（標準物質）**
社内調製品

■使用上又は取扱い上の注意

1. **取扱い上（危険防止）の注意**
(1) 検体はＨＩＶ、ＨＢＶ、ＨＣＶ等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
(2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。
(3) 基質液はアルカリ性溶液（ｐＨ１０）です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入らないように注意してください。
(4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. **使用上の注意**
*(1) 使用に際しては本書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書に従ってください。
(2) 免疫反応カートリッジ（抗体結合粒子・酵素標識抗体）、IV型コラーゲン・７Ｓキャリブレータ、基質液、洗浄液および検体希釈液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせて使用してください。
(3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
(4) サンプリングチップ、サンプルカップは、使用する測定システム指定のものを使用してください。
(5) サンプリングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
(6) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
(7) 保管に冷蔵庫をご使用の場合、庫内のファンからの風が直接あたる場所および庫内最下部での保管は、温度変化により水分蒸発の原因となりますので避けてください。
(8) 検体およびIV型コラーゲン・７Ｓキャリブレータは蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
(9) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
(10) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップパッキンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップパッキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. **廃棄上の注意**
(1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。また、酸と反応して有毒性のガスを発生する恐れがありますので、酸との接触を避けて廃棄してください。
洗浄液：１.０％（希釈調製前）、基質液：０.０５％、検体希釈液：０.１％
(2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
(3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
(4) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度１０００ｐｐｍ、１時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（２％、１時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（１２１℃、２０分以上）による滅菌処理を行ってください。
(5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度１０００ｐｐｍ、１時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（２％、１時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。
(6) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタールアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

■貯蔵方法・有効期間

抗体結合粒子	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
酵素標識抗体	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
IV型コラーゲン・７Ｓキャリブレータ	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
基質液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
洗浄液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
検体希釈液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

*■包装単位

個別包装
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

コードＮｏ.	品名	包装
２６１５６９	ルミパルス　IV型コラーゲン・７Ｓ 免疫反応カートリッジ （抗体結合粒子・酵素標識抗体）	１４テスト×３
２６１５７６	ルミパルス　IV型コラーゲン・７Ｓ IV型コラーゲン・７Sキャリブレータ	２濃度×１ （各１.５mL×１）
２１９９７３	ルミパルス　基質液（共通試薬）※2	１００mL×６
２９２６００	ルミパルス　基質液（共通試薬）※2	５０mL×６
２１９９４２	ルミパルス　洗浄液（共通試薬）※2	１０００mL×１
２１９９３５	ルミパルス　検体希釈液（共通試薬）※2	３００mL×４
２９２６１７	ルミパルス　検体希釈液（共通試薬）※2	８０mL×４

その他

コードＮｏ.	品名	包装
２６００５０	ＬＰコントロール・IV型コラーゲン・７Ｓ※3	２濃度×２ （各１.５mL×２）

※２：これらの製品の製造販売元は富士レビオ株式会社です。
※３：富士レビオ株式会社が製造・発売する製品です。

■主要文献

*1) Clinical and Laboratory Standards Institute. Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline-Third Edition. CLSI Document EP28-A3c.
2) Hahn E, et al. Distribution of basement membrane proteins in normal and fibrotic human liver: collagen type IV, laminin, and fibronectin. Gut 1980; 21: 63-71
3) Murawaki Y, et al. Serum type III procollagen peptide, type IV collagen 7S domain, central triple-helix of type IV collagen and tissue inhibitor of metalloproteinases in patients with chronic viral liver disease: relationship to liver histology. Hepatology 1994; 20: 780-787.
4) Yoneda M, et al. Type IV collagen 7s domain is an independent clinical marker of the severity of fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis before the cirrhotic stage. J Gastroenterol 2007; 42: 375-381
5) 豊田　秀徳　他、『肝線維化・脂肪化診断の進歩と将来展望』肝線維化の血清マーカー、肝臓　２０１８、５９巻８号：377-383
6) Nishizono I, et al. Rapid and Sensitive Chemiluminescent Enzyme Immunoassay for Measuring Tumor Markers. Clin Chem, 37: 1639-1644, 1991.
7) 大高木　結媛　他、サンドイッチ法を用いた新規高感度IV型コラーゲン・７S測定試薬（ルミパルスプレスト®IV型コラーゲン・７S）の基礎性能評価、医学と薬学　２０２０、７７巻５号:785-792
8) 大高木　結媛　他、小型全自動機器向け高感度IV型コラーゲン・７S測定試薬（ルミパルス®IV型コラーゲン・７S）の基礎性能、医学と薬学２０２４、８１巻７号:391-397
9) Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document EP17-A2.

■問い合わせ先

富士レビオ株式会社　お客様コールセンター
TEL：0120-292-832

■製造販売元

株式会社先端生命科学研究所
東京都八王子市小宮町１５３番地　富士レビオ研究開発センター

株式会社 先端生命科学研究所

■販売元

富士レビオ株式会社
東京都港区赤坂１-８-１

富士レビオ株式会社