

* ご使用の際は、電子化された添付文書をよくお読みください

リン脂質キット
PL オート「TBA」
(酵素法)

【全般的な注意】

1. 本品は、体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないでください。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断してください。
- * 3. 電子化された添付文書以外の使用方法については、測定値の信頼性を保証致しません。
- * 4. 使用する機器の電子化された添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。

【形状・構造等(キットの構成)】


1. 酵素液-1 (R-1)
ホスホリバーゼD (PLD)
N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシ
アニリン (HDAOS)
グッド緩衝液
2. 酵素液-2 (R-2)
コリンオキシダーゼ
ペルオキシダーゼ (POD)
4-アミノアンチピリン (4-AA)
グッド緩衝液

【使用目的】

血清中のリン脂質の測定

【測定原理】

試料中のリン脂質(PL)は、PLDの作用によりコリンとホスファチジン酸に加水分解されます。生成したコリンにコリンオキシダーゼが作用し、過酸化水素が生成します。生成した過酸化水素は、PODの存在下で4-AAとHDAOSとの酸化縮合反応により、キノン色素を生成します。この生成物を吸光度変化としてとらえたとき、その変化量はPL濃度に比例しますので、既知濃度の標準を用いて作成した検量線から試料中のPL濃度を求めます¹⁾。

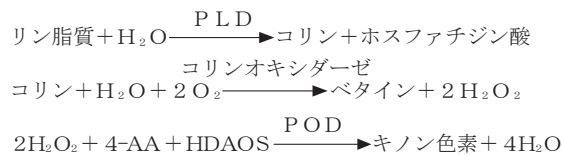

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取法
 - 1) 検体は、血清を使用します。
 - 2) 血清を採取する場合は、血液が完全に凝固した後遠心分離してください。
 - 3) 採取後の検体は速やかに測定してください。
2. 妨害物質・妨害薬剤
アスコルビン酸は50mg/dL、ヘモグロビンは500mg/dL、ビリルビンは30mg/dLまでは、測定値に影響は見られませんでした。

【用法・用量(操作方法)】

1. 試薬の調製
酵素液-1 (R-1) : そのまま使用します。
開栓の状態では、2~10℃保存で1箇月間以内に使用してください。
酵素液-2 (R-2) : そのまま使用します。
開栓の状態では、2~10℃保存で1箇月間以内に使用してください。

2. 測定操作

自動分析装置の操作法に従って、指定のパラメータを入力して測定を行います。

(測定条件の例)

試料	:	2.0 μL
R-1	:	180 μL
R-2	:	60 μL
波長	:	600nm

自動分析装置では、指定のパラメータに従い試料及びR-1、R-2が自動的に採取され、反応管内に順次加えられます。反応管内で生じた反応は吸光度で測定されます。あらかじめ作成された検量線と指定の演算法により吸光度から測定値が算出されます。

指定のパラメータについては問い合わせ先まで請求してください。

検量線を作成する際は、別売の脂質キャリブレーション「TBA」を使用してください。

【測定結果の判定法】

各検査施設で基準範囲を設定することが推奨されます。一般的な参考基準範囲として、以下の文献報告があります。参考基準範囲²⁾ 145~257mg/dL

「判定上の注意」

- 1) 検体によっては、まれに目的成分以外との反応や反応の妨害等により正しい結果が得られない場合があります。測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈試験により確認してください。
- 2) 非常に濃度の高い検体の場合、試薬性能の測定範囲の上限を超えることがあります。その際は、検体を適宜生理食塩液で希釈した後、再度測定してください。

【臨床的意義】

PLはレシチン、スフィンゴミエリン、セファリン及びリゾレシチンから成り、生体内で細胞膜の構成、脂肪の乳化吸収、血液凝固、酸-塩基平衡、コリン代謝など重要な機能に関与しています。

血清PLは各種の脂質代謝異常によって増減します。血清PLは、コレステロールと平行して変動する 경우가多く、閉塞性黄疸の鑑別や経過観察の参考となります³⁾。

【性能】

1. 性能
 - 1) 感度
 - (1) 精製水を試料として操作した場合の吸光度は、0.050Abs.以下です。
 - (2) PL濃度200mg/dLの管理用検体を試料として操作した場合の吸光度は、0.330~0.460Abs.の範囲内です。
 - 2) 正確性
既知濃度の管理用試料を測定するとき、既知濃度の±5%以内です。

- 3) 同時再現性
管理用試料を10回同時に測定するとき、その変動係数(CV)値は、2%以下です。
 - 4) 測定範囲
測定範囲は、3～1 000mg/dLです。
2. 相関性
本法(y)と既承認品(x)との間で血清を測定したところ、下記の結果が得られました。
n = 58, r = 0.999, y = -3.8 + 1.008 x

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上(危険防止)の注意
 - 1) 試料(検体)はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋、マスクなどを着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。
 - 2) 本品が、誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
2. 使用上の注意
 - 1) 本品は、記載された操作法に従って使用してください。記載された操作法及び使用目的以外での使用については、測定値の信頼性を保証致しかねます。
 - 2) 自動分析装置に使用する場合、使用の前に当該自動分析装置の取扱説明書を熟読し、詳細は機器メーカーにお問い合わせください。また、自動分析装置は使用前に洗浄するなど、十分に調整してください。
なお、測定条件(パラメータ)の詳細については下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
 - 3) 本品は、指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
 - 4) 同一製造番号の試薬であっても試薬を注ぎ足すことは行わないでください。
 - 5) 開封後の試薬については汚染等に注意し、十分な精度管理のもとで使用してください。なお、管理用試料の値が精度管理範囲を超えた場合は、検量線を作成し直す等の処置を行ってください。
3. 廃棄上の注意
 - 1) 試料(検体)、使用済みの容器及び検査に使用したすべての器具類は、次のいずれかの方法で滅菌処理を行ってください。
 - (1)最終濃度3.5vol%グルタルアルデヒド溶液に、30分間以上浸漬する。
 - (2)0.5w/v%次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素5 000ppm)に、1時間以上浸漬する。
 - (3)121℃で、20分間以上高圧蒸気滅菌をする。
 - 2) 構成試薬中の酵素液－2は、アジ化ナトリウムを0.05w/v%含んでいます。アジ化ナトリウムは、鉛や銅と反応して爆発性のある重金属アジ化物を生成することがありますので、大量の水とともに廃棄してください。
 - 3) 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

- 1) 貯蔵方法 遮光して2～10℃に保存
- 2) 有効期間 1年
(外箱、ラベルに表示の使用期限内に使用してください。)

【包装単位】

PL オート「TBA」

コードNo.	包 装		
812910	酵素液－1	R-1	80mL×4
812927	酵素液－2	R-2	60mL×2

別売品
脂質キャリブレータ「TBA」

コードNo.	包 装	
840203	脂質キャリブレータ「TBA」	1mL用×5

【主要文献】

- 1) 野間昭夫：リン脂質，臨床検査，22(11)，1314(1978)。
- 2) 鈴木 博：リン脂質とその分画，日本臨床，750，45(1999)。
- 3) 金井正光編：リン脂質，臨床検査法提要，32，545(2005)。

***【問い合わせ先】

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
営業本部 検体検査システム営業部
〒212-0015 神奈川県川崎市幸区柳町70-1
TEL：044-520-2074

製造販売元

デンカ株式会社

新潟県五泉市木越字鏡田1359番地1

発売元

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

栃木県大田原市下石上1385番地