

トランスフェリンキット

免疫学的便中トランスフェリン測定用

ネスコート® トランスフェリン Plus

金コロイド比色法

この添付文書をよく読んでから使用して下さい。

【全般的な注意】

1. 本製品は、体外診断用でありそれ以外の目的に使用しないで下さい。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断して下さい。
3. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 使用する機器の添付文書及び取扱い説明書をよく読んでから使用して下さい。
5. 本製品には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入れたり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。

【形状・構造等(キットの構成)】

R1緩衝液	43mL
緩衝剤他	
R2金コロイド液	13mL
金コロイド標識抗ヒトトランスフェリンポリクローナル抗体(ウサギ)	333μL/mL

【使用目的】

糞便中のトランスフェリンの測定

【測定原理】

金コロイド標識抗ヒトトランスフェリンポリクローナル抗体(ウサギ)を糞便中のヒトトランスフェリンと反応させると、抗原抗体反応により金コロイド粒子が凝集して色調変化を生じます。この色調の一定時間の変化を光学的に測定することにより、糞便中のヒトトランスフェリン量を測定します。

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質

- 1) 糞便は新鮮なものを使用して下さい。
- 2) 糞便は指定の採便容器(採便容器A: 弊社取扱い)に採取して溶解し、検体として下さい。
- 3) 被検測定試料は採便後すみやかに検査を実施して下さい。
測定試料をやむを得ず保管する場合は冷所保存(2~8℃)して下さい。
- 4) 測定範囲の上限を超える検体は、ネスコートヘモPlus検体希釈液(弊社取扱い)で希釈した後、再測定して下さい。
- 5) 生理中又は痔疾患による出血がある場合は検体として適していません。

2. 試料の採取法

採便は便の表面をスティックで4~5ヶ所まんべんなくこすり、溝に付着させます。次にスティックを一回だけ採便容器に差し込み、しっかり締めます。詳細は採便容器Aの説明書を参照して下さい。

3. 妨害物質など

- 1) ビリルビン(20μg/mL)、アスコルビン酸(100μg/mL)、グルコース(100μg/mL)、BSA(100μg/mL)、ペルオキシダーゼ(100μg/mL)、硫酸バリウム(1,000μg/mL)で影響がありません。
- 2) ヒト以外の動物トランスフェリン(ウシ、ブタ、トリ、ウマ、ウサギ)とはほとんど反応しません。

【用法・用量(操作方法)】

1. 使用液の調製方法

- 1) R1緩衝液 : そのまま使用します。
開封後は密封冷蔵保存(2~8℃)し、1ヶ月以内に使用して下さい。
- 2) R2金コロイド液 : そのまま使用します。
開封後は密封冷蔵保存(2~8℃)し、1ヶ月以内に使用して下さい。また測定前に十分転倒混和して下さい。

2. 操作方法

1) 検体の準備

- (1) 採便容器A(弊社取扱い)を用いて糞便を採取して下さい。詳細は採便容器Aの説明書を参照して下さい。
- (2) よく振とうしてスティックの溝に付着した便を溶解し、検体とします。

2) 測定

- (1) 検体12μLにR1緩衝液130μLを加え、この液にR2金コロイド液40μLを加えて混和し、反応開始1分後と約6.6分後に主波長450~570nm、副波長600~700nmでの吸光度を測定し、2点間の吸光度変化量を求めます。(ヘモテクトNS-Plus Cで測定する場合は、別途お問い合わせ下さい)
- (2) ネスコートトランスフェリンPlus標準(弊社取扱い)を検体と同様に操作し、標準曲線を作成します。これと検体の吸光度変化量を比較して検体中のトランスフェリン濃度を算出します。

【測定結果の判定法】

参考正常値: 50ng/mL(10μg/g便に相当)未満(社内データ)

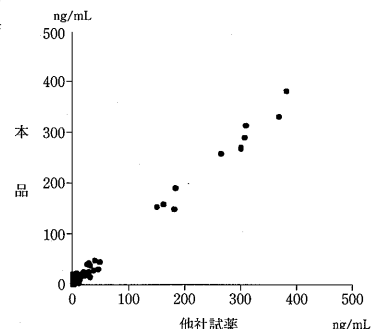
【性能】

1. 感 度 : トランスフェリン0ng/mLの1分間当たりの吸光度変化量は0.030以下
トランスフェリン50ng/mLと0ng/mLの1分間当たりの吸光度変化量の差は0.030~0.100
2. 正 確 性 : 既知濃度の管理用試料を測定する場合、既知濃度の100±15%の範囲内
3. 再現性(同時) : n=6 C.V.=15%以下
4. 測定範囲 : 5~500ng/mL
5. 相 関 性 :

本品(y)と他社試薬(x)との相関

例 数 : n=124

相関係数 : r=0.995

回 帰 式 : $y=0.929x+3.4$ 

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 検体中にはHBV、HCV、HIV、細菌等の病原体が存在する可能性がありますので、感染予防のため取扱いに注意して下さい。また、検体に接触した器具、試薬及び試薬容器等は感染の危険性があるものとして廃棄物処理法等に従い適切な処理を実施して下さい。
2. 試薬は貯蔵方法に従って保存し、使用期限の過ぎたものは使用しないで下さい。
3. 標準及び検体希釈液は、指定の製品を使用して下さい。他の製品を使用した場合、測定値に影響を及ぼします。
4. R2金コロイド液は保存中、金コロイドが沈殿する可能性がありますので、必ずよく転倒混和した後に使用して下さい。
5. R1緩衝液とR2金コロイド液は、必ず同じ製造番号のものを組み合わせて使用して下さい。異なる製造番号の試薬を混合して使用しないで下さい。また、製造番号が同じであっても異なるボトルの試薬どうしを混合しないで下さい。
6. 試薬容器、付属品等は当検査以外の目的に転用しないで下さい。

ネスコート® トランスフェリン Plus

7. 廃棄上の注意

- 1) R2金コロイド液には、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム銅(II) 0.2g/L(銅として27mg/L)を含有しますので、廃液は水質汚濁防止法(銅含有量許容限度：3mg/L)等関連法規に従って処理して下さい。
- 2) 本品には、アジ化ナトリウムが含まれており、鉛、銅等の重金属と反応して、爆発性のアジ化物を形成することがあります。廃棄するときは、アジ化物が形成されないように大量の水で洗い流して下さい。
- 3) 試薬及び容器等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法：2～8℃保存
2. 有効期間：1年
(使用期限は外装等に記載)

※【包装単位】

600回
2400回

【主要文献】

1. 内田壱夫，他：新しい免疫学的便潜血反応—ヘモグロビン，トランスフェリン同時測定. 臨床病理，**37**(1)，58，1989.
2. 三好博文，他：免疫学的便潜血検査における糞便中ヘモグロビン，トランスフェリン同時測定の有用性. 日消集検誌，**83**(6)，97，1989.

【問い合わせ先】

アルフレッサ ファーマ株式会社
〒540-8575 大阪市中央区石町二丁目2番9号
TEL 06-6941-0308 FAX 06-6941-4861

alfresa
製造 販売元 アルフレッサ ファーマ株式会社
大阪市中央区石町二丁目2番9号
TEL 06-6941-0308

®登録商標