

****使用に際してはこの電子添文をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。**

F 9 B 0 5 T

**2022年 8月改訂 (第5版)

*2020年 3月改訂 (第4版)

体外診断用医薬品

製造販売届出番号：13E1X80001000029

バンコマイシンキット


ルミパルス® バンコマイシン

■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3. 本書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
5. 本試薬の洗浄液、基質液および検体希釈液には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
- **6. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせ、各試薬の添付文書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

1. 抗体結合粒子^{注1)}（使用時液状、250μL/免疫反応カートリッジ）
抗バンコマイシンモノクローナル抗体（マウス）結合フェライト粒子を含みます。
2. 酵素標識抗原（液状、120μL/免疫反応カートリッジ）
アルカリホスファターゼ（ALP）標識バンコマイシンを含みます。



3. バンコマイシンキャリブレーション：3濃度×1
(1) 0μg/mL バンコマイシンキャリブレーション (液状、1.5mL×1)
(2) 3μg/mL バンコマイシンキャリブレーション (液状、1.5mL×1)
(3) 100μg/mL バンコマイシンキャリブレーション (液状、1.5mL×1)
4. 基質液（液状、100mL×6、50mL×6）
基質としてAMPDP^{注2)}を含みます。
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
5. 洗浄液（濃縮液、1000mL×1）
6. 検体希釈液（液状、300mL×4、80mL×4）
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

注1) 15℃以下の温度ではゲル化しています。

注2) AMPDP：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3''-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3''-ホスホリルオキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・2ナトリウム塩


■使用目的

血清又は血漿中のバンコマイシンの測定

■測定原理

本試薬は1ステップ競合法に基づいた化学発光酵素免疫測定法によるバンコマイシン測定試薬です。

<反応プロトコール；1ステップモード>

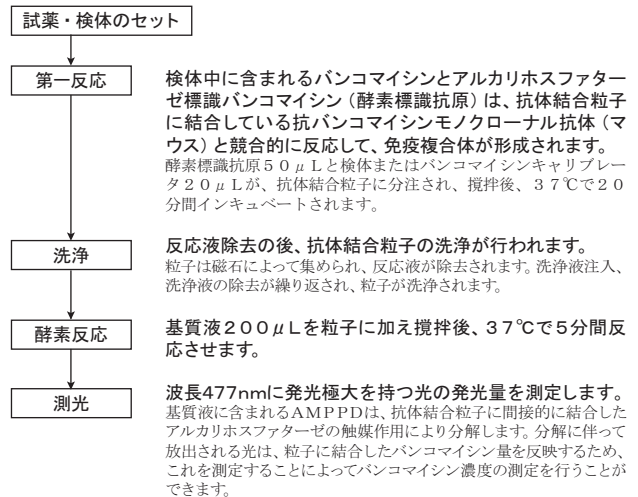

検体中のバンコマイシン濃度が測定範囲を超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し、再測定してください。

■操作上の注意

1. 測定検体の性質、採取法

- ** (1) 検体の採取は使用する採血管の電子添文をよく確認し、指定された方法（採血量、遠心分離方法など）により採取してください。
- (2) 検体は、血清、血漿いずれでも測定できます。
 - (3) 可能な限り新鮮な検体を用い、保存する場合は-20℃以下で凍結保存し、検体融解後はすみやかに測定してください。
 - (4) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
 - (5) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後で使用してください。
 - (6) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
 - (7) 非働化した検体は使用しないでください。
 - (8) 検体に抗凝固剤（EDTA-二ナトリウム、EDTA-二ナトリウム、ヘパリンナトリウム、ヘパリンリチウム）を添加して試験した結果、それぞれ6.4mg/mL、6.4mg/mL、6.9U/mL、6.9U/mLまで測定値に影響は認められませんが、液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

検体にビリルビンF、ビリルビンC、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ18.8mg/dL、20.7mg/dL、480mg/dLまで、測定値に影響は認められませんでした。また、乳ビは1620ホルマジン濁度、トリグリセリドは2000mg/dL、リウマトイド因子は806IU/mL、HAMAは1117ng/mLまで、タンパク質は4~12g/dLの範囲で測定値に影響は認められませんでした。

3. その他

本試薬は全自動化学発光酵素免疫測定システム（代表例：ルミパルス G1200）用試薬です。

■用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製法

- (1) 抗体結合粒子および酵素標識抗原
免疫反応カートリッジには抗体結合粒子および酵素標識抗原が充填されています。カートリッジケースの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
 - ・免疫反応カートリッジを取扱う際に、振動を加えたり、逆さまにしたりしないでください。
 - ・免疫反応カートリッジを装置にセットする際は、カートリッジケースの透明フィルムを必ず剥がしてください。剥がし忘れや剥がし残りがある場合、装置の動作異常の原因となります。
 - ・試薬項目および試薬ロットはカートリッジケースのバーコードによって管理されています。カートリッジケース間の免疫反応カートリッジの入れ替えは試薬の誤認識に繋がる可能性がありますので行わないでください。
- (2) バンコマイシンキャリブレーション
常温（15~25℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要量を滴下します。
 - ・溶液1滴あたりのおよその滴下量は45μLです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しい試薬を使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。

- ・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。
一例としてルミパルス G1200でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは100μLとなります。

- (3) 基質液
冷蔵庫から出してそのまま使用します。
・基質液の漏れがないように装置にセットしてください。
・基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液の注ぎ足しはしないでください。基質液がアルカリホスファターゼ (ALP) に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
- (4) 洗浄液
濃縮液のため精製水で10倍に希釈し、よく攪拌します。希釈した洗浄液は、常温 (15～25℃) に戻してから使用します。
- (5) 検体希釈液
15～30℃に戻してからそのまま使用します。
ルミパルス G1200にセットする場合は、冷蔵庫から出してそのまま使用してください。

2. 必要な器具・器材

- (1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ
(2) 全自動化学発光酵素免疫測定システム
**(3) LPコントロール・TDM C (別売品)
精度管理用試料として、LPコントロール・TDM Cを推奨いたします。使用に際しては、LPコントロール・TDM Cの取扱説明書を参照してください。

3. 測定法

- (1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。(サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。)
(2) パンコマイシンキャリブレーションおよび検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
(3) 測定を開始する前に、免疫反応カートリッジ、基質液、洗浄液、検体希釈液、サンプリングチップの残量を確認します。
(4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコル」の項をご参照ください。

4. 濃度の算出法

マスターキャリブレーションデータは、免疫反応カートリッジケースの2次元バーコードに記録されています。検体中のパンコマイシン濃度は、パンコマイシンキャリブレーションの発光量をもとに校正された検量線から自動的に算出されます。また、複数装置をお使いの場合は1台ごとに検量線を作成してください。

パンコマイシンキャリブレーションの測定は以下の場合に行います。
・免疫反応カートリッジ、基質液のいずれかが、新しいロットに切り替わった場合。

*・検量線を更新後、150日が経過した場合。
上記以外においても必要が生じた場合は、パンコマイシンキャリブレーションを測定し検量線を更新してください。

検体中のパンコマイシン濃度が、100.0μg/mLを超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し、再測定してください。

■測定結果の判定法

1. 有効治療濃度

**血中パンコマイシンの有効治療濃度は、目標トラフ値として10μg/mL以上に設定するとされています。菌血症、心内膜炎、骨髄炎、髄膜炎、肺炎および重症皮膚軟部組織感染などにおいては、15～20μg/mLのトラフ値が推奨されています。一方で、20μg/mLを超えると腎毒性が高発現になると報告されています¹⁾。
しかし、患者によっては血中濃度がこの濃度域外となるようなパンコマイシン投与量がある場合も考えられます。したがって、個々の患者の臨床所見や他の検査結果も考慮して、有効治療濃度を決定してください。また、適切な投与量およびパンコマイシン測定のための検体採取時期については、薬剤の電子添文を参照してください。

2. 判定上の注意

- (1) リウマトイド因子や異好性抗体の影響を受ける可能性があります。
(2) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。

■臨床的意義

パンコマイシンはグリコペプチド系抗生物質であり、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) およびメチシリン耐性コアグラエ陰性ブドウ球菌 (MRCONS) に対して抗菌力を有しています^{2),3)}。その作用は、細菌の細胞壁合成を阻害することによって、殺菌的に働きます⁴⁾。
パンコマイシンの副作用としては、腎毒性、聴覚障害等が報告⁵⁾されており、血中濃度と相関していることから血中濃度のモニタリングが望ましいとされています。そのため、血中濃度のモニタリングによる個々の患者に対する薬剤用量の調節は、薬剤の有効性を確保し、かつ副作用の発現を避けるために有用です。

本試薬は、化学発光基質 (AMPPD) を用いた化学発光酵素免疫測定法⁶⁾ (CLEIA; chemiluminescent enzyme immunoassay) に基づく試薬です。

■性能

1. 性能

- (1) 感度
パンコマイシンキャリブレーションを所定の操作で測定するとき、3μg/mL パンコマイシンキャリブレーションと0μg/mL パンコマイシンキャリブレーションの発光量の比は0.60以下になります。
- (2) 正確性
自家管理検体3例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±20%以内になります。
- (3) 同時再現性 (併行精度)
自家管理検体3例を所定の操作で6回繰り返し測定するとき、変動係数 (CV値) は10.0%以下になります。
- (4) 測定範囲
本試薬の測定範囲は、1.0～100.0μg/mLです。
**全自動化学発光酵素免疫測定システム (代表例: ルミパルス G1200) では0.1μg/mLから出力されますが、測定範囲下限値 (1.0μg/mL) 未満の値は参考値として取扱ってください。
- (5) 検出限界
CLSIガイドラインEP17-A2⁷⁾に従って検出限界 (LOD) の算出を行った結果、値は0.04μg/mLとなりました。
- (6) 定量限界
CLSIガイドラインEP17-A2⁷⁾に従って定量限界 (LOQ) の算出を行った結果、値は0.20μg/mLとなりました。

2. 交差反応性

交差反応性について検討した結果、以下に示す成績が得られました。

物質名	濃度 (μg/mL)	交差率
結晶性分解産物 (CDP-I)	50	-0.2%
テイコブラニン	100	0.1%

以下の表に示す物質は、表中の濃度まで測定値に影響は認められませんでした。

物質名	濃度
アセトアミノフェン	500 μg/mL
アミカシン	501 μg/mL
アンホテリシンB	500 μg/mL
アンピシリン	500 μg/mL
ベンドロフルメチアジド	500 μg/mL
カフェイン	500 μg/mL
セファマンドールナファート	500 μg/mL
セファゾリン	502 μg/mL
セファレキシン	500 μg/mL
セファロスボリン	500 μg/mL
セファロシン	500 μg/mL
シプロフロキサシン	500 μg/mL
クロラムフェニコール	500 μg/mL
クロロチアジド	500 μg/mL
クリンダマイシン	500 μg/mL
エリスロマイシン	500 μg/mL
エタクリン酸	500 μg/mL
エタンブトール	501 μg/mL
5-フルオロシトシン	501 μg/mL
フロセミド	500 μg/mL
フシジン酸	501 μg/mL
ゲンタマイシン	500 μg/mL
ヘパリン	500 μg/mL
ヒドロクロロチアジド	500 μg/mL
イブプロフェン	500 μg/mL
イソニアジド	501 μg/mL
カナマイシンA	500 μg/mL
カナマイシンB	502 μg/mL
リンコマイシン	500 μg/mL
メトトレキサート	500 μg/mL
メチルプレドニゾン	500 μg/mL
ナリジクス酸	500 μg/mL
ナプロキセン	500 μg/mL
ネオマイシン硫酸塩	500 μg/mL
ナイアシン	500 μg/mL
ニトロフラントイン	500 μg/mL
オキシテトラサイクリン	500 μg/mL
ペニシリンG	501 μg/mL
ペニシリンV	502 μg/mL
フェナセチン	500 μg/mL
プレドニゾン	501 μg/mL
プレドニゾン	501 μg/mL
リファンピシン	502 μg/mL
サリチル酸	500 μg/mL
シゾマイシン	500 μg/mL
スベクチノマイシン	500 μg/mL
ストレプトマイシン	500 μg/mL
スルファジアジン	500 μg/mL
スルファメトキサゾール	500 μg/mL
スルフィソキサゾール	500 μg/mL
テトラサイクリン	500 μg/mL
チカルシリン	500 μg/mL
トブラマイシン	500 μg/mL
トリメトプリム	500 μg/mL

3. 相関性試験成績

- (1) 血清または血漿検体59例を使用し、既存CLIA法との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：n = 59 相関係数：r = 1.00
回帰式：y = 1.0x + 0.4
(x；既存CLIA法、y；本品)
- (2) 血清または血漿検体59例を使用し、既存ラテックス免疫比濁法との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：n = 59 相関係数：r = 0.99
回帰式：y = 1.2x - 0.9
(x；既存ラテックス免疫比濁法、y；本品)
- (3) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体55例（抗凝固剤：ヘパリンナトリウム）を使用し、本試薬にて相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：n = 55 相関係数：r = 1.00
回帰式：y = 1.0x - 0.4
(x；血清、y；血漿)

4. 校正用の基準物質（標準物質）

USP (United States Pharmacopeia) Vancomycin Hydrochloride

■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意

- (1) 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
- (2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるビベティングを行わないでください。
- (3) 基質液はアルカリ性溶液（pH1.0）です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入らないように注意してください。
- (4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意

- ** (1) 使用に際しては本書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書に従ってください。
- (2) 免疫反応カートリッジ（抗体結合粒子・酵素標識抗原）、バンコマイシンキャリブレータ、基質液、洗浄液、検体希釈液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせて使用してください。
 - (3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
 - (4) サンプルングチップ、サンプルカップは、使用する測定システム指定のものを使用してください。
 - (5) サンプルングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
 - (6) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
 - (7) 保管に冷蔵庫をご使用の場合、庫内のファンからの風が直接当たる場所および庫内最下部での保管は、温度変化により水分蒸発の原因となりますので避けてください。
 - (8) 検体およびバンコマイシンキャリブレータは蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
 - (9) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
 - (10) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップパッキンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップパッキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. 廃棄上の注意

- (1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。また、酸と反応して有毒性のガスを発生する恐れがありますので、酸との接触を避けて廃棄してください。
洗浄液：1.0%（希釈調製前）、基質液：0.05%、
検体希釈液：0.1%
- (2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
- (3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
- (4) 使用した器具（ビベット、試験管等）、廃液、サンプルングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行ってください。
- (5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。
- (6) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタールアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

■貯蔵方法・有効期間

* 抗体結合粒子	2～10℃に保存	有効期間：1年
* 酵素標識抗原	2～10℃に保存	有効期間：1年
* バンコマイシンキャリブレータ	2～10℃に保存	有効期間：1年
基質液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
洗浄液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
検体希釈液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

■包装単位

個別包装

ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

コードNo.	品名	包装
298862	ルミパルス バンコマイシン 免疫反応カートリッジ (抗体結合粒子・酵素標識抗原)	14テスト×3
298879	ルミパルス バンコマイシン バンコマイシンキャリブレータ	3濃度×1 (各1.5mL×1)
219973	ルミパルス 基質液 (共通試薬)	100mL×6
292600	ルミパルス 基質液 (共通試薬)	50mL×6
219942	ルミパルス 洗浄液 (共通試薬)	1000mL×1
219935	ルミパルス 検体希釈液 (共通試薬)	300mL×4
292617	ルミパルス 検体希釈液 (共通試薬)	80mL×4

**その他

LPCコントロール・TDM C
2濃度×3（各3.0mL×3）（コードNo. 260821）

■主要文献

1. 日本化学療法学会/日本TDM学会 抗菌薬TDMガイドライン作成委員会. 抗菌薬TDMガイドライン 改訂版（第2版）. 39-62, 2016.
2. 吉田 勇 他. 各種抗菌薬に対する2008年臨床分離好気性グラム陽性球菌および嫌気性菌の感受性サーベイランス. Jpn J Antibiot, 65: 49-72, 2012.
3. 第十七改正日本薬局方解説書. 廣川書店, C-4017-C-4022, 2016.
4. Barna JC and Williams DH. The structure and mode of action of glycopeptide antibiotics of the vancomycin group. Annu Rev Microbiol, 38: 339-357, 1984.
5. Fong KL, et al. Sensitive radioimmunoassay for vancomycin. Antimicrob Agents Chemother, 19: 139-143, 1981.
6. Nishizono I, et al. Rapid and Sensitive Chemiluminescent Enzyme Immunoassay for Measuring Tumor Markers. Clin Chem, 37: 1639-1644, 1991.
7. Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures ; Approved Guideline — Second Edition. CLSI Document EP17-A2.

■問い合わせ先

富士レビオ株式会社 お客様コールセンター
TEL：0120-292-832

■製造販売元

富士レビオ株式会社
**神奈川県相模原市中央区田名塩田1丁目3番14号

