

機械器具(44) 医療用やすり
一般的名称:やすり JMDNコード:11701001
一般医療機器

シグマ やスリ


【禁忌・禁止】

1. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 材料
ステンレス鋼

2. 形状、構造
1) 鼻用やすり

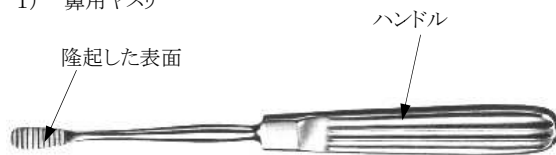

- 2) 小型やすり



3. 原理
組織に様々な形状の隆起した表面をあて、作動させることにより組織の平滑化、削合又は切断をする。

【使用目的、効能又は効果】

1. 組織の平滑化、削合又は切断に用いる。

【操作方法又は使用方法】

1. 本品の金属に鋭い溝をつけた面を対象部にあて、前後にスライドさせることにより組織の平滑化、削合又は切断を行う。
2. 使用前に洗浄し、オートクレーブ(121℃20分)又はエチレンオキサイドガスにて滅菌を行う。

【使用上の注意】

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命を著しく低下させる。
2. 本品を使用するにあたっては、器具と技術に対する適切な理解が必要である。
手技に習熟した者以外は使用しないこと。
3. 誤った使用法は本品の損傷を招く恐れがある。
4. 本品を使用するには、神経と血管の損傷を避けるために、厳密な解剖学的考慮が必要である。
5. 本品の取扱う際は、偶発的な事故を防止するため先鋭部等に細心の注意を払うこと。
6. 包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ワールで本品の表面を磨かないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 本品を保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

【保守・点検に関わる事項】

1. 本品を安全に、より長い間ご使用頂くために、始業・終業・定期点検等は、必ず行うこと。
2. 錆を防ぐ為に以下の事を守ること。
 - ① 使用後は速やかに洗浄を行うこと。
 - ② 取り外せるものは取り外し、そうでないものは可動部をよく動かしながら洗浄すること。
 - ③ 洗浄後に汚れが残った状態での滅菌、消毒はしないこと。
- ④ 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水か脱塩した水を使用すること。
- ⑤ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けること。(中性の洗剤を使用すること)
- ⑥ 超音波洗浄の際には洗浄器メーカー指定の適正な洗剤を使用すること。(家庭用洗剤は使用しないこと)
- ⑦ 洗浄後、湿った状態での放置はしないこと。

【包装】

1～100 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社 秋山製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-31-4

TEL 03-3811-0802 FAX 03-3811-6657

*製造業者 株式会社コアプラント

【販売業者及びお問い合わせ先】

株式会社 秋山製作所 シグマ事業部

*〒113-0033 東京都文京区本郷 3-31-1 盛和ビル

TEL 03-3815-8275 FAX 03-3815-8699