*2017 年 11 月改訂（第4版）（新記載要領に基づく改訂）　　医療機器製造販売業届出番号 13B1X00248HG0004

2009 年 5 月改訂（第3版）

機械器具37 医療用匙

一般医療機器 スプーン型鋭ひ及び鈍ひ（JMDN：41716001）

骨鋭匙

【禁忌・禁止】

1)本品の刃先を切削するなど、二次的加工（改造）をしないで下さい。〔破損等の原因となります。〕

2)本器を清掃する際には必ず中性洗剤をご使用下さい。〔酸性、又はアルカリ性の洗剤は本品を腐蝕させるおそれがあります。〕

3)使用時に必要以上の力を加えないで下さい。〔先端角度の変形、弯曲、破損の原因となります。〕

【形状・構造及び原理等】

1．材質

ステンレス鋼

2．形状又は構造

カタログNo.： 2235 シェーデ型 骨鋭匙：全長 19 cm

No.1～No.6

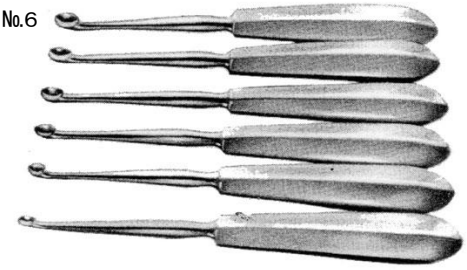

カタログNo.： 3350 ブラン型 骨鋭匙：全長 22 cm

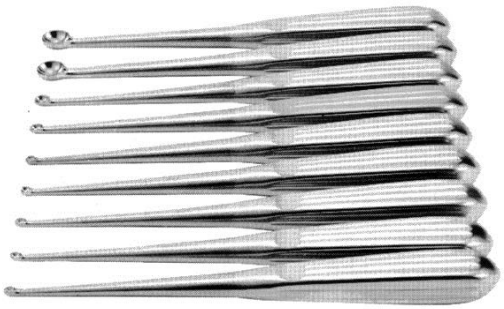

カップ・サイズ（原寸大ではありません）



カタログNo.	規格	カタログNo.	規格
3350-11	直 #000	3350-21	反 #000
3350-12	直 #00	3350-22	反 #00
3350-13	直 #0	3350-23	反 #0
3350-14	直 #1	3350-24	反 #1
3350-15	直 #2	3350-25	反 #2
3350-16	直 #3	3350-26	反 #3
3350-17	直 #4	3350-27	反 #4
3350-18	直 #5	3350-28	反 #5
3350-19	直 #6	3350-29	反 #6

カタログNo. 3165 黄靭帯剥離用鋭匙：全長 19 cm

3165-01：先幅 8 mm

3165-02：先幅 6 mm

カタログNo. 3350-03 ブラン型 骨鋭匙 （特型）：全長 24～26 cm



カタログNo.	規格	カタログNo.	規格
3350-03-00	反 #00	3350-03-3	曲 #3
3350-03-2	反 #2		

3．原理

本品の先端はカップ状の刃先を有する。

【使用方法等】

ハンドル部分を把持し、先端部分にて軟部組織又は骨病変部分を掻爬する。

本品は未滅菌のため、使用に際しては必ず洗浄し、下記の条件又は医療機関により確認され、検証された滅菌条件において滅菌を行って下さい。

滅菌方法：高圧蒸気滅菌

滅菌条件：温度 121℃以上、時間 30 分

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1）刃先は極めて鋭利ですので、取扱いには十分ご注意下さい。

2）用途に応じた形状のものを選定し、軟部・軟骨組織の掻爬以外の目的で使用しないで下さい。また、刃先の変形、折損や曲がりなどの原因になるので、使用時に必要以上の力を加えないで下さい。

3）使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を、直ちに洗浄、除去して下さい。

4）塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐蝕の原因になるので、できるだけ使用を避けて下さい。付着した場合は直ちに洗浄して下さい。

<不具合・有害事象>

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象がおこる可能性があります。

1）本品の適切な洗浄、滅菌を行わなかったために起こる感染。

2）手術従事者の皮膚の裂傷やグローブの破れ。

3）必要以上の力を加えたことによる、刃先の変形、折損、刃こぼれ。刃先の破片が術野に残留するなど。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

1）保管にあたっては、洗浄をした後、腐蝕を防ぐために必ず乾燥して下さい。

2）滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をして下さい。

【保守・点検に係る事項】

1）使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織片などの汚れを除去し、感染防止のために洗浄して下さい。汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適切な濃度で使用して下さい。

2）洗浄装置（超音波洗浄器、ウォッシャー ディスインフェクター等）で洗浄する際には、刃先同士が接触して先端を破損することがないよう注意して下さい。

3）洗剤の残留がないよう、充分にすすぎをして下さい。仕上げすすぎには、浄化水（ろ過、蒸留、脱イオン化水）を用いることを推奨します。

4）洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥して下さい。

5）洗浄後、汚れ、キズ、サビ、曲がりがないか、また刃こぼれなどの異常がないか、点検・確認して下さい。異常を認めた場合には、直ちに修理調整を行って下さい。

6）強アルカリ性、または強酸性の洗剤や消毒剤は、器具を腐蝕させるおそれがあるので、絶対に使用を避けて下さい。中性洗剤の使用を推奨します。また、金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するおそれがあるので、汚れ除去及び洗浄の際には使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：　株式会社 根本商会