

MES-CG08-075-30

**2017年 4 月(第3版)(新記載要領による変更) *2014年 6 月 4 日(第2版)

> 器 0 1 手術台及び治療台 一般医療機器 手術台アクセサリー (70469000)

脚板延長板

【警告

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリーで支持すると きは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺 や褥瘡の原因となることがあります。]


【禁忌・禁止】


- 1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
- ** 2. 【使用方法等】3.使用可能な手術台に示す機種以外では使* 用しないこと。[他機種での使用は確認していません。]
 - 3. 【形状・構造及び原理等】の項目2. に示す許容荷重を超 えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

**

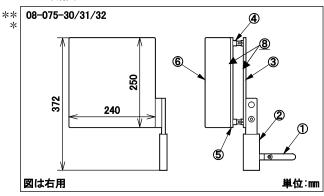

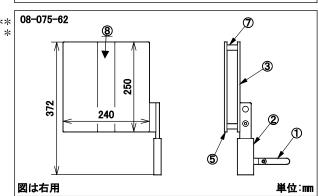

	商品コード	商品名	構成	質量/個
**	08-075-30	脚部延長ボード 本体 5700 シリーズ用	①②③ <u>⑧</u>	2. 3 kg
**	08-075-31	脚部延長ボード カセッテ枠 5700 シリーズ用	45 <u>8</u>	0. 9 kg
	08-075-32	脚部延長ボード マットレス 5700 シリーズ用	6	0. 2 kg
** *	08-075-62	脚部延長ボード カセッテ固 定式 5700 シリーズ用	123 57 <u>8</u>	3. 4 kg

*注:番号は1.外観図の番号に対応

**2. 許容荷重

20kg (片側1枚)

3. 材質

- *①固定ハンドル/②固定金具
 - /⑦カセッテカラー:ステンレス鋼棒
 - ③脚受板:アルミニウム合金板
 - ④カセッテ支柱:炭素工具鋼鋼材
 - ⑤カセッテ格納枠: 熱硬化性樹脂積層板
- * ⑥マットレス:ウレタン
- ** ⑧取付用テープ:ナイロン
- * 注:番号は1. 外観図の番号に対応

**【<u>使用目的又は効果</u>】

手術台に付属するアクセサリー。


開脚展開可能な二枚式脚板に取り付けて、脚板の長さを延長する 手術台アタッチメント。

製造販売届出番号:13B1X00306N10103


手術後のレントゲン撮影等で患者を脚側にずらす場合、脚が脚板 からはみ出るのを解消する。

**【使用方法等】

* 1. 5700 シリーズ用

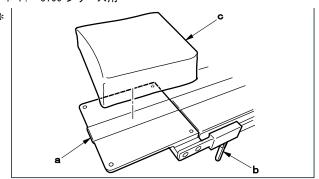


- 1-1 手術台の脚板サイドレールに脚部延長ボード a を取り付けます。
- 1-2 固定ハンドル \mathbf{b} で脚部延長ボード \mathbf{a} を固定します。
- 1-3 マットレス c を取り付けます。

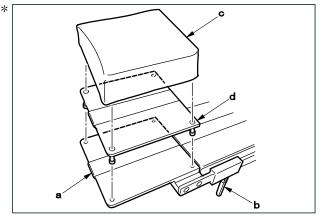

1-4 X線撮影が必要な場合、脚部延長ボード \mathbf{a} とマットレス \mathbf{c} の間にカセッテ格納枠 \mathbf{d} を取り付けます。

*2. カセッテ固定式 5700 シリーズ用

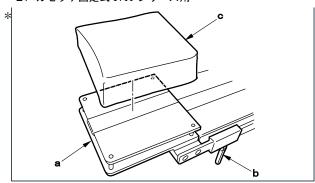

- 2-1 手術台の脚板サイドレールに脚部延長ボード a を取り付けます。
- 2-2 固定ハンドルbで脚部延長ボードaを固定します。
- 2-3 マットレス c を取り付けます。

**3. 使用可能な手術台

*

販売名:MOT-5601KDB電動油圧手術台

製造販売届出番号:13B1X00306N10056

販売名:MOT-5700電動油圧手術台製造販売届出番号:13B1X00306N10057

販売名:電動油圧手術台MOT-5701 製造販売届出番号: 13B1X00306N10144

*【使用上の注意】

**1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が 外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

**2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の手術台アクセサリー<u>やテーブルト</u>ップとの接触・干渉に注意してください。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水の かからない場所に保管してください。

* 2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合:7年(注)

[自己認証による]

注:耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突 発的な故障、部品(マットレスを含む)の著しい消耗・劣化・ 破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

* 2 清掃·消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

*3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に 連絡してください。

* <業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:ミズホ株式会社

TEL 03 (3815) 3097

製造業者:ミズホ株式会社千葉工場

**【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。