


② 前腕中央部（手首と肘関節の中間）及び上腕中央部（肘関節と脇の下の中間）の周囲を計ります。④で選択した適用サイズにおける「B. 前腕中央部周囲」及び「C. 上腕中央部周囲」の適用範囲を下表で確認し、計測した値がいずれも適用範囲内に収まっていることを確認してください。

※④で選択したサイズに前腕及び上腕周囲が当てはまらない（手首のサイズと前腕及び上腕のサイズが異なる）場合は、医師の指示に従って、適用サイズを決めてください。


※前腕及び上腕周囲がどのサイズにも当てはまらない場合には、本品は適用できません。

サイズ	A 手首周囲	B 前腕中央部周囲	C 上腕中央部周囲
S	14.6～19.0 cm	17.8～23.0 cm	21.6～39.4 cm
M	16.5～21.6 cm	22.0～29.2 cm	27.0～45.0 cm
L	19.0～23.5 cm	28.9～34.3 cm	32.4～50.5 cm

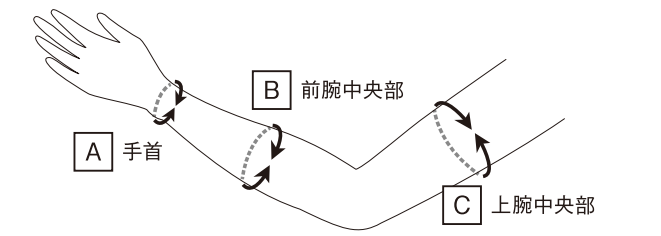


2. 装着方法


① バンド部を持ち、スリーブを半分くらいの長さまで折り返します。



② 折り返した部分に手を入れ、スリーブを肘まで引き上げます。



③ 折り返していた部分を脇の下まで引き上げます。その際、バンド部分が脇の下にくるように装着します。その後、全体に均一にならし、局所的なねじれやしわがないことを確認してください。



【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 術後等患者の意識レベルが低い場合及び患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用してください。
- ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にある患者は、潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意して使用してください。
- 本品の使用により、腕や手に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
〔動脈及び静脈の血行障害又は知覚障害等を発症するおそれがあるため。〕

2. 重要な基本的注意

- 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択してください。またサイズ適用外の場合には使用しないでください。
- 本品を折り返して使用しないでください。
〔血行障害や知覚障害等を引き起こすおそれがあるため。〕
- 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやしわのないように装着してください。本品が、装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着し直してください。
〔適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や知覚障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。〕
- 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周囲が変わった場合は、適切なサイズに変更してください。
- 本品に、破損（伝線、ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
- 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（伝線、ほつれ、破れ等）する場合がありますので注意してください。
 - ① 少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着
 - ② 爪が伸びていたり、反っていたりする手への装着
 - ③ 肌荒れした手や爪が伸びている手での取り扱い
 - ④ 鋭利なものへの接触
- 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないでください。
- 本品は弾性スリーブに精通した術者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。また患者との意思疎通が困難な場合には、看護、介護介添する者に使用方法を説明してください。
- 軟膏などの薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。
- 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。
- 弾性スリーブに精通した術者の指導がない限り、本品を他の弾性スリーブ等と重ねて装着しないでください。

3. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。

- 1) 重大な有害事象
 - ① 血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
 - ② 知覚障害
神経麻痺等の知覚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

③ 皮膚障害

- ・本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- ・ショック等末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。

2) その他の有害事象

本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれなどの皮膚障害が現れた場合にはただちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。

4. その他の注意

汗や摩擦などにより色落ちや他の生地の色移りする場合がありますので注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、高温多湿を避け、室温下で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 洗濯機で洗濯する場合には必ず洗濯ネットを使用してください。漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
- 2) 洗濯の際に色落ちや他の生地の色移りする場合がありますので、色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。
- 3) つけ置き洗いをすると色落ちする場合がありますので注意してください。
- 4) 洗濯後は、直射日光を避けて乾燥してください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本シグマックス株式会社

連絡先 住所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿 6-8-1

電話：0800-222-6122

外国製造所国名：米国

外国製造業者：Carolyn Company
キャロロン