

類別 機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 一般の名称 呼吸回路セット * JMDNコード 70566000

再使用禁止

販売名 **ディスポ呼吸回路 410 (ネブライザキット)**

【警告】

＜使用方法＞

- ※ ※ ◆ (この項目削除)
- ※ ※ ◆ (この項目削除)
- ※ ※ ◆ 始業点検で使用する人工呼吸器の作動が正常で安定していること、電源コードに傷みのないことを必ず確認してから、患者さんにつないでください。アラームが作動した時や、始業点検に合格しない時は、使用を止め、IMI ㈱が認定するサービスマンにすぐにご連絡ください。
- ※ ※ ◆ (この項目削除)
- ※ ※ ◆ 呼吸回路の中に溜まった水は回路外に捨ててください。水が患者さんや指定の人工呼吸器に入らないように注意してください。入った場合、異常の原因となります。また、回路内の水を取り除くために、圧縮空気によるエアージェンを使用しないでください。呼吸回路を点検する時は、手をよく洗い、回路を不潔にしないように注意してください。
- ※ ※ ◆ 万一の作動不良に備え、予備のキットを用意し、蘇生バッグを患者さんの側に準備し、人工呼吸器でアラームを設定し、パルスオキシメータやカプノメータなどの生体情報モニタを併用してください。
- ※ ※ ◆ (この項目削除)
- ※ ※ ◆ 使用後は、国内法規に従って、廃棄してください。
- ※ ※ ◆ 指定外の人工呼吸器には使用しないでください。
- ※ ※ ◆ ネブライザを使用される際に、呼気側回路にフィルタを装着すると、目詰まりを起こして患者さんが健康被害を受けることがあります。呼気側回路へのフィルタ装着はお止めください。

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

- ◆ 再使用しないでください。このネブライザキットは、シングルユース (1回の使用) 用です。滅菌しないでください。このキットを洗浄液に浸す、洗浄、すすぎ、ガス滅菌、オートクレーブなどをした場合、有害なガスが残っていたり、呼吸抵抗が危険なほどに増加することがあります。
- ◆ 温度ポートにはF&P社製以外のエアウェイサーモメータ及び温度プローブを使用しないでください [他社製品では、温度プローブのセンサ部が呼吸回路から外れ、リークの発生する可能性があります]。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

ネブライザキット、添付文書

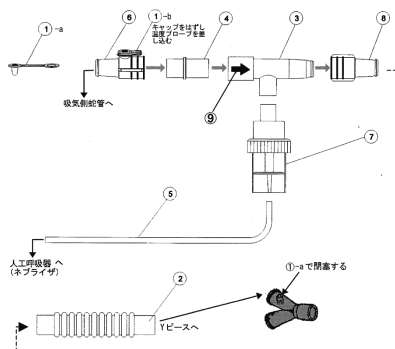

名称	材質	数量	名称	材質	数量
1 固定ポートキャップVM	LLDPE 3034G	2	6 アウトレットコネクタ (固定ポート付)	LLDPE 3034G	1
2 絶縁 22mm×6" (B)	PE&EVA	1	7 ネブライザ	NA	1
3 Tコネクタ	NA	1	8 アウトレットコネクタ	LLDPE 3034G	1
4 ストレートアダプタ 22mm オス×15メス×22mm オス	PPU750	1	9 500µmヘル	NA	1
5 PVCチューブ (内径8mm、外径9.5mm、長さ78") (B99)	PVC	1			

2. 原理

併用する人工呼吸器の制御によって、ネブライザ部分で、薬液が霧状に噴霧されます。

※ ※ 【使用目的又は効果】

※ ※ 人工呼吸器に接続し、呼吸管理に用います。

※ ※ 【使用方法等】

1. 取扱い方法

- 1) 指定の呼吸回路に接続してください。
- 2) 患者さんに接続する前に、全ての接続部分に損傷・変形などの異常がないこと、呼吸回路を加圧してリークや閉塞のないことを確かめてください。
- 3) 併用する人工呼吸器の取扱説明書に従って、使用前の点検と使用中の点検を行い、異常のないことをモニタから確認してください。
- 4) 使用後は廃棄してください。

2. 使用対象機種

CV3000 人工呼吸器 (新呼吸弁仕様)、CV4000 長期人工呼吸器 (新呼吸弁仕様)、CV4000 α 長期人工呼吸器、CV5000 長期人工呼吸器、ベアー1000 長期人工呼吸器、バード6400 長期人工呼吸器、バード8400STi 長期人工呼吸器

3. 使用中の点検

- ◆ チューブやコネクタ類がしっかり接続されており、ひび割れや破損がなく、リークがないことを確認してください。
- ◆ 患者さんの胸の動きと気道内圧インジケータの指示を見て、設定通りの換気動作が行われていることを確認してください。
- ◆ 院内の感染防止規定に準じて、定期的に交換してください。
- ◆ 患者さんの胸の動きと気道内圧インジケータの指示を見て、設定通りの換気動作が行われていることを確認してください。
- ◆ 異常な動作音や異臭がないことを確認してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ※ ※ ◆ (この項目削除)
- ※ ※ ◆ 使用前に包装が正常であることを確認してください。
- ※ ※ ◆ 高温でなく、乾燥した場所に保管してください。

※ ※ 【保管方法及び有効期間等】

※ ※ 1. 保管方法

保管温度 : -40～+70℃
保管相対湿度 : 10～100% (非結露)

2. 有効期間・使用の期限

使用期限 : 外箱及び製品の包装に記載。
連続使用時間 : 推奨連続使用時間 7 日間
〔自己認証 (製造業者データ) による〕

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

使用後は滅菌や再使用しないでください。

【主要文献及び文献請求先】

※ ※ アイ・エム・アイ株式会社 レスピラトリ・ケア部
※ TEL : 048-968-4442

※ ※ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称 : アイ・エム・アイ株式会社
※ 製造業者名 (国名) : Vincent Medical (Dong Guan) Manufacturing Co., Ltd.
(ビンセントメディカル (ドン Guan) マニファクチャリング社)
(中国)