



Edwards

** 2017年10月改訂 (第4版: 新記載要領に基づく改訂)
* 2010年 4月改訂 (第3版)

医療機器承認番号 22000BZX00118

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器 大動脈カニューレ 35565100


イーゼーグライド大動脈カニューレNC

再使用禁止

- **
** **【警告】**
** **使用方法**
**
1. 送血カニューレ挿入部位は動脈硬化性病変のない場所を選び、カニューレの先端が大動脈壁に当たらないように慎重に挿入すること。[大動脈に挿入した送血カニューレにより血管内膜が損傷され、大動脈解離が発生することがあるため。]
 2. 本品使用中は、体外循環回路内の貯血槽の血液量が安全レベルに達していることを常に確認すること。[急激な脱血不良等による貯血槽内血液レベルの低下が、動脈送血回路からの空気塞栓の原因となることがあるため。]


- **
** **【禁忌・禁止】**
** **使用方法**
**
1. 再使用禁止
 2. 再滅菌禁止

- **
** **【形状・構造及び原理等】**
** **ストレートタイプ** (流量/圧損グラフ: EZS21, EZS24参照)

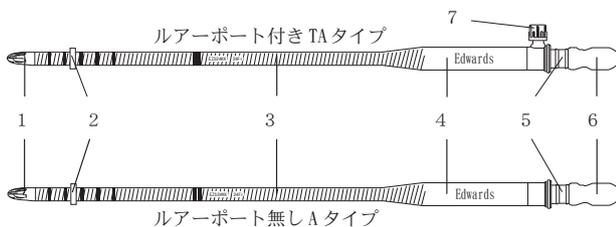


1. セーフフローストレートチップ
2. スーチャーリング
3. ワイヤ強化チューブ部
4. チューブ部
5. コネクタ (3/8インチ)
6. ベントキャップ
7. ルアーポートキャップ (TAタイプのみ)

- フランジ付カーブドチップタイプ** (流量/圧損グラフ: Ezc21, Ezc24参照)

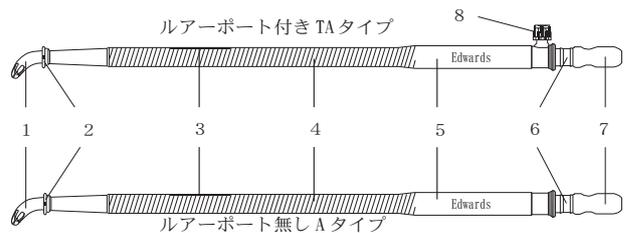

1. セーフフローカーブドチップ
2. スーチャーフランジ
3. ポジションマーカ
4. ワイヤ強化チューブ部
5. チューブ部
6. コネクタ (3/8インチ)
7. ベントキャップ
8. ルアーポートキャップ (TAタイプのみ)

- バンプ付カーブドチップタイプ** (流量/圧損グラフ: Ezc21, Ezc24参照)

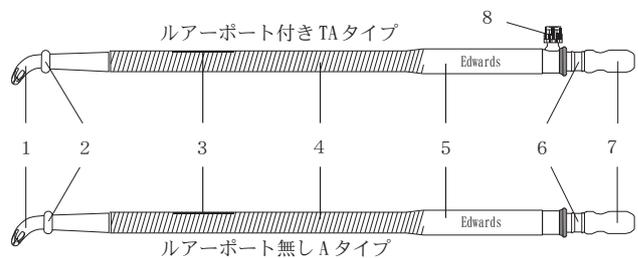


1. セーフフローカーブドチップ
2. スーチャーバンパ
3. ポジションマーカ
4. ワイヤ強化チューブ部
5. チューブ部
6. コネクタ (3/8インチ)
7. ベントキャップ
8. ルアーポートキャップ (TAタイプのみ)

本品はポリ塩化ビニル (可塑剤: フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)) を使用しています。また、カニューレポディーにはワイヤ強化が施されています。

本品は先端部分が患者の動脈血管に挿入され、コネクタ部分が人工心肺装置に設置された体外循環回路 (人工心肺回路) に接続されます。体外循環回路から送られた動脈血が、本品を通して患者に送られます。

** 水での流量と圧力損失の関係は以下のとおりです。

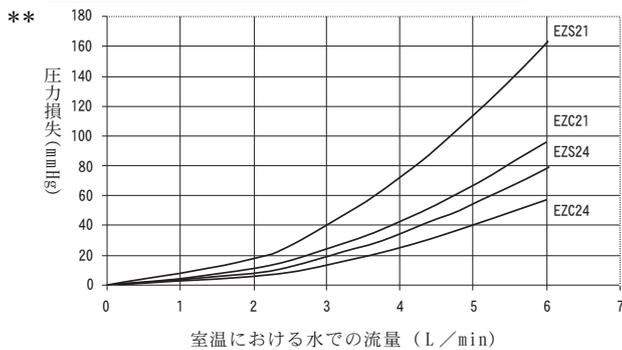

【使用目的又は効果】

本品は人工心肺を用いる体外循環において、大動脈への送血に使用する。上行大動脈等に挿入し留置するものである。

** 【使用方法等】

- 一般的な外科手技を用いて本品を適切な位置に挿入します。大動脈カニューレシヨンの前にスーチャーリングが必要な場合は、スーチャーリングを袋から取り出し、カニューレ先端から適切な位置にスライドさせてください。
- ポジションマーカのあるカニューレについて、カニューレ本体のポジションマーカはカニューレ先端の向きを示しており、その方向に送血されます。大動脈弁から血液が上方に流れるようカニューレのカーブドチップを正確な方向に向けてください。
- 本品は、赤色のキャップがコネクタの返しにしっかりと合はるよう設計されています。ベントキャップが適切に機能するように、準備してください。
- 本品を血管に固定します。体外循環回路のチューブと本品の接続部は、ケーブルタイなどで確実に固定します。
- 体外循環手技完了後、本品を抜き開創部の処置を行います。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 使用前に、本品の接続部の外れおよび緩みがないことを確認してください。
- 接続部は、過度に締め付けしないでください。また、アルコール等の有機溶剤を使用する場合は注意してください。[コネクタにひび割れが生じる可能性があります。]
- 大動脈弁から直接送血できるようにカニューレのカーブドチップを正確な方向に向けてください。誤った方向に向けると患者への害またはライン内に過度な圧力がかかるおそれがあります。カーブドチップ付きのカニューレにはカニューレ本体にポジションマーカがついています。ポジションマーカがないまたは読みにくい場合は使用しないでください。
- カニューレを動脈送血ラインに取り付ける際は、空気が完全に除去されていることを確認してください。
 - 製品や接続箇所等から空気混入や血液のリークが発生した場合には、直ちに新しい製品との交換または適切な処置を検討してください。
- 鉗子や刃物等で本品を傷つけないように注意してください。[血液漏れ、空気混入の可能性があります。]
 - 本品のベントキャップに内蔵されている多孔性のベントプラグは、乾燥時に空気抜きができるように設計されています。濡れていると機能しない場合があるので、使用前にベントプラグを濡らさないようにしてください。
 - 本品を使用前に氷水で冷やさずください。
 - カニューレの挿入後、末梢の血流が十分に得られる適切な血管であることを確認してください。
- 体外循環中の不注意によるカニューレの抜去を防ぐため、カニューレは血管または組織に正しく固定してください。
- 気泡除去の際は、鉗子等の硬いもので叩かないでください。

- クランプはワイヤ非強化部のみに行い、補強部位へは行わないでください。[カニューレの変形、流量低下、穿孔または裂けを生じるおそれがあります。]
- 体外循環回路のチューブと本品の接続部は、体外循環開始前にケーブルタイなどで確実に固定してください。[高い圧力や外力によって接続部が外れる可能性があります。]
- 流量を増加する際は、最大限度圧を超えないよう注意してください。特に小さいサイズのカニューレを使用する場合、圧力が急速に上昇する可能性があります。
- 回路内圧の過度の上昇が認められた場合、先端チップの位置およびカニューレの開存を確認してください。
- 塞栓物の侵入や脳血管内圧上昇の可能性を抑えるため、大動脈弓の枝動脈にチップ先端を直接向けしないでください。
- 本品を適切に配置するためにチップを大動脈に縫合する場所や方向に注意してください。[一度固定すると、位置を変えることは困難です。]
- 本品の使用時には、キンク等による閉塞が生じるおそれのある留置方法は行わないでください。
- カニューレ等を患者から抜去した後、破断や欠損がないか確認してください。
- 抜去後、血管の状態に異常がないか確認してください。

** 【使用上の注意】

使用注意

- 解離性動脈瘤の患者
- 大動脈解離を発生するおそれがあります。
- 大動脈に動脈硬化性病変を持った患者
- 大動脈解離を発生するおそれがあります。

重要な基本的注意

- ハロゲン化炭化水素系麻酔薬を本品に直接接触させないでください。これらの薬品は製品の劣化を促します。
- 本医療機器を用いた体外循環回路の接続・使用にあたっては、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学会、日本体外循環技術医学会、日本医療器材工業会等の人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン等、最新の情報を参考にしてください。
- 使用中は本品の接続部の緩みや、本品からの血液漏れがないか継続的に確認してください。
- 体外循環中は確実に適切な抗凝固療法レベルを維持してください。
- 全体の機能を損なわないように単回使用機器同士の接続および単回使用機器と装置のセッティングが確実にされていることを確認してください。

** 不具合・有害事象

** 重大な不具合

- カニューレの移動
- カニューレの損傷

** 重大な有害事象

- 血栓形成
- 空気塞栓症
- 解離
- 血管の穿孔および破裂
- 異常溶血反応
- 心筋損傷

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- 本品は可塑性であるフタル酸ジ (2-エチルヘキシル) が溶出するおそれがあります。製品使用の有用性が、リスクを上回ることを支持する研究や文献が報告されていますが、妊産婦が治療中、高濃度のフタル酸エステル類に長くさらされた場合、問題となる可能性があります。

****【保管方法及び有効期間等】**

保管方法

直射日光、水ぬれ、高温多湿、化学薬品、埃等避け、室温にて保管してください。

**** 使用期間**

** 6時間 [自己認証(当社データ)により設定]

有効期間

** ラベルに記載 (自己認証による)

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

エドワーズライフサイエンス株式会社

電話番号：03-6894-0500 (顧客窓口センター)

** 設計を行う外国製造業者 (国名)：

エドワーズライフサイエンス社 (米国)

Edwards Lifesciences LLC

** Edwards、エドワーズ、Edwards Lifesciences、エドワーズライフサイエンス、定型化されたEロゴおよびEZ
GlideはEdwards Lifesciences Corporationの商標です。その他の商標は全てそれぞれの商標権者に帰属
します。