*2009年 3月 13日改訂（第 2版）
2009年 2月 2日作成（第 1版）

承認番号：22100BZX00058000

機械器具（05）麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
*管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000

メラ麻酔器用呼吸回路（A回路）

A90、A90R、A120、A120R

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
2. オートクレーブによる滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1．各構成品の名称

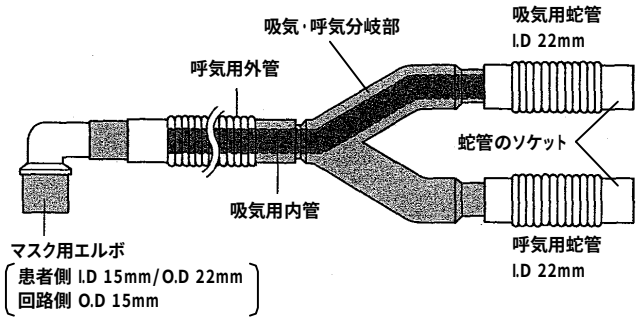

2．種類と構成

型 式	２重蛇管の長さ（mm）	呼気用蛇管/吸気用蛇管のソケットの材質
A90	900	ポリエチレン樹脂
A90R	900	合成ゴム
A120	1200	ポリエチレン樹脂
A120R	1200	合成ゴム

※ 本品には、ラテックスゴムを使用していません。

3．原理

呼気時

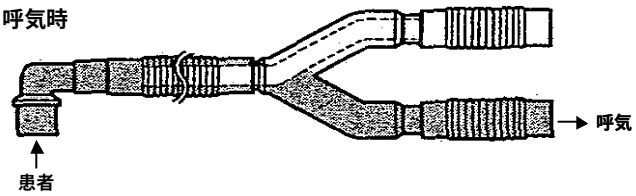

吸気時

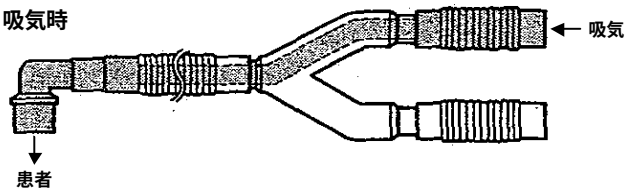

麻酔器から送気される吸気（空気又は酸素を含む医療ガス）は、吸気用蛇管から吸気・呼気分岐部に接続された吸気用内管を通して、患者へ送入される。患者から排出される呼気は、呼気用外管から吸気・呼気分岐部に接続された呼気用蛇管を通り装置へ戻される。

【使用目的、効能又は効果】

全身麻酔を施すための機器のうち、麻酔器用呼吸回路。

【品目仕様等】

1．漏れ：空気圧 30hPa での漏れ量が毎分 30mL 以下。

【操作方法又は使用方法等】

1．本品の吸気用蛇管のソケットを麻酔器の吸気弁側に接続し、呼気側用蛇管のソケットを呼気弁側に接続する。
2．患者コネクターは外径２２㎜、内径１５㎜になっていますのでそのままマスク又は気管内チューブに接続する。

【使用上の注意】

1．本品は、１回使用製品なので、再使用しないこと。
2．本品を組立てるときに、アルコールや界面活性剤の液体を使用して取付けないこと。［樹脂部品にひびを生ずることがある］
3．本品を使用する前に、梱包が損傷を受けていたり、回路が損傷（亀裂･破損）・変色・変形している場合は使用しないこと。
4．蛇管を極端に折り曲げないこと。
5．内管を吸気側、外管を呼気側にして使用すること。［もし、逆に接続すると内管に呼気の水滴が溜まり雑音が生じたり、呼気抵抗が上がる］
なお、長時間使用すると、外管にも水滴が溜まることがある。
6．本品を麻酔器等の装置に取り付けたときは、装置の添付文書に従ってリーク試験を行い、リークがないことを確認してから使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1．貯蔵・保管方法
水漏れ、ほこり、高温（50℃以上）、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所などは避けること。

2．有効期間・使用の期限
ラベルに記載されている製造年月から 3年。

【包装】

１個 /１密閉袋/１包装箱に収納。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸２－１１－１

製造業者
メラセンコー コーポレーション
（MERASENKO CORPORATION）
国名：フィリピン

お問い合わせ先
本社商品部 TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011

文書管理番号：AA-3070-02