

機械器具（06）呼吸補助器
高度管理医療機器 成人用人工呼吸器 42411000

特定保守管理医療機器

トリロジー

(トリロジー100、トリロジー200、トリロジーオ2)

【警告】

- ・万一の作動不良などの非常事態に備え、人工呼吸器に依存する患者（生命維持装置として使用する場合を含む）に本品を使用する場合は、患者の状態について「警報機能付きバルスオキシメータ」又は「警報機能付きカブノーメータ」など適切な別の生体モニタ装置を併用して監視する。また、手動式人工呼吸器（バッグバルブマスク）等、代替の換気装置をいつでも使用できるように備える。
- ・吸気圧下限アラームの設定値を下げ過ぎない。[設定値が低すぎると、回路リークおよび呼吸回路接続不良を検知できない]
- ・加温加湿器に給水する際には、給水用ポートを使用し給水する。
- ・本品の背面にある酸素取入口に添加せずに、低流量の酸素を呼吸回路やマスクに直接取り付けない。[患者フローと1回換気量の測定が不正確になり、アラームが正しく作動しない場合がある]

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

- ・気道を維持できない又は十分に分泌物を取り除けない場合 [いずれの場合も、十分なガス交換の患者気道を保証出来ないため、非侵襲的機械換気の使用が禁忌であることが報告されている^{①②}]

使用方法

- ・加温加湿器に給水する際には、ガスポートを使用しない。[呼吸回路の誤接続及び誤接続による火傷、ガスポートを介した菌による患者回路内汚染の可能性がある]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成及び形状

(1) 本体寸法

トリロジー100、トリロジー200：

167 (L) ×285 (W) ×235 (H) mm、重量 5.0 kg

トリロジーオ2 : 211 (L) ×285 (W) ×235 (H) mm、重量 5.6 kg



(2) 構成品

AC電源コード

着脱式バッテリ



リユーズブルフィルタ



FRBSH04500A

取扱説明書を必ずご参照ください。

呼気ポートブロック

(トリロジー100)

パッシブ呼気ポートブロック



アクティブ呼気ポートブロック



(トリロジー200、トリロジーオ2) ユニバーサルポートブロック



スムースエアホース



呼気ポート




プロキシマル圧力ライン



アクティブ呼気バルブ



呼気バルブライン




ユニバーサルPB アクティブPAPアダプタ


(トリロジー200、トリロジーオ2)



フローセンサ (トリロジー200、トリロジーオ2)



酸素取入口クイックコネクト (トリロジー100、トリロジー200)



SDカード



補給用酸素ホース (トリロジーオ2)



2. 概要

本品は、マイクロプロセッサ制御のポータブルタイプ陽圧人工呼吸器であり、鼻マスクや鼻口マスクなどの非侵襲的ルート或いは気管切開などの侵襲的ルートの患者インターフェイスに接続して使用する。本品はAC電源、外部バッテリ、着脱式バッテリ又は内部バッテリを使用して動作する。

PCV(圧力制御換気)とVCV(容量制御換気)の換気タイプが可能であり、PCVでは7種類、VCVでは3種類の換気モードによる呼吸サポートを行う。本品の呼吸回路には、本体からの供給量で換気量を測るパッシブ回路及びアクティブPAP回路と、回路内のフローセンサにより換気量を患者の呼気量で測るアクティブフロー回路の3種類がある。

本品の本体は、換気量を本体からの供給量で測るタイプのトリロジー100、換気量を患者の呼気量で測ることができるタイプのトリロジー200、トリロジー200に酸素混合調節モジュールが装着され外部供給の高圧酸素を濃度調節して供給できるタイプのトリロジーO2があり、3タイプより選択が可能。酸素使用時は、トリロジー100及びトリロジー200は、外部酸素供給源から流量調節された酸素を取り込んだ後、取り込んだ室内空気と酸素を混合し、装置設定の制御で空気・酸素の混合ガスを患者呼吸回路へ供給する(この場合、外部酸素供給源の酸素流量を調節して患者呼吸回路に送出するガスの酸素濃度を調節する。装置本体は酸素濃度を調節しない)。一方、トリロジーO2は、外部酸素供給源から酸素を取り込んだ後、酸素混合調節モジュールにて酸素流量を調節し、取り込んだ室内空気と酸素を混合し装置設定の酸素濃度に調節し、装置設定の制御で空気・酸素混合ガスを送出する。装置の制御は、4つのコントロールボタン(作動/停止ボタン、上下ボタンおよび左右ボタン)によって行う。LCD表示には、操作パラメータや計測パラメータが表示される。SDカードは、メモリーが組み込まれており、処方の設定及び、日時、時間圧力レベル、各使用期間等の患者データを記録できる。

【使用目的又は効果】

本品は器械的人工呼吸による補助が必要な患者を対象として連続的または断続的な換気サポートを行う成人用及び小児用の人工呼吸器であり、医療施設、病院又は在宅で、非侵襲的換気あるいは侵襲的換気を目的として使用される。患者が医療施設または病院内を車いすや移動ベッドで移動中であっても使用できるが、緊急搬送用人工呼吸器としては使用することができない。

<使用目的又は効果に関連する使用上の注意>

- トリロジーO2を在宅で使用しない

【使用方法等】

1. 準備

- 本体に着脱式バッテリ、リユーズブルフィルタを取付ける。
- AC電源コードを接続する。外部DC電源に接続するときは外部バッテリケーブル或いは自動車用DCケーブルを使用する。

「販売名：トリロジーO2 plus」の以下の構成品と併用することができる。

一般的名称	販売名	認証番号
成人用人工呼吸器	トリロジー O2 plus	22600BZX00132000

構成品名	使用できるモデル
ダイヤフラム	100 200 O2
PAP付きアクティブ呼気バルブキット	100 200 O2
PAP付きアクティブ呼気バルブアダプター付き	100 200 O2
アクティブフロー呼気バルブ	200 O2
外部バッテリケーブル	100 200 O2
自動車用DCケーブル	100 200 O2
オキシメトリーインターフェイス	100 200 O2
バクテリアフィルタ	100 200 O2
回路アダプタ 22×22 mm	100 200 O2
回路アダプタ 22×15 mm	100 200 O2
シリコンカプラ	100 200 O2
ディスポエクスハレーションポート WS	100 200 O2
フレックスチューブディスポアクティブ回路用	100 200 O2
フレックスチューブディスポパッシブ回路用	100 200 O2
ディスポーザブル成人用パッシブ回路	100 200 O2
パッシブディスポーザブル回路、22 mm ウォータートラップ付き	100 200 O2
パッシブディスポーザブル回路、15 mm ウォータートラップ付き	100 200 O2
ディスポーザブル小児用パッシブ回路、ウォータートラップ付き	100 200 O2
パッシブディスポーザブル回路、22 mm	100 200 O2
ディスポーザブル成人用アクティブ回路	100 200 O2
ディスポーザブル小児用アクティブ回路ウォータートラップ付き	100 200 O2
MPV用ディスポーザブル回路	100 200 O2


(3) 呼吸回路を本体に接続する。

バクテリアフィルタを使用する場合：呼吸回路の一方の端をバクテリアフィルタの送気口に接続し、バクテリアフィルタの吸気口を本体側面にある呼吸回路接続部に接続する。

バクテリアフィルタを使用しない場合：本体側面の呼吸回路接続部に呼吸回路を直接接続する。

呼吸回路のもう一端を別の呼気バルブに接続する。


1) 回路タイプがパッシブの場合

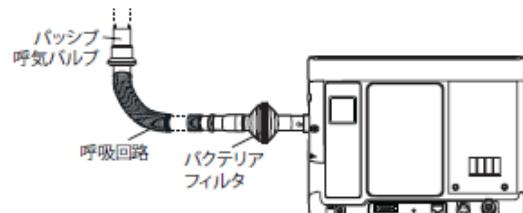

A. 呼吸回路をパッシブ呼気バルブの一端に接続する。

B. パッシブ呼気バルブのもう一端をマスクなどの患者インターフェイスに接続する。


2) 回路タイプがアクティブPAPの場合

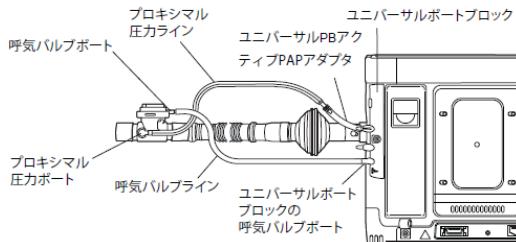

- A. アクティブ呼気バルブに呼吸回路を接続する。
- B-1. トリロジー100 の場合：プロキシマル圧力ラインと呼気バルブラインをアクティブ呼気バルブと本体に取り付けたアクティブ呼気ポートブロックに接続する。
- B-2 トリロジー200、トリロジーO2 の場合：プロキシマル圧力ラインと呼気バルブラインをアクティブ呼気バルブと本体に取り付けたユニバーサルポートブロックに接続する。


3) 回路タイプがアクティブフローの場合

(トリロジー200、トリロジーO2)

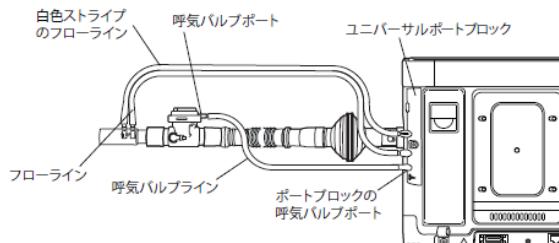


- A. フローセンサーをアクティブ呼気バルブに接続する。
- B. 呼吸回路のもう一端をアクティブ呼気バルブに接続する。
- C. フローラインと呼気バルブラインを本体のユニバーサルポートブロック（トリロジー200、トリロジーO2）に接続する。

4) 回路タイプがMPVの場合

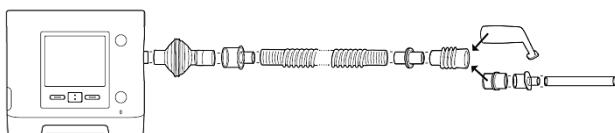


- A. バクテリアフィルタを使用する。
- B. 回路を組立て、マウスピースを接続する。

5) トリロジー100、トリロジー200に補給用酸素を接続する場合

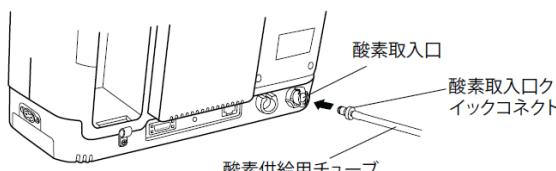

- A. 酸素チューブを酸素取入口ケイックコネクトに接続する。ケイックコネクトを本体背面にある酸素取入口に接続する。
- B. 酸素取入口ケイックコネクトを取り口にカチッと音がして、取入口上部のラッチが飛び出すまでしっかりと押し込む。

6) トリロジーO2に高圧の補給用酸素を接続する場合

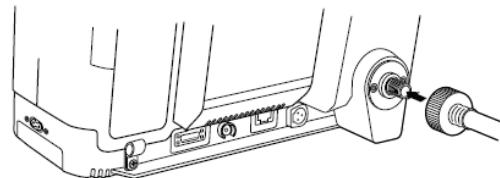

- A. 補給用酸素ホースの一端を本体背面にある酸素取入口に接続する。
- B. 補給用酸素ホースのもう一端を酸素供給源に接続する。

(4) オプションを本体に接続する。

- 1) リモートアラームを接続する場合：リモートアラームの出力ケーブルを本体裏面のリモートアラーム用コネクタに接続する。
- 2) ナースコールシステムを接続する場合：別途用意されたナースコールシステムの出力ケーブルを本体（裏面パネル）のナースコールシステム用コネクタに接続する。
- 3) SDカードを使用する場合：処方やアラームの設定及び治療状況の履歴を記録する場合は、SDカードを本体側面のSDカードスロットに挿入する。
- 4) オキシメトリー モジュールを使用する場合：専用オキシメトリーインターフェースキットを使用して本体裏面のコネクタに接続する。

「販売名：オキシメトリー モジュール」を併用することができる。

一般的な名称	販売名	認証番号
パルスオキシメータモジュール	オキシメトリー モジュール	224AABZI00197000

(5) システムの設定・アラーム等の作動のチェックを行い、システムが正常に作動することを確認する。

2. 使用開始

- (1) 作動／停止ボタンを押すことにより、送気の開始／停止を行う。
- (2) 始動チェックが問題なく行われたことを確認したのち、上下左右ボタンを操作して必要なパラメータを設定・確認する。
- (3) 本体を患者に接続する。

3. 使用後

- (1) 本体を患者から外す。
- (2) 本体から電源コード、呼吸回路等を外す。
- (3) 本体、呼吸回路、リユーズブルフィルタなどをクリーニングする。
再使用可能な呼吸回路等の構成品は滅菌して複数の患者に使用することを意図していない。洗浄および消毒は添付文書及び構成品に付属の取扱説明書の記載に従って実施する。

<使用方法等に関する使用上の注意>

- ・本体に水滴等の液体がかからぬよう使用する。
- ・気道内圧チューブに水滴が流入しないよう、チューブの差込口が常に上になるように設置する。気道内圧チューブに水滴が見られた場合には速やかに取り除く。[水滴でチューブ内が閉塞し、アラームが誤動作したり、適正な換気が維持されない等のおそれがある]
- ・室温が40°Cを超える場合にはエアフロー温度が43°Cを超える可能性がある

あるため、本品は使用しない。また、直射日光が当たる場所で使用しない。

- ・本品をオンにしてから、酸素の供給をオンにする。停止するときには、酸素の供給をオフにしてから、本品をオフにする。この順序を守ることにより、本品内に酸素が蓄積することを防ぐことができる。[本品内に酸素が蓄積すると、火災の危険あり]
- ・内部バッテリはバックアップおよび病院内での輸送のために使用するものであり、主電源として使用するものではない。他の電源が使用できないときや、電源を変えるときなど必要な場合に短時間のみ使用する。
- ・本品に外付けのジェットネブライザを使用すると患者回路へのフローが増大し、酸素濃度、一回換気量、呼吸のトリガなどに悪影響が及ぶおそれがある。
- ・呼吸回路が本体に接続されているにもかかわらず、回路外れアラームが鳴る場合は、回路閉塞がないか確認する。

(酸素添加の場合)

- ・外部酸素モニタを使用して、供給されるガスの酸素濃度を確認する。
〔適切な換気治療のため、正確な酸素投与の確保および誤ったガスへの接続の無いことを確実にする〕
- ・酸素供給源に接続している間は酸素取入口リテナープレートまたは酸素取入口コネクタを取り外さない。[内容物は加圧されているため、ホースが跳ねまわり、使用者が怪我をする可能性がある]

【使用上の注意】

<使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)>

次の症状を持つ患者に、非侵襲的な陽圧治療を目的として本品を使用する前に医師に相談する。

- ・胃内容物の誤嚥を懸念される場合、鼻血等による血液の誤嚥を懸念される場合 [フェイスマスクによる陽圧の使用は危険であり、胃内容物／鼻血の誤嚥の原因となる]
- ・急性副鼻腔炎又は中耳炎 [副鼻腔炎や中耳炎は耳管の働きを妨げることがある。耳内でCPAP圧が増大することで、痛みを引き起こしたり、鼓膜を破る可能性が懸念される]
- ・低血圧 [高い圧により肺の血流を妨げ、心臓へ送る血液が制限されることにより、低血圧の患者の血圧をさらに引き下げる可能性がある]

<重要な基本的注意>

- ・本品を複数の患者に使用する場合や、侵襲的換気を行う場合は、細菌等による感染のリスクを少なくするために、患者と本品の間に当社のバクテリアフィルタを使用する。
- ・非侵襲的換気で人工鼻を使用する場合は十分なガス供給が行われない、或いは十分な加湿効率を得られない可能性があるため、以下のアラームを適切に設定する。
 - PCV(圧力制御換気)で人工鼻を使用する場合：換気量下限
 - VCV(容量制御換気)で人工鼻を使用する場合：気道内圧上限
- ・高レベルの「内部バッテリ電圧低下」や「バッテリ電圧低下」アラームが表示された場合、直ちに本品を代替電源に接続する。代替電源を使用できない場合は直ちに代替の人工呼吸器を使用する。
- ・本品が高温または低温にさらされていた場合は、治療を開始する前に装置を室温になじませる。[結露によって本品が破損する可能性があるため]
- ・加温加湿器を使用する際には、人工鼻を使用しない。[人工鼻のフィル

タは加温加湿器との併用により閉塞し、換気が困難となるおそれがある。また、安全弁を内蔵したマスクと人工鼻を併用した場合にもバルブの動作が正常に行われず、その結果患者に十分なガスが供給されないおそれがある。]

(酸素添加の場合)

- ・喫煙中や火気のある所で使用しない。[酸素は助燃性がある]
- ・トリロジー100及びトリロジー200は未調整または高圧の酸素供給源に接続しない。トリロジーO2は制御装置のない酸素供給源を接続しない。[装置が故障するおそれがある]
- ・本品は、低流量の酸素供給停止でアラームを発しないため、アラーム機能の付いた生体モニタを併用する。

<妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用>

- ・本品は体重5kg以上の患者を対象としている。[体重5kg未満の患者に対する有効性・安全性の確認は実施されていない]

※ AVAPS-AEモードを体重10kg未満の患者に使用しない。[適切な換気サポートが得られないため]

<その他の注意>

- ・本品の患者や操作者が触れる部分、またはエアーパスおよび呼吸回路には、天然ラテックスゴムまたは乾性天然ゴムは含まれていない。
- ・AVAPS-AEモードを侵襲的陽圧治療で使用しない。[適切な換気サポートが得られないため]

【保管方法及び有効期間等】

<耐用期間>

5年 [自己認証データによる]

(添付文書、取扱説明書、当社保守管理規定にもとづく保守・点検を実施した場合。)

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検

・本体：

電源から外した後、水と以下の洗浄剤で軽く浸した布で外面を拭く。
-石鹼水または中性洗剤
-過酸化水素 (3%)
-イソプロピルアルコール (91%)
-10%の漂白剤溶液
柔らかな乾いた布でふき取りをし、十分に乾燥させる。

・エアフィルタ：

リユーズブルタイプのエアフィルタは、2週間に一度洗浄を行い、6ヵ月に一度新品と交換する。洗浄は、温水に中性洗剤を希釈した溶液で行い、乾燥させる。

※ディスポーザブルタイプのエアフィルタは、洗浄による再使用はできないので、30日間又は汚れが目立った場合は交換する。

・呼吸回路チューブ：

本体から外した後、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗浄し、十分にすいでから、自然乾燥させる。

なお、本品は滅菌して複数の患者に使用しない。

業者による保守点検

・定期点検 1：1年後およびその後2年毎に実施する。

装置の分解・クリーニング、総合調整・検査、部品交換を行う。

- 定期点検2：2年後に実施する。

装置の分解・クリーニング、総合調整・検査、部品交換を行う。

- オーバーホール：4年後に実施する。

装置の分解・クリーニング、総合調整・検査、部品交換を行う。

【主要文献及び文献請求先】

1.主要文献

- 1) British Thoracic Society Standards of Care Committee, Non-invasive ventilation in acute respiratory failure, Thorax 2002, 57:192-211
- 2) Sean P. Keenan et al., Clinical practice guidelines for the use of noninvasive positive-pressure ventilation and noninvasive continuous positive airway pressure in the acute care setting, The Canadian Medical Association Journal, February 22, 2011;183(3) E195-E214, 294

2.文献請求先

* 株式会社フィリップス・ジャパン
東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
マーケティング部 電話番号：03-3740-3245

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者：株式会社フィリップス・ジャパン

<緊急連絡先>

1. 平日 9:00～17:30
機器安全センター 0120-633881
2. 平日 17:30以降～翌9:00、土・日曜日と祝祭日
機器安全センター 0120-633881

製造業者：Respironics, Inc.

レスピロニクス インク
アメリカ合衆国