＊＊ 2020年7月（第7版）
＊ 2017年10月（第6版）（新記載要領に基づく改訂、他）

医療機器認証番号 223AFBZX00112000

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器　呼吸回路セット　JMDNコード 70566000

ブリージングシステム

再使用禁止

【警告】

＊＊ ◆ 本品を使用する前に、呼吸回路の接続部及び給水チューブの給水器への接続部が確実に接続されていることを確認し、人工呼吸器等に接続し、リークや閉塞がないことを確かめてください［閉塞やリークにより換気障害が生じる恐れがあります］。

◆ チャンバへの給水が最高水位表示より下の適正水位にあることを確認してください。チャンバへの給水が最高水位表示を超えた場合は給水を中止し、チャンバを交換してください［呼吸回路内に水が入る恐れがあります］。

◆ チャンバは傾けて設置しないでください［呼吸回路内への水の流入を防ぐため］。

＊＊ ◆ 給水は自動給水システムより給水してください［誤接続による火傷、人工呼吸器回路内の汚染の可能性があります］。（主要文献1.参照）

【禁忌・禁止】

◆ 再使用禁止

＊＊ ◆ 消毒・滅菌処理をしないでください［本品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります］。

＊＊ ◆ チャンバに給水する際にはガスポートを使用しないでください［誤接続による火傷、ガスポートを介した菌による人工呼吸回路内汚染の可能性があります］。（主要文献2.参照）

＜併用医療機器＞

＊＊ ◆ 加温加湿器を使用する場合は、人工鼻との併用はしないでください［人工鼻のフィルタが閉塞し、換気が困難となる恐れがあります］。（主要文献1.参照）

【形状・構造及び原理等】

＊＊ 1. 構成

＊＊ 本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。

＊＊ 2. 形状、寸法

＊＊ 1) ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰﾜｲﾔ成人用加温加湿呼吸回路（PMC-300AFﾂｷ）（50519700）

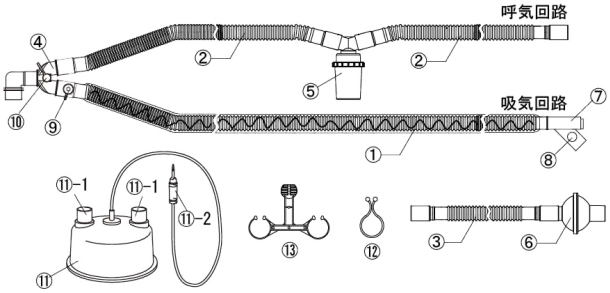

＊＊

	セット内容
①	チューブ（ブルー）ヒーターワイヤ入り（吸気用アダプタ、温度ポート付）内径22mm 長さ150cm
②	チューブ（クリア）内径22mm 長さ75cm
③	チューブ（ブルー）内径22mm 長さ45cm
④	パラレルYピース（シングルポート、キャップ付）
⑤	ウォータトラップ
⑥	フィルタBSF103
⑦	アダプタ1
⑧	温度ポート
⑨	温度ポート
⑩	シングルポート（キャップ付）
⑪	チャンバ PMC-300AF
⑪-1	ガスポート
⑪-2	針
⑫	チューブクリップ
⑬	チューブハンガー

＊＊ 3. 作動原理

＊＊ 使用目的に合わせ、構成品を選択して使用することにより、人工呼吸器等の呼吸回路部品として使用できる。呼吸回路は中空である呼吸管内にガスを通過させることによって目的の場所に送気するものである。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】

＜併用機器等＞

給水用水：再シール性ゴム栓付水容器（ボトル又はバッグ）に入った市販の滅菌蒸留水等を使用してください。

＜使用方法＞

＊＊ 1. チューブ③の一端に付いたフィルタ⑥を人工呼吸器に接続してください。チューブ③の他端はチャンバ⑪の一方のガスポート⑪-1に接続してください。

＊＊ 2. チューブ①のアダプタ1⑦をチャンバ⑪の他方のガスポート⑪-1に接続してください。

＊＊ 3. 加温加湿器の取扱説明書に従い、加温加湿器の吸気ヒータコネクタをアダプタ1⑦の吸気ヒーターワイヤプラグに接続してください。

＊＊ 4. 加温加湿器の取扱説明書に従って、加温加湿器に接続された温度プローブの患者口元用温度センサ及びチャンバ用温度センサをそれぞれ温度ポート⑨及び⑧に接続してください（温度ポート⑨/⑧を使用しない時には、漏れがないように付属のポートキャップをしっかり取付けてください）。

＊＊ 5. シングルポート⑩を使用しない時には、漏れがないように付属のポートキャップをしっかり取付けてください。

＊＊ 6. テストラングを使用して人工呼吸器が正しく作動することを確認してください。

7. 加温加湿器の取扱説明書に従って加温加湿器を作動させてください。

＊＊ 8. チャンバの給水チューブの針⑪-2を水容器のゴム栓に根元までしっかり差し込んでください。水容器をチャンバ上部より50cm高い位置に設置してください（水容器の種類に応じて、給水チューブの通気針キャップを開けてください）。

9. 給水が最高水位表示より下で止まるのを確認してください。

C0276-B3
Rev. 7

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

◆ 本品は、ヒータワイヤタイプの加温加湿器に使用してください。

＊＊ ◆ ウォータトラップの排水は適宜行い、排水後は、貯水カップを垂直に差し込み、時計方向に丁寧に回して、貯水カップを正確に取付けてください［貯水カップが適切に接続されていないとリークの原因となります］。

＊＊ ◆ 本品に過剰な負荷がかからないように注意してください［回路の潰れや折れ曲がりにより、閉塞等の原因となるため］。

◆ 回路の接続部を万一外した場合は、コネクタのテーパー表面に水その他の付着がなく、清潔かつ乾燥した状態で接続してください。

＊＊ ◆ 使用中は患者さんの状態に十分に注意を払ってください。

＊＊ ◆ 使用中に回路の外れや折れ曲がりが無いよう適宜確認してください。

＊＊ ◆ ヒーターワイヤ入り呼吸回路部に設けたスリーブは、保温用保護カバーであるため、取らずに使用してください。

＊＊ ◆ 呼吸回路に空気漏れ等の問題がある場合は、すぐに呼吸回路を交換してください。

＊＊ ◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。

＊＊ ◆ 回路内に過度の結露がないことを定期的に点検してください。異常を認められた場合は、直ちに新しい呼吸回路と交換してください。

＊＊ ◆ 30℃以上の温水をチャンバへ給水しないでください。

＊＊ ◆ 給水用水容器内の水がなくなったら速やかに水容器を交換してください。

◆ チャンバには、アルコールなどの薬液をかけないでください。

＊＊ ◆ チャンバへの換気流量は最大流量（180L/分）を超えないようにしてください。

＊＊ ◆ 給水用水容器がボトルの場合には、給水チューブの通気針キャップを開けておいてください。

＊＊ ◆ 給水用水容器とチャンバの高低差は、50cm以上となるようにしてください。

＜その他の注意＞

＊＊ ◆ 直射日光、高温、多湿な場所や、水濡れを避けて室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

＊＊ ＜保管環境＞

温度：－10～50℃

＊＊ 湿度：15～95%（非結露）

＜使用期間＞

2週間を目安に使用してください（自己認証による）。

＊＊【主要文献及び文献請求先】

＊＊（主要文献）

＊＊ 1. 薬食審査発第1126009号/薬食安発第1126001号「加温加湿器に係る使用上の注意等の改訂について」（平成16年11月26日、厚生労働省）

＊＊ 2. 薬食安発第0911004/薬食安発第0911002号「人工呼吸器回路における人工鼻と加温加湿器の併用に係る添付文書の自主点検等について」（平成21年9月11日、厚生労働省）

＊＊（文献請求先）

＊＊ アイ・エム・アイ株式会社　レスピラトリ・ケア部

＊＊ TEL：03-6779-8414

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊＊ 製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

＊＊ 製造業者名（国名）：Vincent Medical（Dong Guan）Manufacturing Co., Ltd.
（ビンセントメディカル（ドングァン）マニファクチャリング社）（中国）