機械器具(05)麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000 管理医療機器

(単回使用人工呼吸器呼吸回路

37706000) (単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012)

# セレクトY呼吸回路

YAR

#### 再使用禁止

#### 【警告】

1. 本品を他の製品と接続する場合は、接続に誤りがないこと、接続 部が確実に接続されていること、無理な力が加わっていないこ と、閉塞やガス漏れ等が生じていないことを、接続時に確認し、 使用中も十分な管理、観察を行うこと。 [閉塞やリークにより、 呼吸に障害が生じる可能性がある。]

# 【禁忌・禁止】

# 使用方法


- 1. 滅菌、洗浄禁止
- 2. 再使用禁止

# 【形状・構造及び原理等】

- 1. 各部の名称
- (1)接続した状態\*

メラブリージングコネクタ セレクトY呼吸回路

(2) セレクトY呼吸回路(未滅菌) \* YAR

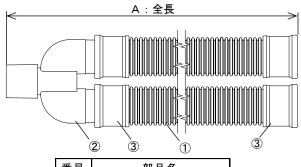

| 番号 | 部品名         |
|----|-------------|
| 1  | 呼吸管大        |
| 2  | パラレルYピース大R  |
| 3  | 22mmメスコネクタ大 |

# 2. 種類と構成\*

| 英に 円次・    |                   |  |  |
|-----------|-------------------|--|--|
| 型式        | 全長 (m)<br>図1のA部寸法 |  |  |
| YAR-90-X  | 0. 9              |  |  |
| YAR-120-X | 1. 2              |  |  |
| YAR-150-X | 1.5               |  |  |
| YAR-200-X | 2. 0              |  |  |
| YAR-300-X | 3. 0              |  |  |
| YAR-500-X | 5. 0              |  |  |

型式の「X」にメラブリージングコネクタの種類(G:エルボコネ クタ (ギアードスイベル)、又は S: エルボコネクタ (ポート付)、 又は N:エルボコネクタ)) が入る。

認証番号: 226ADBZX00201000

#### 3. 原理

麻酔システム (麻酔器)、又は人工呼吸器から、吸気管とメラブ リージングコネクタを通して、患者へ空気又は酸素を含む医療ガ スを送入する。患者から排出される呼気はメラブリージングコネ クタと呼気管を通り装置へ戻される。

#### 【使用目的、効能又は効果】

セレクトY呼吸回路は、麻酔器又は人工呼吸器から患者への空気又 は酸素を含むガスの送入に用いる。メラブリージングコネクタは、 利便性のため気管チューブ、フェースマスクとセレクトY呼吸回路 のパラレルYピースを接続するために用いる。

# 【品目仕様等】

内圧 6±0.3kPa (60hPa±3hPa) でのガス漏れ量は毎分 50mL 未満

# 【操作方法又は使用方法等】

#### 使用方法

本品(未滅菌)は、単回使用製品であるので、再使用しないこと。

- 1. 呼吸管の 22mm メスコネクタ大を麻酔器、又は人工呼吸器の吸 気接続口、呼気接続口にしっかりと接続する。\*
- 2. パラレル Y ピース大Rの患者側端へ必要に応じて付属のメラブ リージングコネクタを接続する。\*
- 3. 併用する装置の添付文書等に従って漏れを確認する。

#### 使用方法に関連する使用上の注意

- 1. 本品の包装に破れ、汚れ等の異常がある場合は、使用しないこ
- 2. 本品に亀裂、破損がある場合は、本品を使用しないこと。
- 3. 使用前に閉塞、捻れ及びキンクがないことを確認すること。
- 4. YARを使用する場合、使用前にパラレルYピース大Rと呼吸 管大がしっかり接続されていることを確認すること。
- 5. 本品は、蛇管ホルダー等を用いて固定し、荷重が掛からないよ うにすること。[接続部の外れ、漏れ等を誘発する可能性があ
- 6. 呼吸管を極端に捻らないこと、または折り曲げないこと。
- 7. 患者の体位を変更した場合は、本品を適切な位置に変更するこ ۽ ع

#### 【使用上の注意】

### 重要な基本的注意

- 1. 本品は目的用途以外には、使用しないこと。
- 2. 医師の指示の下で使用すること。
- 3. 併用する(特に接続する)医療機器の添付文書等は、必ず読 み、安全確認を行ってから使用すること。
- 4. 本品はコネクタ接続部の形状が JIS T 7201-2-1:1999 に適合 した医療機器と接続して使用すること。
- 5. 本品をアルコール等の有機溶媒で清拭しないこと。 [ひび割 れ等の危険がある。]
- 6. 使用中は患者の状態に十分に注意を払い、本品に無理な力が 加わらないようにし、回路に異常が認められた場合は、ただ ちに回路を交換すること。

- 7. 結露した水が溜まった場合は、直ちに本品を新しいものと交換すること。[通気抵抗の上昇の可能性がある。]
- 8. 本品は未滅菌のため、清潔野で使用しないこと。
- 9. 本品使用後は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、院内で定められた手順等に従い適切に廃棄すること。
- 10. 可燃性ガスと併用しないこと。
- 11. 本品を改造しないこと。

# 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水濡れ、ほこり、高温 (50℃以上)、多湿、直射日光にあたる 場所、振動の激しい場所、凍結する場所等は避けること。

#### 有効期間・使用の期限

包装箱に記載。[自己認証(当社データ)による]

#### 【包装】\*

全長 0.9m~2.0m: 1個/1袋、5袋/1箱に収納 全長 3.0、5.0m: 1個/1袋、2袋/1箱に収納

# 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社 埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

#### 製造業者

メラセンコー コーポレーション (MERASENKO CORPORATION) 国名:フィリピン

#### お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画 TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011

文書管理番号: AA-3106-02