2024年7月22日(第1版)　類別：機械器具16 体温計　　医療機器認証番号:第227AKBZX00022A03号

管理医療機器　一般的名称：電子体温計（JMDN 14032010）

販売名：電子体温計ＴＯ－206

【警告】
・お子様だけでご使用にならないでください。

【禁忌・禁止】
・人以外の検温にはご使用にならないでください。
・測定結果の自己判断や治療は危険ですので、医師の診断に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

本体

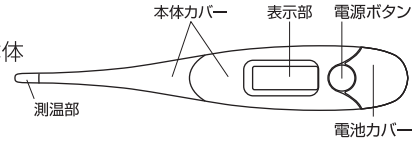

表示部

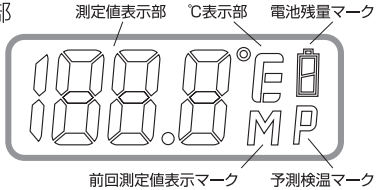

＜表示内容＞
・測定値表示部：測定した最高温度を表示
　31.9℃以下は「L」を表示
　43.0℃以上で「H」を表示
・前回測定値表示マーク：前回測定した測定値を表示
・℃表示部：測定した温度とともに「℃」表示
・電池残量マーク：電池の消耗時に表示
・予測検温マーク：予測検温中に表示

＜本体の寸法および質量＞
・寸法　長さ140mm 幅22mm 厚さ12mm
・質量　13g（ボタン型電池を含む）

＜電気的定格＞
・定格電圧:DC1.5V・電源:アルカリボタン型電池（LR41）
・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
・電源に対する保護の程度による装着部の分類:BF形装着部

＜原理＞
測温部にあるサーミスタが温度により、電気的抵抗値が変化する特性を応用して、抵抗値の変化を集積回路で演算処理し、平衡温を予測した後、測定値を体温として表示部に表示します。

＜付帯機能＞
初期動作確認告知、実測検温終了告知、測定温度範囲外告知、自動電源遮断機能、予測成立告知

【使用目的、効能又は効果】
測温部を部位に接触させて、脇下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示する。

【品目仕様】
・温度測定範囲　　：32.0～42.9℃
・測定精度　　：±0.1℃（恒温水槽で実測測定した場合）
・使用環境温湿度：10～40℃、30～90%RH（結露なきこと）

【操作方法又は使用方法等】
（1）電源ボタンを押す。
（2）“ピッ”音の後に表示部の全セグメントが表示される。その後、表示部右上に“℃”右下に“M”が表示され、前回測定値が2秒間表示される。
（3）“L”が表示され、“℃”の点滅が開始し、予測検温マーク“P”が点灯し、測定可能となる。
（4）測温部を脇下に密着させ安静にする。
・予測検温の場合：
約15秒後にブザー音が“ピー、ピー、ピー”×3回鳴り、“℃”が点灯に変わったら予測検温が終了である。検温結果は約3分保持される。
・実測検温の場合：
予測検温結果の保持後も検温を続けると、予測検温マーク“P”が消え、“℃”の点滅が開始し実測検温になる。ブザー音が“ピー、ピー、ピー”×3回鳴り、“℃”が点灯に変わったら実測検温が終了である。
（5）表示部に測定された体温が表示される。
（6）電源ボタンを押せば、電源OFFになる。
（7）電源ボタンを押さない場合は、電源を入れてから約12分後に電源OFFになる。

【使用上の注意】
（1）小さなお子様の手の届かないところで保管してください。また、お子様にご使用の際は、先端の測温部で目を突いたり、電池を誤飲しないよう保護者の監視下でご使用ください。
（2）運動、食事、入浴の後は十分な時間をおいてから体温を測定してください。
（3）体温以外の測定及び、人以外の検温に使用しないでください。
（4）脇下以外では検温しないでください。
（5）本体に傷や破損がないこと確認し、異常がある場合は使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
（1）高温や直射日光のあたる場所、湿気の多い場所や水のかかる場所、ほこりの多い場所、腐食性ガスの発生する場所で保管しないでください。
（2）ご使用後は、乾いた布等で測温部を拭き、清潔な状態で収納ケースへ収納し、保管してください。

【取り扱い上の注意】
（1）分解、改造、修理は絶対行わないでください。
（2）電池カバー部分は防水性がありません。電池カバー部分に水等をかけたり、本体に水等をつけたりしないでください。
（3）熱湯消毒はしないでください。
（4）丸洗いや超音波洗浄はしないでください。
（5）極端に曲げたり落としたり強い衝撃を与えないでください
（6）体温を測定する時、周囲温度が体温より高いような場合は測温部に水をかけ、測温部を冷やしてから測定し、終了のお知らせ音が鳴ったらすぐ表示値を読み取ってください。
（7）電池が消耗した場合、表示部の右上に電池残量マークが表示されます。このような場合、電池を交換してください。
（8）電池交換の方法は、取扱説明書をご参照ください。

【使用の期間】
　使用の期間の目安：５年（自己認証）

【保守・点検に関わる事項】
（1）使用前に清潔な状態にし、作動するか（電源が入るか）を確認してからご使用ください。
（2）汚れは、中性洗剤又はアルコールを染み込ませた布でよく拭いてください。

【包装】
本体・収納ケース１台／個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社ドリテック
製造業者　　：VEGA TECHNOLOGIES INC.（中国）
連絡先　株式会社ドリテック　お客様相談センター
〒343-0824　埼玉県越谷市流通団地2-3-9
電話：0120-875-019
（月～金 9:00-12:00,13:00-17:00
祝祭日および当社指定休日を除く）

取扱説明書を必ずご参照ください。