

管理医療機器
特定保守管理医療機器

機械器具 21 内臓機能検査用器具
テレメリー式心電送信機 36367000
myBeat ホーム ECG

【禁忌・禁止】

〈併用医療機器〉

1. 除細動器 (AED) と併用しないでください。[機器が故障するおそれがあります]
2. 磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置) と併用しないでください。
[MRI 装置に吸引されるおそれがあります。誘導起電力により局部的に発熱し熱傷することがあります]
- *3. 植込み型心臓ペースメーカまたは植込み型除細動器などの電磁波に影響を受ける医療機器と併用する必要がある場合には、医師に確認すること。[誤動作することがあります]
4. 一人用または多人数用高圧酸素患者治療装置と併用しないでください。[爆発または火災を起こすことがあります]
5. 可燃物性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内で使用しないでください。[爆発または火災を起こすことがあります]

****【形状・構造及び原理等】**

****〈構造図〉**

本体及び付属品は単体にて販売する場合があります。

****1. 本体**

おもて



うら

電極装着用フック



****2. 付属品 (オプション)**

myBeat ホーム ECG 用アタッチメント (届出番号 13B2X1019000 0003)

myBeat 心電計 (iOS 端末専用アプリ又は Android 端末専用アプリ)

myBeat 心電計用クラウドソフトウェア

〈寸法及び質量〉

寸法: 37.5(W) × 48.7 (H) × 12.5 (D) mm

質量: 15.5g (電池は含みません)

〈電気的定格〉

電気定格: DC3V 0.015W

電池の型式: CR2032

容量: 220mAh

連続使用時間: 35 分

〈機器の分類〉

電撃に対する保護の形式: 内部電源機器

電撃に対する保護の程度: BF 形装着部

作動モード: 連続作動

〈原理〉

本品は、誘電チャンネルの心電図信号を無線転送する装置であり、心電図信号は体表面に接触した電極を介して入力され、この活動電位を増幅して AD 変換 (デジタル化) します。デジタル化した心電図信号は、転送先の携帯端末へ Bluetooth 4.0 で逐次送信されます。本体に心電図波形の表示機能はなく、転送先の携帯端末の画面に心電図波形が表示されます。測定後、心電図信号はクラウドサーバーへ転送、保存されます。保存された心電図波形は、転送先の携帯端末で表示できます。

【使用目的又は効果】

本品は、心電図信号を収集し無線を用いて送信すること。

****【使用方法等】**

1. 事前準備

(1) 電池の取り付け

myBeat ホーム ECG は、型式 CR2032 の電池を 1 個使用します。

電池の型式に注意してください。(マクセル株式会社製推奨)

- 1) 本体裏面の電池蓋開口部を矢印の方向へスライドし、電池蓋を開きます。



- **2) 電池蓋の裏側に貼られた極性表示を参考に、電池のプラス (+) 極を上にに向けて電池を挿入します。このとき電池は片側が少し浮いた状態になります。



- 3) 電池蓋をかるく引いて下ろし、浮いた電池を上から押しながら電池蓋を元の位置に戻します。電池蓋が閉まったときに「カチッ」と音がすることを確認してください。
- 4) 電池蓋を閉める際は指を挟まないようご注意ください。

(2) 電極の取り付け

myBeat ホーム ECG 用アタッチメント（手に持って測定するタイプの電極）

本体裏面の電極装着用ホックと myBeat ホーム ECG 用アタッチメントの装着用ホックを合わせて、カチッと音がするまで押し込みます。



※図を参考に本体の向きを正しく取り付けてください。

** (3) iOS 端末専用アプリ又は Android 端末専用アプリのインストール

iOS 端末又は Android 端末を用意してください。

iOS 端末の場合は AppStore、Android 端末の場合は GooglePlay から「myBeat 心電計」を検索し、インストールしてください。
また、インストールする際は以下の OS バージョンであることを確認してください。

- ・ iOS 端末：OS バージョン 10.0 以降
- ・ Android 端末：OS バージョン 5.0 以降

2. 使用中

(1) 電源 ON

電源スイッチを ON 側へスライドし電源を入れます。



(2) 測定方法

本体からのデータを受信する端末の準備が完了したら、下記のいずれかの方法で安静にした状態で測定します。

1) I 誘導（推奨）

myBeat ホーム ECG 用アタッチメントを両手で保持して測定します。




- ① myBeat ホーム ECG 用アタッチメントの右手親指用くぼみ（青丸部）に右手の親指を添え、上部から右側電極部にかけて右手人差し指をかるく当てるようにして持ちます。
- ② 左側電極部を左手のひらにかるく押し当てます。
- ③ 座位で両肘を台の上などに置いて固定し、腕や肩の力を抜いてください。

注意事項：

- ・ 両手を互いに触れさせないでください。

2) V4 類似誘導

myBeat ホーム ECG 用アタッチメントを右手で持ち、左側電極部を胸に押し当てて測定します。

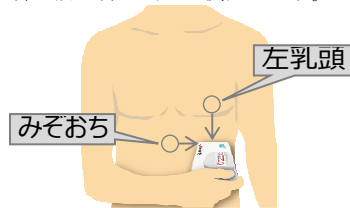

- ① myBeat ホーム ECG 用アタッチメントの右手親指用くぼみ（青丸部）に右手の親指を添え、上部から右側電極部にかけて右手人差し指をかるく当てるようにして持ちます。
- ② 左側電極部を左乳頭の下約 5cm（みぞおちと同じ高さ）にある骨にかるく押し当てます。

注意事項：

- ・ 腕の力を抜いてください。

**** 肌が乾燥している場合は、湿らしたタオルやガーゼで、押し当て部位を適度に湿らせてください。**

3) その他測定可能な箇所

myBeat ホーム ECG 用アタッチメントを右手で持ち、左側電極部を身体の一部にかるく押し当てて測定します。

(3) 測定する

- 1) 転送元の携帯端末の画面上に心電図波形が表示され 5 秒後に、測定開始されます。測定時間は 40 秒です。



- 2) 測定が終わると心電図信号は、クラウドサーバーへ転送され、保存されます。

3. 使用后

電源スイッチを OFF 側へスライドし電源を切ります。



転送先の携帯端末で心電図波形を表示できます。

〈組み合わせて使用する医療機器〉

1. 本品は、販売名「myBeat ホーム ECG 用アタッチメント（届出番号 13B2X10190000003）」と併用できます。

****2.** 本品は、販売名「myBeat デイスポーザブル電極（届出番号 13B2X10190000002）」と併用できます。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品を入浴など水中や水滴のかかる環境、または結露する環境では使用しないでください。
2. 本品内部に液体等が侵入したと思われる場合は使用を中止してください。
3. 肌表面を水で湿らせたタオルやガーゼなどで拭いて、適度に湿らせてください。
4. 皮膚に赤みやかゆみ、痛み等のアレルギー反応が見られる場合はすぐに使用を中止してください。
5. 乗り物の中など、振動が激しい環境では使用しないでください。
6. 健康器具など身体に振動が加わる環境では使用しないでください。
7. 本品は型式 CR2032（コイン形）の電池を使用しています。電池は乳幼児が誤飲すると重篤な症状が生じることが報告されております。使用、保管の際、または電池の廃棄については十分に注意してください。
8. 電子レンジや電気毛布などの電磁波を発生する機器の近くでは使用しないでください。通信が妨げられる可能性があります。
9. 周辺に Bluetooth 機器や Wi-Fi 機器が多く存在する環境では、混信により通信が妨げられる可能性があります。
10. 本体の LED ランプが消灯または赤点灯の場合は、電池を交換してください。
11. 使用しない時は電源を OFF にし、本体から電池を取り外してください。
12. 運搬時や保管時は、落下させたり大きな振動を加えたりしないよう注意してください。
13. 分解、または改造はしないでください。機器の破損につながる、または機能が確保できなくなる可能性があります。
14. 廃棄の際は、地域等の定めに従って廃棄してください。
15. ペースメーカーのペーシング信号の確認には使用しないでください。
16. 筐体が破損した状態で本品を使用しないでください。
17. 電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
18. 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
19. 本品の電極装着用ホックには、組み合わせて使用する医療機器以外、いかなる導電性部品も接触させないでください。

*＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
除細動器（AED）との併用	併用禁止	機器が故障するおそれがあります。
可燃物性麻酔ガス及び高濃度零囲気内での使用	使用禁止	爆発または火災を起こすことがあります。
植込み型心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器	医師に確認すること。	機器が誤動作することがあります。
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	MRI 検査を行うときは、患者から取り外してください。	誘導起電力により局部的に発熱し熱傷のおそれがあります。
高圧酸素患者治療装置	装置内に持ち込まないでください。	爆発または火災を起こすことがあります。

【保管方法及び有効期間等】

＜耐用期間＞

6 年〔自己認証（当社データ）による〕

ただし、指定の保守・点検を実施した場合に限りです。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

**1. 点検

点検頻度	対象	点検項目
使用前	本体 myBeat ホーム ECG 用アタッチ メント	・外装の傷、破損、割れ、変形、 錆 ・外装の汚れ ・銘板の汚れ、剥がれ ・電極の挿抜
	本体	・電源スイッチの動き ・LED ランプの表示

点検の方法については、取扱説明書の「保管・保守方法」の項を参照してください。

2. 清掃

- (1) 汚れを感じたら、水または中性洗剤を染み込ませ、かたく絞った布で汚れを拭き取った後、やわらかい布で乾拭きしてください。
- (2) 定期的に清掃してください。定期的に清掃することにより以下の効果があります。
 - ・本機器の金属部分の錆を防ぐことができます。
 - ・本機器を清潔に保つことができ、雑菌の繁殖が防げます。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 0120-923-107

製造業者

ユニオンツール株式会社 テクニカルセンター