

機械器具21 内臓機能検査用器具  
高度管理医療機器 心臓カテーテル用検査装置 70052003  
特定保守管理医療機器 **Rhythmia HDx マッピングシステム**

【禁忌・禁止】

1.使用方法

- \*\* (1) Rhythmia HDx マッピングシステム(以下、本品という)及び  
附属品を高濃度酸素雰囲気内又は可燃性麻酔薬付近で  
作動させないこと。[爆発により、患者や医療従事者の障害  
や死亡の原因となることがある。]

【形状・構造及び原理等】

1.構成と各部の名称

本品は、以下の構成品及び附属品から成る。

| 構成<br>品及び<br>附属品                                | 機能                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) シグナル<br>ステーション                              | すべての信号を統合する装置である。接続さ<br>れる機器(マッピング専用カテーテル※、体表<br>面 ECG 電極(バックパッチ※及び ECG パッ<br>チ※)、電極カテーテル)等の信号が入力され<br>る。入力された信号はワークステーション及<br>び EP 検査装置※に出力される。<br>心臓刺激装置から入力されたペーシング用<br>信号を電極カテーテル※へルーティングする<br>ことまた、マッピング専用カテーテル※のコン<br>ディショニングを行うことが可能である。 |
| (2) ブレークアウト<br>ボックス                             | 標準 2mm ピンを最大 64 極接続可能なコネ<br>クタボックスである。<br>電極カテーテル※の心内信号をシグナルステ<br>ーションに入力するための接続ボックスであ<br>る。                                                                                                                                                    |
| (3) ローカライゼー<br>ションジェネレ<br>ータ                    | 磁場を発生させるジェネレータ。患者の背面<br>(患者台の下)に設置し使用する。                                                                                                                                                                                                        |
| (4) コネクション<br>ボックス                              | アブレーションカテーテル※と経皮心筋焼灼<br>術用電気手術ユニット(以下、高周波発生装<br>置)及びシグナルステーションを接続する。<br>高周波発生装置からの高周波信号をアブレ<br>ーションカテーテルに転送し、アブレーション<br>カテーテルからの心内信号及びインピーダ<br>ンスをシグナルステーションに転送する。                                                                              |
| (5) ECG<br>出力ボックス                               | シグナルステーションに入力された ECG 信<br>号を EP 検査装置※に出力するための接続ボ<br>ックスである。<br>(8)~9「ECG ダイレクトコネクケーブル」を<br>使用するには、使用できない。                                                                                                                                       |
| (6) ワーク<br>ステーション<br>(PC、モニタ、<br>キーボード、<br>マウス) | シグナルステーションからの信号を取得し、リ<br>アルタイムで 3 次元マッピング画像、ECG 信<br>号等を表示する。<br>光学式ドライブ、USB ポート、SD カードリーダ<br>といった一般的なメディアインターフェイスが<br>備わっており、データの入出力が可能であ<br>る。                                                                                                |
| (7) フットスイッチ<br>(オプション)                          | 手動マッピングに使用する。マッピングポイン<br>ト(位置情報及び心内信号)取得のオン/オ<br>フを行うスイッチである。                                                                                                                                                                                   |
| (8) ケーブル                                        | 下表参照                                                                                                                                                                                                                                            |

※:本システムに含まれない。

\*\*

| ケーブル<br>番号 | 名称                                      | 接続例                          |                  |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|
|            |                                         | 接続元                          | 接続先              |
| (8)-1      | 電源コード(AC-DC コ<br>ンバータ付き)                | AC 電源                        | シグナル<br>ステーション   |
| (8)-2      | 電源コード                                   | AC 電源                        | ワークステ<br>ーション PC |
|            |                                         | AC 電源                        | ワークステ<br>ーションモニタ |
| (8)-3      | イーサネットケーブル                              | シグナルステ<br>ーション               | ワークステ<br>ーション PC |
| (8)-4      | ブレークアウトボックス<br>ケーブル                     | ブレークアウト<br>ボックス              | シグナル<br>ステーション   |
|            |                                         | マッピングシ<br>ステムモジュ<br>ール(MSM)※ | シグナル<br>ステーション   |
| (8)-5      | ローカライゼーション<br>ジェネレータケーブル                | ローカライゼー<br>ションジェネレ<br>ータ     | シグナル<br>ステーション   |
| (8)-6      | パッチコネクションケ<br>ーブル                       | バックパッチ※                      | シグナル<br>ステーション   |
| (8)-7      | ダイレクトコネクケー<br>ブル                        | シグナル<br>ステーション               | EP 検査装置<br>※     |
| (8)-8      | ブレークアウトケー<br>ブル                         | シグナル<br>ステーション               | EP 検査装置<br>※     |
| (8)-9      | ECG ダイレクトコネク<br>ケーブル                    | シグナル<br>ステーション               | EP 検査装置<br>※     |
| (8)-10     | RS232 シリアルケー<br>ブル及び USB- RS232<br>ケーブル | 高周波発生装<br>置※                 | ワークステ<br>ーション PC |
| (8)-11     | 2mm ピン(2-2)ケー<br>ブル                     | 心臓電気刺激<br>装置(以下、心<br>臓刺激装置)※ | シグナル<br>ステーション   |
| (8)-12     | ファイバーオプティッ<br>クアダプタ                     | ワークステ<br>ーション PC             | モニタ<br>(オプション)   |

※:本システムに含まれない。

2.システム接続例及びシグナルステーション接続部

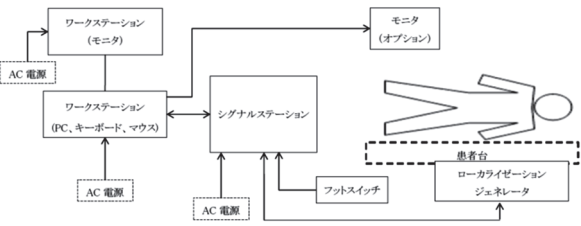


図 1 システム接続例

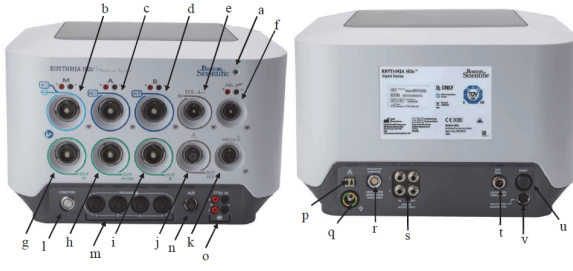


図 2 シグナルステーション各接続部

シグナルステーションの機能又は接続を以下に示す。

| ** | 名称                    | 機能又は接続                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a  | ステータスライト              | シグナルステーションの電源がオンの時に点灯する。                                                                                                                                               |
| b  | 入力コネクタ                | M IN<br>マッピングカテーテル用ケーブル*を接続する。マッピング専用カテーテル*からの信号が入力される。ブレイクアウトボックスに接続されたカテーテル*から信号を収集する。<br>ダイレクトペーシングを行うための経路を有する。                                                    |
| c  |                       | A IN<br>ブレイクアウトボックスを接続する。ブレイクアウトボックスに接続された電極カテーテル*等からの信号が入力される。<br>ダイレクトペーシングを行うための経路を有する。NAV モデル*と併用する場合はマッピングシステムモジュール (MSM) *と接続する。                                 |
| d  |                       | B IN<br>ブレイクアウトボックスを接続する。ブレイクアウトボックスに接続された電極カテーテル*等からの信号が入力される。<br>ダイレクトペーシングを行うための経路を有する。NAV モデル*と併用する場合は RSM HDx EGM 接続ケーブル*を介してレコーディングシステムモジュール (RSM) *と接続することもできる。 |
| e  |                       | ECG IN<br>ECG ケーブル*を用いて体表面 ECG パッチと接続する。体表面 ECG 信号が入力される。NAV モデル*と併用する場合はレコーディングシステムモジュール (RSM) *を介して接続する。                                                             |
| f  | ABL コネクタ              | コネクションボックスを接続する。アブレーションカテーテル等からの信号が入力される。ダイレクトペーシングを行うための経路を有する。                                                                                                       |
| g  | 出力コネクタ                | M OUT<br>マッピング専用カテーテル*又はブレイクアウトボックスに接続された電極カテーテル*から取得した心内信号を EP 検査装置*に出力する場合に使用する。                                                                                     |
| h  |                       | A+ABL OUT<br>ブレイクアウトボックスの「A」に接続されたカテーテル及び ABL ポートに接続されたアブレーションカテーテル*から取得した心内信号を EP 検査装置*に出力する場合に使用する。                                                                  |
| i  |                       | B OUT<br>ブレイクアウトボックスの「B」に接続されたカテーテルから取得した心内信号を EP 検査装置*に出力する場合に使用する。                                                                                                   |
| j  |                       | ECG OUT<br>ECG IN に入力された体表面 ECG 信号をダイレクトコネクケーブル又は ECG 出力ボックスを介して EP 検査装置*に出力する場合に使用する。                                                                                 |
| k  | PATCH コネクタ            | ⑧-6「パッチコネクションケーブル」を用いてバックパッチ*と接続する。バックパッチへ印加されるインピーダンストラッキング用の電流並びに磁気位置情報の基準となるバックパッチ*の磁気信号が入力される。NAV モデル*と併用する場合は、マッピングシステムモジュール (MSM) *を介してバックパッチ*と接続する。             |
| l  | CONDITION ボタン         | マッピング専用カテーテル*のコンディショニングを開始する。コンディショニングが完了すると、インジケータが消灯する。                                                                                                              |
| m  | PRESSURE コネクタ         | 使用しない。                                                                                                                                                                 |
| n  | AUX コネクタ              | 使用しない。                                                                                                                                                                 |
| o  | STIM IN コネクタ          | 心臓刺激装置*と接続し、刺激信号の入力を行う。                                                                                                                                                |
| p  | ワークステーション用コネクタ        | ⑧-3「イーサネットケーブル」を用いてワークステーションと接続し通信する。                                                                                                                                  |
| q  | 等電位接地用ソケット            | 接地用電極として機能する等電位ケーブルの接続点。                                                                                                                                               |
| r  | ローカライゼーションジェネレータ用コネクタ | ⑧-5「ローカライゼーションジェネレータケーブル」を用いてローカライゼーションジェネレータと接続する。ローカライゼーションジェネレータの磁気位置信号が入力される。                                                                                      |
| s  | アナログ (入力/出力) コネクタ     | NAV モデル*と併用する場合はマッピングシステムモジュール (MSM) *を介して接続する。                                                                                                                        |
| t  | フットスイッチコネクタ           | フットスイッチを接続する。                                                                                                                                                          |
| u  | 電源スイッチ                | 電源のオン/オフを行う。                                                                                                                                                           |
| v  | 電源コネクタ                | ⑧-1「電源コード (AC-DC コンバータ付                                                                                                                                                |

き)」を接続する。

### \*\* 3.原理

本システムは、磁気センサ付カテーテル、体表面パッチ (バックパッチ及び ECG パッチ) \*及び電極カテーテル\*と接続し 3 次元マッピング画像を作成するために使用する。

本システムは、磁気及びインピーダンスによる 2 つの位置特定技術により、心腔内のカテーテルの位置を特定する。磁気による位置特定 (磁気トラッキング) 技術は、心腔内に挿入した磁気センサ付カテーテル\*の位置を特定する。磁気トラッキングによる位置情報を用いて心腔の 3 次元画像を作成する。心腔の 3 次元画像作成と同時に又は作成後、カテーテルから得られる心内電位情報をカラーで 3 次元画像に重ね合わせることで、心内電位を有する 3 次元カラーマッピング画像を作成する。また、磁気トラッキングを用いて磁気センサ付カテーテル\*の位置を特定し、3 次元マッピング画像に表示することが可能である。

インピーダンスによる位置特定 (インピーダンストラッキング) 技術は、主に磁気センサを有さないカテーテル (電極カテーテル又はアブレーションカテーテル) \*の位置を特定する。インピーダンストラッキングから特定された位置情報よりカテーテルの位置を 3 次元カラーマッピング画像上に表示させる。

また、パルスフィールドアブレーションカテーテル\*のうち磁気センサを有するモデル (FARAWAVE カテーテルのうち FARAWAVE 2.0 PFA カテーテル - NAV モデル) を用いて 3 次元画像の作成と位置情報の表示が可能である (FARAVIEW 機能)。

コンタクトフォースの表示

専用のコンタクトフォース検知機能付きカテーテル\*と本システムを併用することにより、カテーテルが取得したコンタクトフォース情報 (チップ電極と組織の接触の程度) を算出し、システム上に表示させる。

\*: 本システムに含まれない。

### 【使用目的又は効果】

本システムは、心臓電気生理学的検査において、心腔の 3 次元マッピング画像の作成及び心内電位の記録を行い、不整脈の診断又はカテーテルの誘導支援を目的とする 3 次元マッピングシステムである。

### 【使用方法等】

#### 1. マッピング検査の準備

##### 1.1 ハードウェアのセットアップ及びケーブルの接続

- ① ケーブル類に過度な力が加わらない適切な位置にシグナルステーションを設置する。
- ② ローカライゼーションジェネレータを、患者の体幹の真下に位置するように患者台下に配置し、マウント又はストラップ等を使用してローカライゼーションジェネレータを患者台に取り付ける。
- ③ ローカライゼーションジェネレータケーブルを用いてローカライゼーションジェネレータとシグナルステーションを接続する。
- ④ シグナルステーションに電源コード及びイーサネットケーブルを接続する。
- ⑤ シグナルステーション及びワークステーションの電源をオンにする。ステータスLEDを確認し、シグナルステーションが適切に作動していることを確認する。
- ⑥ ブレイクアウトボックスを接続する。
- ⑦ ECGケーブル\*をシグナルステーションに接続する。

- \*\* ⑧ コネクションボックス又はマッピングシステムモジュール (MSM) \*をシグナルステーション及び対応する高周波発生装置\*又はパルスフィールドアブレーション用コンソール\*に接続する。

- (9) ダイレクトコネクタケーブル又はブレイクアウトケーブルを用いてEP検査装置\*とシグナルステーションを接続する。
- (10) ECGダイレクトコネクタケーブル又はECG出力ボックスをシグナルステーションのECG OUTコネクタに接続する。
- (11) パッチコネクタケーブルをシグナルステーションのPATCHコネクタに接続する。
- (12) 心臓刺激装置\*の信号をルーティングする場合は、2mmピンケーブルを用いて心臓刺激装置\*とシグナルステーションを接続する。
- (13) シグナルステーション背面の等電位接地用ソケット、フットスイッチ等が適切に接続されていることを確認する。

## 1.2 ワークステーションの準備

- (1) イーサネットケーブルがワークステーションに適切に接続されていることを確認する。
- \*\* (2) ソフトウェア上にアブレーションの情報を表示する場合は、ワークステーションと高周波発生装置\*又はパルスフィールドアブレーション用コンソール\*を接続する。

## 1.3 カテーテル及びケーブルの接続

- (1) バックパッチ\*を取扱説明書に従って患者の背中に貼り付ける。
- (2) パッチコネクタケーブルをバックパッチ\*に接続する。
- (3) 標準的な方法で体表面電極\*を貼り付ける。
- (4) 診断用カテーテルを使用する場合は、ブレイクアウトボックスに接続する。
- \*\* (5) インピーダンストラッキングの基準となる電極が、シグナルステーションのA IN又はB INに接続されたブレイクアウトボックスのチャンネル1に接続されていることを確認する。
- \*\* (6) 高周波アブレーションカテーテル\*を使用する場合は、コネクタボックスに接続する。
- \*\* (7) パルスフィールドアブレーションカテーテル\*を使用する場合は、専用のケーブルを介してマッピングシステムモジュール(MSM)\*に接続する。

## 1.4 マッピング専用カテーテル\*の接続

- (1) マッピングカテーテル用ケーブル\*を用いてマッピング専用カテーテル\*とシグナルステーションを接続する。
- (2) マッピング専用カテーテル\*の添付文書に従い、カテーテルの挿入準備を行う。
- (3) マッピング専用カテーテル\*のコンディショニングを行う。

## 2. マッピングの作成

- (1) 心腔内にカテーテル\*を挿入し、心腔内を移動させることにより3次元マッピング画像を作成する。停電又はシステムが異常停止した場合、シグナルステーションとワークステーションを再起動し、システムの「resume(再開)」オプションを使用して手技を再開する。手技を続ける前に、すべてのカテーテル、信号、基準の状態が適切であることを確認すること。

## 3. 検査の終了

- (1) シグナルステーションに接続されているカテーテル、電極等を取り外す。
- (2) シグナルステーションの電源をオフにする。
- (3) モニタのメイン画面の電源オフボタンを用いてワークステーションの電源をオフにする。
- (4) シグナルステーションと附属品のクリーニングを行う。

\*: 本システムに含まれない。

## \*\* <組み合わせる使用する医療機器>

| 種類                 | 販売名                                | 承認又は届出番号         |
|--------------------|------------------------------------|------------------|
| マッピング専用カテーテル       | IntellaMap Orion<br>マッピングカテーテル     | 22800BZX00130000 |
| 磁気センサ付アブレーションカテーテル | IntellaNav MiFi OI<br>アブレーションカテーテル | 23100BZX00089000 |
| マッピング専用            | Rhythmiaアンビリカル                     | 13B1X00043000064 |

|                          |                                         |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| カテーテル用ケーブル               | ケーブル                                    |                  |
| 磁気センサ付アブレーションカテーテル用ケーブル  | IntellaNav カテーテル接続キット                   | 13B1X00043000066 |
| 磁気センサ付アブレーションカテーテル       | IntellaNav StablePoint<br>アブレーションカテーテル* | 30200BZX00348000 |
| 磁気センサ付アブレーションカテーテル用ケーブル  | IntellaNav StablePoint<br>カテーテル接続ケーブル   | 13B1X00043000089 |
| 体表面電極パッチ(バックパッチ及びECGパッチ) | Rhythmiaパッチキット                          | 13B1X00043000063 |
| ECGケーブル                  | Rhythmia HDx ECG<br>ケーブル                | 13B1X00043000072 |
| 高周波発生装置(Maestro)         | マエストロ4000<br>カーディアック<br>アブレーションシステム     | 22800BZX00047000 |
| 高周波発生装置(Stockert)        | バイオセンス<br>STOCKERT 70                   | 21900BZX00788000 |
| 高周波発生装置(ABI)             | IBIカーディアック<br>アブレーションシステム<br>II         | 21900BZY00066000 |
| 高周波発生装置(Ampere)          | Ampere 高周波発生装置                          | 22600BZX00430000 |
| 高周波発生装置(SmartAblate)     | SmartAblate ジェネレータ                      | 22600BZX00027000 |
| 高周波発生装置(Intellagen)      | INTELLAGEN<br>カーディアック<br>アブレーションシステム    | 30600BZX00257000 |
| 磁気センサ付アブレーションカテーテル用ケーブル  | FARASTAR 専用ケーブル                         | 13B1X00043000095 |
| 磁気センサ付アブレーションカテーテル       | FARAWAVE<br>カテーテル**                     | 30600BZX00197000 |
| パルスフィールドアブレーション用コンソール    | FARASTAR<br>コンソール                       | 30600BZX00196000 |

\*: コンタクトフォース検知機能付きカテーテル

\*\* \*: FARAVIEW機能付きカテーテル (FARAWAVE 2.0 PFA カテーテルのうちNAVモデルのみ)

## <使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 感電リスクを最小限にするため、シグナルステーションは保護接地(アース)に接続されている主電源以外には接続しないこと。本システムへの電力供給は、保護接地(アース)を備え、正常に機能し、適切な検査が行われている主電源のみを使用すること。欠陥があり接地されていない主電源を使用すると、感電及びシステムの誤動作のリスクが高まる可能性がある。
- (2) ケーブルコネクタの接続又は接続解除を行う際に過剰な力を加えないこと。コネクタが破損し、システム誤動作の原因となるおそれがある。
- (3) ケーブルをねじったり、折り曲げたりしないこと。ケーブルが破損し、システム誤動作の原因となるおそれがある。
- (4) ローカライゼーションジェネレータを手動で無効にすると、インピーダンスのトラッキングを含むすべてのカテーテルの可視化及び位置特定機能が無効になる。
- \* (5) 本システムと併用するケーブルは、ローカライゼーションジェネレータケーブルから30mm以内に配置しないこと。30mm以内で特に平行して配置した場合、正確なトラッキングが行えなくなったり、信号のノイズが発生したりするおそれがある。
- (6) ローカライゼーションジェネレータのケーブルを巻かないこと。ローカライゼーションジェネレータの磁場に干渉し、正確

なトラッキングが行えなくなるおそれがある。

- (7) 本システム使用中にCIEDのイントロダクション又はプログラミングが必要な場合は、画面上のツールバーにあるボタンをタッチしてローカライゼーションジェネレータをオフにし、マップのアノテーション及び編集を行うこと。
- (8) カテーテルローカライゼーションエラーが発生した場合には、エックス線透視又は他の可視化手法を使用してカテーテルの位置を確認すること。カテーテルのローカライゼーションが正しくない場合、臨床的結論を誤ったり、患者が障害を受けたりする可能性がある。
- (9) 正しい臨床判断が確実に行われるようにするため、エックス線透視、超音波、ペースマッピング又はその他の可視化手法を用いてマッピング結果とカテーテル位置を確認すること。アナトミカルマップと予測される患者の解剖学的構造との比較を常に行うこと。カテーテルのローカライゼーションが正しくない場合、臨床的結論を誤ったり、患者が障害を受けたりする可能性がある。
- \*\* (10) マッピング専用カテーテルが体内又は体外で患者に接触しているとき、マッピング専用カテーテルのコンディショニングを行わないこと。患者と接触しながらコンディショニングを行うと、新たな不整脈の発生や既存の不整脈の悪化など、患者の傷害につながる可能性がある。
- (11) カテーテルコンフィギュレーションの誤りを低減するため、システムにカテーテルを接続する際は、常に信号表示及びEP検査装置を監視して信号を検証し、表示されるチャンネルに対してカテーテル電極のコンフィギュレーションが適正であることを確認すること。
- (12) 検査中、バックパッチとECG電極の接続がソフトウェアにより監視される。画面上のパッチの品質インジケータのカラーコードが、緑色から黄色又はオレンジに変化した場合、パッチの接続等を確認すること(黄色又はオレンジの状態におけるインピーダンストラッキングは評価されていない)。赤色になった場合(接続が不良であることを示す)、問題のあるパッチの調整又は再配置を行うこと。
- (13) サイバーセキュリティに関する注意事項  
本品は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに準拠した環境で使用すること。

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本システムと接続するすべての機器は、IEC 60601-1に適合しているものを使用すること。また、他の機器との接続には組み合わせたシステム構成がIEC 60601-1-1に適合すること。関連規格に適合していない機器を使用した場合、本システムの安全性の低下、装置の破損やシステムの誤作動の原因となる又は患者や医療従事者に危害が及ぶ可能性がある。
- (2) EMC干渉の情報については、取扱説明書を参照すること。
- \*\* (3) 本システムは、生命維持用ではないため、本システムを経由して生命維持ペーシングを行わないこと。緊急ペーシングが必要な場合又は心臓電気刺激装置のルーティングに失敗した場合は、目的のペーシングチャンネルを心臓電気刺激装置に直接接続すること。本システムを使用して生命維持ペーシングを行うと、徐脈が長引く可能性がある。
- (4) 本システムは、刺激信号を目的のチャンネルにルーティングするようにのみ設計されている。刺激を開始又は中止する場合は、心臓電気刺激装置でコントロールすること。
- (5) 併用医療機器として示した高周波発生装置のみが本システムと併用可能である。それ以外の高周波発生装置と併用しないこと。
- \*\* (6) 不整脈の診断及び治療の一環として、本システムとアブレーション機器を併用した場合、アブレーション等により心穿孔及び不整脈(新規発現や増悪)等の有害事象が生じ、追加治療が必要となる可能性がある。

- (7) アブレーションカテーテルを使用する際は、複数のカテーテルを同時にコネクションボックスに接続しないこと。患者に障害が生じる可能性がある。
- (8) 感電又は装置破損のリスクを軽減するため、電源に接続されているとき、電源がオンのとき、患者に接続されているときは、本システムのクリーニングを行わないこと。患者や医療従事者の障害や死亡を引き起こす可能性がある。
- (9) 感電リスクを軽減するため、ECGケーブル及び電極が他の導電部(アースを含む)に接触していないことを確認すること。
- (10) 除細動時の感電リスクを軽減するため、ECG出力ボックス上に露出されたコネクタ部に付属の保護カバーを装着すること。保護カバーが破損している場合は、ECG出力ボックスを使用しないこと。
- (11) 電氣的なインピーダンスフィールドを発生させる別のシステムを使用しないこと。本システムの正常動作に干渉し、カテーテルの位置特定及び信号の質が低下する場合がある。
- (12) ローカライゼーションジェネレータを心臓植込み型機器から半径200mmの範囲で使用しないこと。心臓ペーシング、頻脈治療の一時的な中断及び患者の不快感等につながる可能性がある。
- (13) 感電リスクを最小限にするため、本システムの使用前に、等電位接地用ソケットを共通アースに接続すること。この接続はシステムを使用する際、常に接続しておく必要がある。
- (14) シグナルステーションには専用の電源装置のみを使用すること。
- (15) シグナルステーションの電源を入れた状態で電源装置の接続又は接続解除を行わないこと。シグナルステーションの破損につながるおそれがある。
- (16) 水などの液体への曝露の可能性を最小限とするため、通気孔に液体が入らないようにすること。
- (17) 感電又はシグナルステーションの損傷のリスクを最小限にするため、水やその他の液体が入った容器を、シグナルステーション又はその他のシステム構成部品の上又は近くに置かないこと。
- (18) ケーブルのコネクタを水や液体に浸さないこと。水や液体に浸すことによりコネクタが損傷し、システムの誤作動の原因となるおそれがある。
- (19) シグナルステーションの使用中は、シグナルステーションの通気孔を塞がないこと。シグナルステーションが過熱し、システム動作に支障をきたすおそれがある。
- \*\* (20) シグナルステーション及び構成品を安定した面で使用し、落下を防ぐこと。また、シグナルステーションには他の機器や装置を積み重ねたり隣接させたりして使用しないこと。
- (21) 本システムには、専用のECGケーブルのみを使用すること。他のECGケーブルの使用は、システムハードウェアの重大な破損の原因となる場合がある。
- (22) 信号干渉を最小限に抑えるため、ECGケーブルを束ねて配置しないこと。
- (23) 接地されていない電源からは、いずれのシステム構成部品にも電力供給を行わないこと。接地されていない電気コンセントには延長コード又はアダプタを接続しないこと。接地されていないコンセント、延長コード、又はアダプタの使用は、装置の破損、システムの故障や誤動作の原因となるおそれがある。
- (24) 体表面電極のECGケーブルへの取付けは、電極及びECGケーブルが互いに接触しておらず、アースにも接触していないことを確認し、慎重に行うこと。
- (25) 体表面電極からの信号品質の低下を防ぐため、電極装着前に皮膚の前処置を適切に行うこと。電極間のショートを招くおそれがあるため、ゲルを過剰に使用しないこと。
- (26) ケーブル類の接続又は接続解除を行う際は、ケーブルコネクタを水や湿気から保護すること。コネクタが濡れるとシステム動作に影響が及ぶおそれがある。
- (27) 他の磁場や大きな金属製の物体があるところで磁気ローカラ

イゼーションシステムを使用しないこと。正確なトラッキングが行えなくなるおそれがある。

- (28) 本システムの破損や誤動作を避けるため、本システムの滅菌を行わないこと。
- (29) ローカライゼーションジェネレータは、植込まれている心臓植込み型電子機器 (CIED) に干渉する可能性がある。CIED 留置患者においてマッピングを行うときは、手技の前後で機器のイントロゲーションを行い、設定されたパラメータに変更があった場合には、患者を手術室から移動させる前に修正できるようにすることを検討すること。
- (30) ローカライゼーションジェネレータは、磁場に基づく技術を用いた他のシステムにも干渉する可能性がある。
- (31) 同一のカテーテルで同じ組み合わせの電極を使用して、同時に刺激とアブレーションを行わないこと。
- (32) システム基準電極を刺激に使用しないこと。正確なカテーテルの位置特定ができなくなるおそれがある。
- (33) シグナルステーションを使用する前にすべての外部接続とケーブルを点検し、緩んでいる接続があればしっかり固定すること。接続が緩んでいると、マッピング結果の精度に影響が生じる場合がある。
- (34) ディスプレイに表示されるメッセージを必ず確認すること。[コンタクトフォースの測定が正しく行われない、又は表示されるコンタクトフォースを誤って解釈すると、意図した以上の力をカテーテルに加える可能性があり、心穿孔、心筋挫傷又は心筋損傷等が発生するおそれがある。]

\*\* (35) パルスフィールドアブレーションの前に、シグナルステーションへの患者からの全ての入力を切断する。利用可能な場合は、パルスフィールドアブレーションの前に患者からの入力を自動的に切断するアクセサリを使用できる。パルスフィールドアブレーション実施中に患者からの入力を接続したままにしておくと、シグナルステーションが損傷する可能性がある。

\*\* (36) マッピングシステムソフトウェアを経由した刺激信号のルーティングに失敗した場合には、直接刺激が必要になることがある。刺激装置のジャンパーケーブルを、入力ポート M、A、B、又は ABL の上に配置されている直接刺激ポートの任意の 1 つに、心臓刺激装置のジャンパーケーブルを接続すること。入力ポート M、A 及び B の上の直接刺激ポートを介し、外部の心臓刺激装置に接続されたブレイクアウトボックスのチャンネル 61 と 62 に接続する。ABL ポートの上にある直接刺激ポートはアブレーションカテーテルのチャンネル 1 と 2 に接続する。

\*\* (37) 直接刺激は FARAWAVE カテーテルと互換性がない。FARAWAVE カテーテルはブレイクアウトボックスのチャンネル 61 と 62 を使用しないこと。直接刺激が必要な場合は、別のカテーテルを使用する必要がある。

\*\* (38) 手技中は、本システムを ECG モニタリングデバイスとして使用しないこと。生命に関わる不整脈治療の遅れを防ぐため、本システムは常に EP レコーディングシステム/その他の ECG モニタリングデバイスと併用する必要がある。

\*\* (39) 正しい臨床判断を確実に行うために、フィールドタグは不整脈の診断と治療のための従来の検証技術 (心電図の評価、ペーシング操作及び透視検査又は心エコー検査等) と併用すること。穿孔、心ブロック及び隣接臓器の損傷等の患者の傷害を防ぐため、臨床判断を行う際にはフィールドタグの情報のみに頼らないこと。

\*\* (40) シース検出は、対応しているシースとカテーテルを組み合わせた時に有効となる。対応していないシースに対するシース検出の性能は検証されていない。併用する機器の取扱説明書等を参照すること。

## 2. 相互作用 (他の医薬品・医療機器との併用に関すること)

本品を用いたマッピング及びアブレーション手技に関するカテーテルの有害事象は、併用するカテーテルの添付文書の不具合・有害事象の欄を参照すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1. 保管の条件

温度:  $-29^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

相対湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)

## 【保守・点検に係る事項】

### 1. 使用者による保守・点検事項

- (1) ECG ケーブル等の繰り返し使用する機器は、取扱説明書を参照して、再使用前に必ずクリーニングと消毒を行うこと。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

電話番号: 03-6853-1000

製造業者:

米国 ボストン サイエンティフィック コーポレーション

[Boston Scientific Corporation]

サイバーセキュリティに関する情報請求先:

<https://www.bostonscientific.com/jp-JP/about-us/security.html>