** 2023 年 9 月（第 6 版）
* 2020 年 12 月（第 5 版）
認証番号 229AKBZI00058000

歯科材料 04　歯科用根管充填材料

管理医療機器　歯科用根管充填ガッタパーチャポイント（31872000）

HyFlex ガッタパーチャポイント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 天然ゴムに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯科で使用するＸ線不透過性の根管充填ポイントである。本品は、カラーコードの付け方、形状、組合せにより４つのシリーズがあり、それぞれのシリーズ毎に各サイズがある。

(1) ROEKO Guttapercha Points Top color
(2) ROEKO Guttapercha Points
(3) HyFlex CM Guttapercha Points
(4) HyFlex EDM Guttapercha Points

2. 図面及び寸法

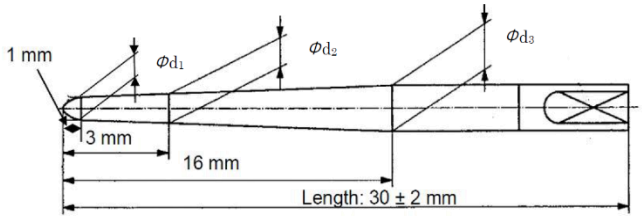

(1), (2)は、標準ポイントとして、テーパー、長さは基本的に同一であるが、カラーコードによる表示が異なる。

(1)は手元側及び包装、(2)は包装に色表示される。

(3), (4)は、大テーパーポイント、手元側及び包装に色表示される。

(1) ROEKO Guttapercha Points Top color

単位：mm

サイズ	カラーコード	Φd_1	Φd_2	Φd_3	テーパー
15	白	0.15	0.21	0.47	0.02
20	黄	0.20	0.26	0.52	0.02
25	赤	0.25	0.31	0.57	0.02
30	青	0.30	0.36	0.62	0.02
35	緑	0.35	0.41	0.67	0.02
40	黒	0.40	0.46	0.72	0.02
45	白	0.45	0.51	0.77	0.02
50	黄	0.50	0.56	0.82	0.02
55	赤	0.55	0.61	0.87	0.02
60	青	0.60	0.66	0.92	0.02
70	緑	0.70	0.76	1.02	0.02
80	黒	0.80	0.86	1.12	0.02
90	白	0.90	0.96	1.22	0.02
100	黄	1.00	1.06	1.32	0.02
110	赤	1.10	1.16	1.42	0.02
120	青	1.20	1.26	1.52	0.02
130	緑	1.30	1.36	1.62	0.02
140	黒	1.40	1.46	1.72	0.02

(2) ROEKO Guttapercha Points

単位：mm

サイズ	カラーコード	Φd_1	Φd_2	Φd_3	テーパー
15	白	0.15	0.21	0.47	0.02
20	黄	0.20	0.26	0.52	0.02
25	赤	0.25	0.31	0.57	0.02
30	青	0.30	0.36	0.62	0.02
35	緑	0.35	0.41	0.67	0.02
40	黒	0.40	0.46	0.72	0.02
45	白	0.45	0.51	0.77	0.02
50	黄	0.50	0.56	0.82	0.02
55	赤	0.55	0.61	0.87	0.02
60	青	0.60	0.66	0.92	0.02
70	緑	0.70	0.76	1.02	0.02
80	黒	0.80	0.86	1.12	0.02
90	白	0.90	0.96	1.22	0.02
100	黄	1.00	1.06	1.32	0.02
110	赤	1.10	1.16	1.42	0.02
120	青	1.20	1.26	1.52	0.02
130	緑	1.30	1.36	1.62	0.02
140	黒	1.40	1.46	1.72	0.02

(3) HyFlex CM Guttapercha Points

単位：mm

表示番号	サイズ	カラーコード	Φd_1	Φd_2	Φd_3	テーパー
020 04	20	黄	0.18	0.30	0.82	0.04
025 04	25	赤	0.23	0.35	0.87	0.04
030 04	30	青	0.27	0.39	0.91	0.04
035 04	35	緑	0.32	0.44	0.96	0.04
040 04	40	黒	0.37	0.49	1.01	0.04
045 04	45	白	0.42	0.54	1.06	0.04
050 04	50	黄	0.50	0.62	1.14	0.04
060 04	60	青	0.60	0.72	1.24	0.04
020 06	20	黄	0.18	0.36	1.14	0.06
025 06	25	赤	0.23	0.41	1.19	0.06
030 06	30	青	0.27	0.45	1.23	0.06
035 06	35	緑	0.32	0.50	1.28	0.06
040 06	40	黒	0.37	0.55	1.33	0.06
045 06	45	白	0.42	0.60	1.38	0.06

取扱説明書を必ずご参照ください。

(4) HyFlex EDM Guttapercha Points

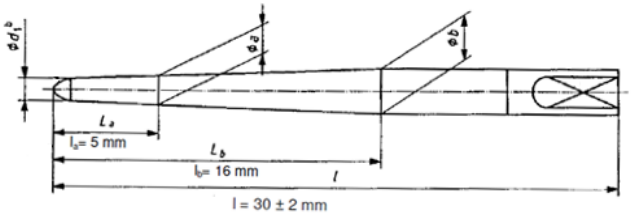

単位：mm

表示番号	サイズ	カラーコード	Φd1	Φa	Φb	テーパー
*025 08	25	赤	0.25	0.33	0.49	0.08
020 05	20	黄	0.20	0.35	1.00	0.05
040 04	40	黒	0.37	0.49	1.01	0.04
050 03	50	黄	0.47	0.59	0.98	0.03
060 02	60	青	0.60	0.66	0.92	0.02
**030 04	30	青	0.27	0.39	0.91	0.04

3. 原材料
- 天然ゴム（ガッタパーチャ）
- 酸化亜鉛
- 硫酸バリウム
- ベンガラ
- その他

4. 原理

適度な弾性と柔らかさを備えた根管充填用ポイントである。形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択し、側方加圧時の圧接により封鎖が行える。

【使用目的又は効果】

本品は、根管の充填に用いる。

【使用方法等】

(1) 充填予定の根管を清潔にし、乾燥します。
(2) 形成された根管の根尖部と同じサイズの本品を選択してください。
(3) 本品に根管充填用シーラをつけ、本品を形成された根管の先端まで差し込みます。
(4) さらにアクセサリーポイント等を本品の回りに差し込みスプレッダーを用いて、本品に側方圧を加え、根管空隙が充塞されるように本品を順次追加して挿入する。
(5) 根管口から出ている余分な本品上部を切除する。

【使用上の注意】

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞

(1) 天然ゴムに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がないことを確認すること。
(2) 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

＜重要な基本的注意＞

本品を根管内に装着する時、根尖孔から突出させないよう、十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者： AJMD 株式会社
03-5614-0733
製　造　業　者： Colte(`)ne/Whaledent GmbH + Co.KG
（ドイツ）
販　売　業　者： 東京歯科産業株式会社
03-3831-0176

取扱説明書を必ずご参照ください。