CT

2017年 4月作成（第1版）

医療機器届出番号：27B1X00045000125

機械器具 51　医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　吸引チューブ　16779000

スリムドレーン　コネクティングチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

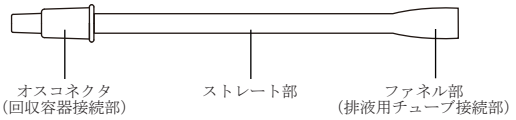

【使用目的又は効果】
排液用チューブと回収容器を接続し、排液ラインを延長するために用いる。

【使用方法等】
1. 使用方法
1)本品のファネル部に排液用チューブのコネクタを接続します。
2)本品のオスコネクタを回収容器に接続します。
3)使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

2. 組み合わせて使用する医療機器
1)排液用チューブ（いずれもレザーバー用タイプに限る）
(1)販売名　：ＵＫドレーンカテーテル
　承認番号：22100BZX00947000
(2)販売名　：スリムドレーンコネクター
　届出番号：27B1X00045000116

2)回収容器（平型、卵型）
(1)販売名　：スリムドレーンバック
　届出番号：27B1X00045000115

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
1. 本品に排液用チューブと回収容器を接続後、各接続部がしっかりと嵌合していることを確認し、必要に応じて、結束バンドを併用するなどの補強策をとってください。
2. 回収容器のスリムドレーンバック平型に本品を2本接続する際は、予め片方のオスコネクタの先を段差付近から切り落としてから挿入してください。［スリムドレーンバック平型の吸引口内でコネクタ同士の先が当たって十分挿入できないおそれがあります。］
3. 本品を直列に２本以上接続して使用しないでください。［排液漏れ、エアリーク、排液不良のおそれがあります。］
4. ミルキングは必ずチューブのストレート部で行い、指やローラー鉗子等で過度にしごかないでください。また、ローラー鉗子を使用する際は、ローラー部に破損がなく、正しく回転することを確認してください。［破損のおそれがあります。］
5. チューブを鉗子等で閉塞する場合、オスコネクタを一緒に閉塞しないでください。［破損のおそれがあります。］

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1)消毒、清拭等の目的で、アルコール、アセトン、ベンジン等の有機溶媒を使用しないこと。［強度が低下し、破損のおそれがある。］
2)本品の接続時及び使用中は、接続部がしっかりと嵌合していること、破損、緩み、排液漏れ、詰まり等の異常がないことを定期的に確認すること。
3)体動でねじれると流路閉塞のおそれがあるので注意すること。

2. 不具合・有害事象
1)その他の不具合
(1)排液漏れ、吸引不良
(2)破損
(3)エアリーク

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間
包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後5年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ株式会社

NIPRO　ニプロ株式会社