**2018 年 8 月（第 3 版）
*2017 年 8 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
届出番号　27B1X00109000282

機械器具 65　歯科用充填器
一般医療機器　　歯科用マトリックスバンド　　16195000

ヴァリストリップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】*

＜適用対象（患者）＞

- 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者

＜使用方法＞

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

［形状・種類］

本品には、歯牙の豊隆に沿うように、あらかじめ 3 次元カーブが付与されている。寸法は以下のとおりである。

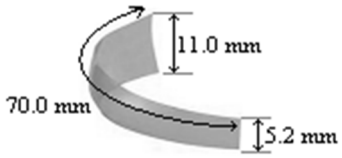

［体に接触する部分の主な組成］

ポリエステル

［原理］

歯の隣接面に挿入し、所定の位置につけることにより、窩洞部の立体的な隔壁を形成する。

【使用目的又は効果】

口腔内で充填材又は修復材に一般的輪郭を与え、修復材等を閉じ込めるために用いる。修復する歯の形状のほか、隣接歯の位置に応じて適切な形になるよう輪郭を付与する。主にⅢ級窩洞及びⅣ級窩洞部に使用する。

【使用方法等】*

［使用方法］

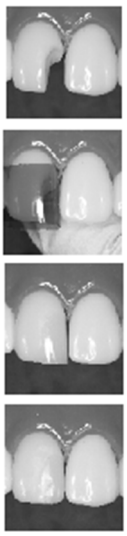

(1) 通法に従い、ラバーダムを装着し、防湿する。
(2) 通法に従い、窩洞を形成する。
(3) 本品を窩洞の反対側の隣接面に通し、まわし込むようにして窩洞側の隣接面に通す。
(4) 歯冠長と同じ高さになる位置まで本品をスライドさせる。
(5) 窩洞側の隣接面に通した本品を歯肉溝内に入れ、唇側から引いて密着させ、ウェッジで固定する。本品がずれる可能性があるため、ウェッジで確実に固定すること。固定が緩い場合は、低粘度のフロアブルレジンを窩底部へ充填すると窩底部からフロアブルレジンがはみ出る可能性がある。その際にはウェッジのサイズを大きくして調整すること。
(6) 再度近遠心部の本品を歯頸側部で引いて密着させ、通法に従い、充填する。
(7) 充填後、ピンセット等を用いて本品を撤去した後、研磨する。

［使用方法等に関連する使用上の注意］

(1) 本品は、必ず口腔内にラバーダムを装着してから使用すること。

【使用上の注意】

［重要な基本的注意］

(1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。

【保守・点検に係る事項】/**

［滅菌］

(1) 安全な使用のために、初回使用前に高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）: 115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
(2) 137℃以上に加熱しないこと。
(3) 滅菌中は、材質の異なる金属製器具との接触を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者： 株式会社モリタ
電 話 番 号 ： 06-6380-2525
外国製造業者： ギャリソン・デンタル・ソルーションズ
Garrison Dental Solutions
国　　名　　： アメリカ合衆国

［お問い合わせ先］

問 合 せ 窓 口 ： 株式会社モリタ　お客様相談センター
電 話 番 号 ： 0800-222-8020（無料）
F a x 番 号 ： 0800-222-6480（無料）
E - m a i l ： e-customer@morita.com