機械器具　医療用鏡
一般医療機器　内視鏡用部品アダプタ　JMDN コード：37090010

Ｌ４３Ｋプローブ専用アタッチメント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

・形状

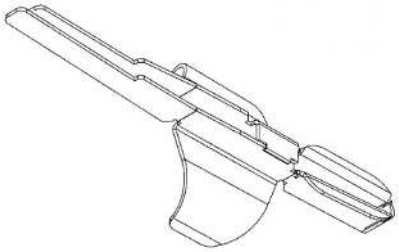

【使用目的，効能又は効果】

本製品は，L43K プローブに装着し，L43K プローブの逆方向把持性を向上させることを使用目的とする。

【操作方法又は使用方法等】

本製品は富士フイルムヘルスケア株式会社製，販売名：L43K プローブ，医療機器認証番号：226ABBZX00095000 に装着して使用する。

・装着方法

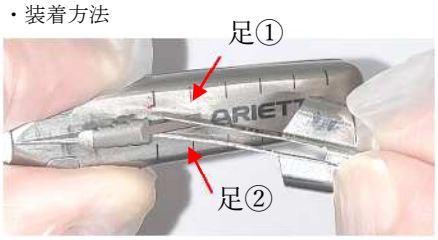

プローブの既存突起に引っ掛けて足①と足②を広げる

平行にして差し込む

足①が既存突起の傾斜と一致したところでぱちんとはまる

・使用方法

フェネストレイト鉗子で突起部を挟んで使用する

・取外方法

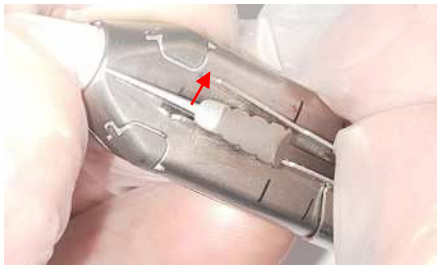

足①を指などで広げる

そのまま引き抜く

より詳しい装着・取外方法は，
以下ホームページを参照してください。
https://www.sanmatsu.com/mm-001/

【使用上の注意】

・本品は富士フイルムヘルスケア株式会社製 L43K プローブ（認証番号 226ABBZX00095000）に装着して使用するように設計されているので，他の製品に装着しないこと。

・使用する光源・遠隔カメラの組み合わせによっては，本品を使用することによってハレーションを起こすことがある。オペレーションの妨げになる場合には，すみやかに使用を中止すること。

・本品を鉗子等で把持しているときに，別の鉗子等でプローブ本体またはプローブケーブルに触れないこと。また，プローブケーブルを強く牽引しないこと。意図せず強い負荷が掛かり，本品が破損またはプ

ローブから脱落する恐れがある。

・本品は未滅菌で供給されるため，使用前に必ず洗浄及び高圧蒸気滅菌を行うこと。

・本品の変性や劣化が生じるおそれがあるため，135℃を超える温度を加えないこと。

・使用後は汚染及び感染に注意し，本品を適切に廃棄すること。

【貯蔵・保管方法】

・高温または湿度の高い場所や，直射日光，紫外線の当たる場所は避け，清浄な状態で保管すること。

・水ぬれに注意して保管すること。

・本品の有効期限は出荷後 5 年間とする。

【包装】

3 個／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社三松

住所：福岡県筑紫野市岡田３丁目１０番９号

電話番号：092-926-4711

製造業者：株式会社三松