＊ 2023年7月（第2版）
2020年7月（第1版　新記載要領に基づく作成）

医療機器認証番号　226AFBZX00005000

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器　呼吸回路セット　JMDNコード　70566000

再使用禁止

EHW 呼吸回路

【警告】
◆ 本品を使用する際は、本品及び接続した呼吸回路等に漏れや閉塞がないことを確かめてください。また、呼気ポートからガスが吹き出すことを確認してください［換気障害が生じるおそれがあります］。

【禁忌・禁止】
◆ 再使用禁止
◆ 消毒・滅菌処理をしないでください［本品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります］。

【形状・構造及び原理等】
1．構成
本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。

2．形状、寸法
1）　呼気ポート（51005057）

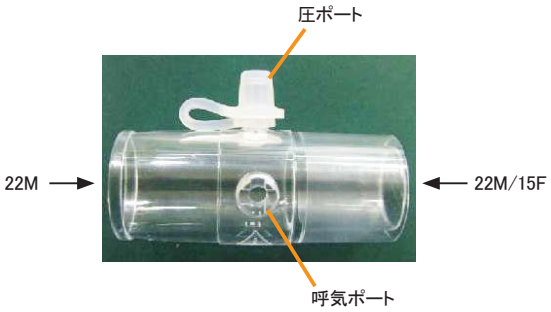

3．作動原理
呼気を排出させるため、チューブ、回路等を接続するコネクタ。

【使用目的又は効果】
人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】
1. 本品を呼吸回路とマスク（又はマウスピース、気道内挿管/気道切開チューブ接続アダプタ）の間に接続してください。
2. 必要に応じて圧ポートにラインチューブを接続してください。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
◆ 呼気ポートを閉塞しないでください。
◆ 圧ポートに接続するラインチューブは、適切なサイズを使用してください。
◆ ラインチューブに水滴が流入しないよう、圧ポートが常に上になるように設置してください。（主要文献参照）
◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認すること。
◆ ラインチューブに水滴が見られた場合には速やかに取り除いてください［水滴でチューブ内が閉塞し、アラームが誤作動したり、適正な換気が維持されない等のおそれがあります］。（主要文献参照）

＜その他の注意＞
◆ 直射日光、高温、多湿な場所や、水濡れを避けて室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管環境＞
温度：－10～50℃
湿度：15～95%（非結露）
＜使用期間＞
2週間を目安に使用してください（自己認証による）。

【主要文献及び文献請求先】
（主要文献）
薬食安発0825第2号/薬食機発0825第6号「人工呼吸器呼吸回路における気道内圧モニター用チューブに係る添付文書の自主点検等について」（平成21年8月25日、厚生労働省）
（文献請求先）
＊ アイ・エム・アイ株式会社　マーケティング部
＊ TEL：03-5829-5803

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社
製造業者名（国名）：Vincent Medical（Dong Guan）Manufacturing Co., Ltd.
（ビンセントメディカル（ドングァン）マニファクチャリング社）（中国）

C0277-E9
Rev. 2