

機械器具(08) 保育器
高度管理医療機器 定置型保育器 36025000

特定保守管理医療機器 ラビー インキュー i

【警告】

- 1) 本品は安定した場所に設置使用すること。
[破損および落下の原因となるため。]
- 2) 本品使用中は処置窓や手入窓を必ず閉めておくこと。
[児の落下の原因となるため。]
- 3) 酸素供給を行う場合は、酸素濃度を規定するために、器内酸素濃度の測定と、動脈血中の酸素分圧又は酸素飽和度の測定(SpO_2)を繰り返し行うこと。
[児のバイタルサインを確認するため。]
- 4) 加湿槽の取り出しは、加湿槽や水の温度が充分下がってから行うこと。
[火傷のおそれがあるため。]
- 5) 直射日光またはその他の放射熱源によって器内温が危険レベルまで上昇することがあるため、充分に注意すること。
[温度コントロールが出来なくなるため。]
- 6) エーテルやアルコール等の可燃性薬剤の残留は火災の原因になりうる。
- 7) 2 芯/3 芯変換アダプタは絶対に使用しないこと。
[変換アダプタを使用した場合、電源コードと変換アダプタがはずれるため。]
- 8) 処置窓および手入窓を閉める際は、児の手足を挟まぬように注意すること。

＜併用医療機器＞

- 1) 外部機器を接続する場合、当該外部機器の電源は必ずアイソレーショントランスを介してとること。
[当該外部機器が単一故障状態を起こした場合、患者漏れ電流を防止するため。]
- 2) 本品に児を収容して光線治療を行う場合にも、処置窓や手入窓は必ず閉めて使用すること。
[児の落下の原因となるため。]
- 3) 複数の光線治療器を同時に使用したり、室温の高いときには器内温が上昇する場合がある。こうした場合は医師の判断で、光線治療を行うこと。
[温度コントロールが出来なくなるため。]

【禁忌・禁止】


- 1) 処置窓や手入窓を開けたまま本品から離れないこと。
[児の落下の原因となるため。]
- 2) カイロ(使い捨てカイロを含む)などの発火源や、スパークが発生するおそれのある機器を、本品の中や周囲に置かないこと。
[酸素を使用しているときは、爆発や火災の危険がある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

(1) 本体

各部の名称

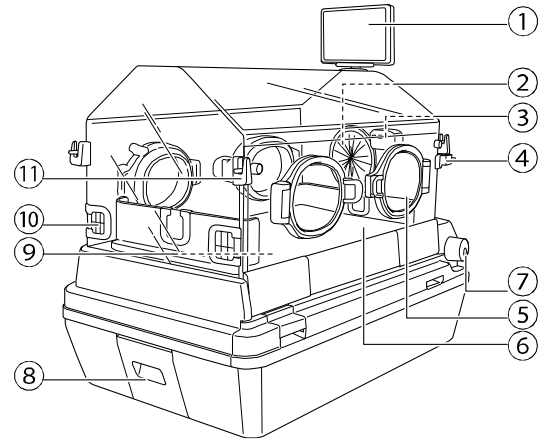

番号	名 称	番号	名 称
①	ディスプレイ	⑦	臥床台傾斜ハンドル
②	絞り式手入窓	⑧	加湿槽カバー
③	センサーモジュール	⑨	マットレス
④	処置窓ロックレバー	⑩	チューブ導入口
⑤	手入窓	⑪	処置窓開閉ノブ
⑥	処置窓		

(2) 付属品

- ・体温プローブ
- ・ニューモクリーン(静電フィルター)
- ・手入窓用カバー
- ・防塵カバー

2. 電氣的定格

[AC 電源]

定格電圧:100V
周 波 数:50/60Hz
消費電力:600VA

3. 機器の分類

- (1) 電撃に対する保護の形式による分類 クラス I 機器
- (2) 電撃に対する保護の程度による装着部の分類 BF 形装着部

4. 動作原理

(1) 器内循環

酸素供給バルブ内で混合された酸素と外気は、フィルターを通り、ろ過され本体内に入る。
本体内に入った気体は、循環用ファンモーターに取り付けられた循環用ファンによって、ヒーターに送られ、設定に基づき適温に温められ、吹出口より器内に入る。
加湿は、加湿槽の一部の水を沸騰させ発生した蒸気により行う。
吹出口より器内に送られた気体は、処置窓と内壁パネルの間を通り内壁パネルを温めると共に、臥床台上を循環し均等な温度状態を作る。器内に送られた気体は吸込口で一つになり、新たに取り込まれた酸素、外気と合流し循環する。
この循環システムによって器内を設定した温度に保ち、さらに内壁パネルを温めることによって児の輻射損失を少なくする。

さらに、処置窓を開いて児の処置等を行う場合に、児の周囲環境を維持するために吹出口から温められた気体が噴出し、外気の影響を少なくする。

(2) 温度管理

サーボコントロール

体温を設定すると、体温プローブが児の体温を測定し、その結果体温が設定体温になるように、臥床台下にあるヒーターの出力を自動制御する。

マニュアルコントロール

器内温を設定すると、器内の温度センサーが器内温を測定し、器内温が設定器内温になるように、臥床台下にあるヒーターの出力を自動制御する。

【使用目的又は効果】

本品は、新生児を収容し、新生児に対して至適環境を保持するための保育器である。

【使用方法等】

準備

- 1) 電源スイッチを ON にする。
- 2) コントロールパネルを操作し、器内温、必要に応じて湿度を設定する。
- 3) 器内温が設定温度で安定したら、児を収容し使用を開始する。

サーボコントロールの操作

- 1) 体温プローブのコネクタを、体温プローブ接続口に差し込む。
- 2) 体温プローブを児に非刺激性テープ等で貼付する。
- 3) 体温プローブを装着して、4～5 分後に、児の体温が安定していることを確認する。
- 4) コントロールパネルの温度表示部を操作し、サーボコントロールに切り替える。

マニュアルコントロールの操作

- 1) コントロールパネルの温度表示部を操作し、器内温を設定・変更する。

オーバーライドによる器内温度設定

- 1) コントロールパネルの温度表示部を操作し、オーバーライドに設定する。コントロールパネル上にオーバーライド状態であることが表示される。
- 2) この状態で通常の温度設定を行うと、マニュアルコントロールの場合、37.0℃を越えて 39.0℃まで、サーボコントロールの場合、37.5℃を越えて 38.0℃まで設定することができる。
- 3) マニュアルコントロールの場合、温度設定を 37.0℃以下に設定するとオーバーライド表示は解除される。サーボコントロールの場合、温度設定を 37.5℃以下に設定するとオーバーライド表示は解除される。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品は低出生体重児用、新生児用である。
- 2) 本品に新しく児を収容する場合は、収容前に清拭・消毒を行うこと。
- 3) 長時間収容する場合、定期的に清拭・消毒を行うこと。
- 4) 体温プローブは児の腹壁上に確実に装着すること。
- 5) 体温プローブがブランケット、おむつ、児の腕等で覆われて温められたり、尿や薬液等で濡れて冷却されないようにすること。
- 6) 自己熱産生の高い児や発熱している児の場合は、器内温が下降する等、児に悪影響を与えることがあるので注意すること。
- 7) 器内温の設定は室温+3℃以上にする。
- 8) 本品を直射日光の当たる場所、暖房器具や冷房器具の近くに設置しないこと。
- 9) 電源コンセントの位置は、本品の近くで電源コードに人が触れない位置を選び、機器 1 台ごとに専用のコンセントを用いること。
- 10) 本品に衝撃を与えたり、ぶついたりしないこと。
- 11) 汚れがあるときは、消毒を行う前にあらかじめ汚れを落とすこと。

- 12) 児を収容する前に、機械が正常に作動することを確認すること。

＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)＞

【併用注意】(併用に注意すること)

- 1) 光線治療器、加温加湿器等の機器を併用する場合には、器内温を室温±5℃以上とすること。

【保管方法及び有効期間等】

耐用期間: 6 年[自己認証データによる]

保管条件: 以下の条件下で保管すること。

保管温度 0～50℃

*相対湿度 10～85%(結露なきこと)

【保守・点検に係る事項】

【使用者による保守点検事項】

1) 点検

毎回の使用の前に、各部品の基本的な機能動作を確認すること。
点検項目は取扱説明書を参照すること。

2) 清拭、消毒

本品は以下の消毒液を使用し、消毒することができる。

クロルヘキシジン水溶液(例:ヒビデン)

塩化ベンゼトニウム(例:ハイアミン)

塩化ベンザルコニウム(例:オスバン)

※使用する消毒剤の濃度などは、それぞれの製剤についている用法・容量指示に従うこと。

下記の消毒液は部位を限定して使用することが望ましい。

塩酸アルキルジアミノエチルグリシン(例:テゴー51)

グルタラル水溶液(例:ステリハイド)

次亜塩素酸ナトリウム(例:ミルトン)※金属部は除く

消毒用エタノール※プラスチック部は除く

【業者による保守点検事項】

1 年に 1 度を目安に定期点検を実施すること。
詳細については弊社または納入業者にご相談ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL: 048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

取扱説明書を必ずご参照ください