



【A-01-R9】

**2023年4月（第9版）

*2018年8月（第8版）

届出番号:13B1X10093A06001


機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 再使用可能な内視鏡用非能動処置具（JMDNコード：38818000）

関節鏡用鉗子

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的な製品は以下の通りです。

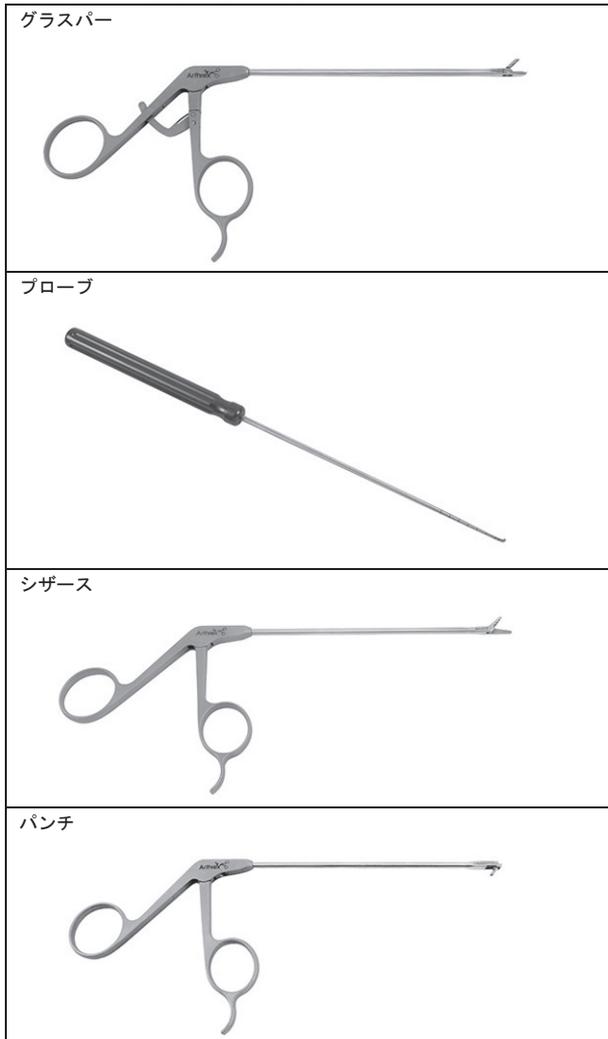

**2. 組成

ステンレス鋼、DLC コーティング

3. 作動・動作原理

外科手術等の際に、組織の把持等の機械的作業に用いる。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器具で、組織又は異物の把持、回収、切除、クリップ、結紮、薬液の送込、吸引、管腔の拡張、探針等の機械的作業に用いるものをいう。電気（高周波、電磁気、超音波、レーザーエネルギー等）を使用せずに作動する。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用方法

関節鏡下手術において、組織や縫合糸等の把持、剥離及び切除等

を行う。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 使用時に衝撃や必要以上の力を加えないこと[患者へのダメージ又は本品が破損するおそれがある]。
- 2) 調整機能を有する器械は特に取扱に注意すること[過度な締め付けや手荒な取り扱いにより、調整機能が破損する可能性がある]。
- 3) 本品を関節に挿入した状態で関節を動かさないこと[本品の曲げ又は破損のおそれがある]。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用後は、直ちに破損等がないことを確認すること。破損等が確認された場合は、破損片が体内に遺残していないか確認し、遺残している場合は摘出等の適切な処置を行うこと。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
(1) 製品の変形・破損

** (2) 動作不良

- 2) 重大な有害事象

本品の使用において患者の状態、適用部位の状態などにより次のような有害事象がまれに現われることがあるので、その場合は直ちに適切な処置を行うこと。

- (1) アレルギー反応・異物反応
- (2) 軟部組織損傷

** (3) 骨損傷

- (4) 感染症
- (5) 体内遺残

*【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

本品は高温多湿や直射日光を避け、水に濡れないよう注意し、清潔な場所に保管すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

1) 洗浄

- (1) 強酸または強アルカリ性洗剤・消毒剤等は器械の腐食の原因となるため使用しないこと。

** (2) アルカリ性洗剤を使用する場合は、必要に応じて適切な中和手順を実行すること。

- (3) 金属製のたわし、クレンザー等は器具の表面を傷つける原因となるため使用しないこと。

- (4) 洗浄前に分解可能な器械は分解すること。

- (5) 汚染の程度や状態により、用手、浸漬、超音波洗浄装置等による予備洗浄を行うこと。隙間、内腔や可動部を有する部分に特に注意を払い、流水でスポンジ又はブラシで器具の表面の汚染を取り除くこと。超音波洗浄装置を使用する場合は10分以上洗浄すること。

- (6) 予備洗浄の後、用手洗浄または機械洗浄、及び消毒を行なうこと。

用手洗浄：

- ① 酵素系洗浄液に浸漬する。

- ② 汚染が残りやすい箇所に注意を払って、柔らかいスポンジやブラシを用いて1分以上洗浄する。隙間、内腔を有する器械は細いブラシやシリンドリ等を使用し洗浄する。可動部

を有する器具は可動部を動かしながら洗浄する。

- ③ 1分以上、精製水で丁寧にすすぐ。
- ④ 20分以上、消毒液に浸漬する。
- ⑤ 1分以上、精製水で丁寧にすすぐ。
- ⑥ 清拭、圧縮空気、乾燥機等により完全に乾燥させる。

機械洗浄：

ウォッシャーディスインフェクターによる機械洗浄を行う。
器械の形状等に合わせて配置し、ヒンジや内腔があるものは水分が残らないように開放すること。

**機械洗浄の最小値(参考)

工程	時間	温度	洗浄剤
予備洗	3分	20 ± 5° C	
洗浄	10分	65.5 ± 5° C	酵素洗剤又は弱アルカリ性洗剤
すすぎ1	3分	50 ± 5° C	(必要に応じて中和剤を使用すること)
すすぎ2	3分	50 ± 5° C	
消毒	5分	90 ± 5° C	
乾燥	6分	115° C	

2) 保守・点検

- (1) 点検頻度：使用前に点検すること。
- (2) 点検項目：
 - ① 完全に乾燥させてから、器械の可動部分に水溶性潤滑油を注油すること。
 - ② 動作確認及び変形や破損の有無を確認すること。特にドリルやタップ等の切除に使用する器械は切れ味を確認し、切れ味の悪い場合は新品と交換すること。

3) 滅菌

- (1) 使用前に予め、次に示す滅菌条件を参考に滅菌バリデーションを行い、無菌性保証が確保された条件で滅菌処理を実施すること。

**高圧蒸気滅菌 (参考)

	プレバキューム	プレバキューム UK
暴露温度	132°C	134°C
暴露時間	4分	3分
乾燥時間	30分	30分
冷却時間	30分	30分

上記滅菌条件は、プリオンの不活化を意図していない。

- (2) 合成樹脂材料を含む器械は滅菌時に滅菌トレーの金網等の金属と接触しないようにすること [合成樹脂が溶解するおそれがある]。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : Arthrex Japan 合同会社
電話 : 03-4578-1000
製造元 : アースレックス社 (アメリカ合衆国)
Arthrex, Inc.
*アースレックス社 (アメリカ合衆国)
Arthrex California, Inc.
アースレックス社 (ドイツ)
Arthrex GmbH

