** 2022 年 3 月 改訂（第 4 版）
＊ 2017 年 3 月 改訂（第 3 版）

医療機器届出番号 ： 09B1X00004000148

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

マルチチャネル用コネクティングチューブ

再使用禁止

【警告】
1. 接続部（両端コネクタ）は外れないように確実に取り付けること。
2. 本品に吸引器とマルチチャネル ドレナージ カテーテルＳ以外を取り付けないこと。[指定外の製品を接続すると接続部の外れやリークの原因となる。]

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 吸引時は過度な陰圧をかけないこと。[チューブが閉塞するおそれがある。]

＊【形状・構造及び原理等】
＜本品の基本構成＞
シングルタイプ（カテーテルを 1 本接続可能）

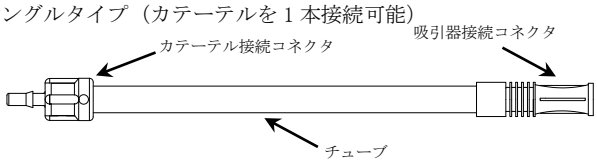

＊ダブルタイプ（カテーテルを 2 本接続可能）

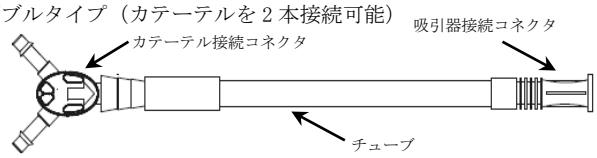

・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。
・別売りのマルチチャネル ドレナージ カテーテルＳ(認証番号：227AABZX00089000)と吸引器を接続する専用接続チューブである。

マルチチャネル用コネクティングチューブ
シングルタイプ

カタログ番号	適用サイズ	カテーテル接続コネクタカラー	チューブ長
5230-35	3.5mm 用	ピンク	12cm
5230-35M	3.5mm 用	ピンク	50cm
5230-35L	3.5mm 用	ピンク	100cm
5230-50	5.0mm 用 フラット型用	ブルー	12cm
5230-50M	5.0mm 用 フラット型用	ブルー	50cm
5230-50L	5.0mm 用 フラット型用	ブルー	100cm
5230-65	6.5mm 用	クリア	12cm
5230-65M	6.5mm 用	クリア	50cm
5230-65L	6.5mm 用	クリア	100cm
5230-80	8.0mm 用	グリーン	12cm
5230-80M	8.0mm 用	グリーン	50cm
5230-80L	8.0mm 用	グリーン	100cm

＊ダブルタイプ

カタログ番号	適用サイズ	カテーテル接続コネクタカラー	チューブ長
5230-65MY	6.5mm 用	クリア	50cm
5230-65LY	6.5mm 用	クリア	100cm
5230-80MY	8.0mm 用	グリーン	50cm
5230-80LY	8.0mm 用	グリーン	100cm

【使用目的又は効果】
本品は吸引器とドレナージカテーテルとの接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製チューブである。
本品は術中の体液等を排出させる際に用いる。

【使用方法等】
1. 接続するマルチチャネル ドレナージ カテーテルＳのサイズを確認する。
2. マルチチャネル ドレナージ カテーテルＳと適用サイズのコネクティングチューブを選択して、汚染に注意し滅菌袋から取り出す。
3. コネクティングチューブのカテーテル接続コネクタ側をマルチチャネル ドレナージ カテーテルＳのカテーテル端に確実に突き当たるまで挿入する
4. 吸引器側の接続端にコネクティティングチューブの吸引器接続コネクタを確実に奥まで挿入して接続する。
5. マルチチャネル ドレナージ カテーテルＳ、コネクティングチューブ及び吸引器の各接続状況を確認後、吸引を開始する。

【使用上の注意】
[重要な基本的注意]
・使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
・包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
・水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
・本品を折り曲げたり、下積みなどで押しつぶさないよう注意すること。
[使用期限]
・包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
[製造販売元]
フォルテグロウメディカル株式会社
電話番号 0283-22-2801

**[販売元]
カーディナルヘルス株式会社
電話番号 0120-917-205