＊2017 年 11 月 22 日改訂（第３版）
＊＊2018 年 3 月改訂（第４版）

届出番号：13B2X00231001004

機械器具（55）医療用洗浄器
手動式生体用洗浄器　34630000　一般医療機器
洗浄剤注入用具　70463000　一般医療機器

ＩＭＧエネマシリンジ

【警　告】
１．本品は未滅菌品なので、必要に応じて使用前に洗浄・消毒・ＥＯＧ滅菌を行なうこと。
２．本品は、天然ゴムを使用している。
・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
・天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

【禁忌・禁止】
・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用をしないこと。
・高圧蒸気滅菌は行なわないこと。［変形・破損］

【形状・構造及び原理等】
本品は、天然ゴム製のゴム球、液体吸入用の一方弁、鼻腔洗浄用ノズルまたは浣腸用カテーテル接続コネクター、これらを連結する塩化ビニル製のチューブ等で構成された手動式の洗浄用および浣腸用医療機器である。

１．形状及び寸法

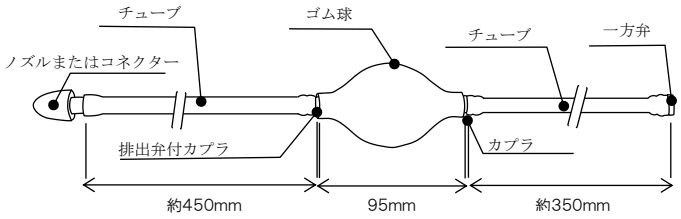

《鼻用ノズル》

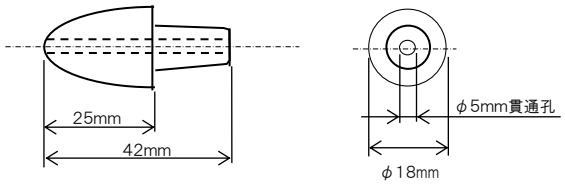

《浣腸用コネクター》

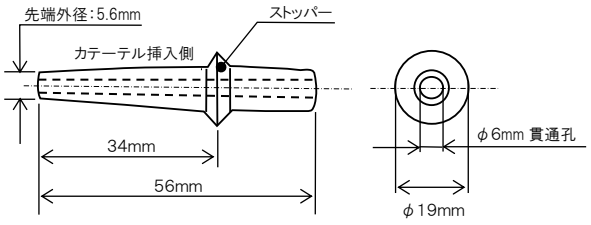

● 本品は、天然ゴムを使用しています。

【使用目的又は効果】＊
１．一般的名称：手動式生体用洗浄器
身体の一部に適用する液体を噴出する装置をいう。衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。手動式である。
２．一般的名称：洗浄剤注入用具
洗浄剤を注入する器具をいう。

【使用方法等】＊
１．必要に応じて、使用前に洗浄・消毒・滅菌等を行なって清潔にし、各構成品がしっかり接続されているかを確認する。
滅菌の場合は、ＥＯＧ滅菌（温度 60℃以下）を推奨します。
■ 鼻腔洗浄の場合
２．チューブの出口側に鼻用ノズルをしっかり挿入する。
３．容器に鼻腔洗浄液を用意し、本品の一方弁を洗浄液の中に入れ、ゴム球を押圧して手を緩めると液が吸い込まれ、再度の押圧により鼻用ノズル先端から液が噴出する。
４．鼻用ノズルを患者の片方の鼻腔に軽く密着させ、始めはゴム球を軽く押し、口を少し開けさせ、声を出させながら徐々に洗浄する。他方の鼻または口から洗浄液が出ることを確認し、以後ゴム球の押圧加減によって噴出量を調節しながら洗浄する。他方の鼻または口から洗浄液が出ないときは、すぐ使用を中止すること。
５．同様に他方の鼻腔も洗浄する。洗浄後、鼻腔内の残留液は鼻をかんで出す。
■ 浣腸の場合
２．チューブの出口側に浣腸用コネクターのストッパーまで挿入し、浣腸用コネクターのカテーテル挿入側に浣腸用カテーテルをしっかり挿入させる。
３．容器に浣腸液を用意し、本品の一方弁を浣腸液の中に入れ、ゴム球を押圧して手を緩めると液が吸い込まれ、再度の押圧によりカテーテル先端から浣腸液が噴出する。
４．患者を左側臥位にして、膝を軽く抱える体位を取らせる。
５．腹部や肛門に余計な力を入れさせないため軽く口を開けさせ、肛門よりカテーテルをゆっくり挿入し、浣腸液を注入する。

【使用上の注意】
１．浣腸の場合、本品に取付けるカテーテルの添付文書も参照すること。
２．各構成品がしっかり接続されていることを確認してから使用すること。［液漏れの恐れ］
３．万一本品に傷・異物・劣化等を発見した場合は使用しないこと。
４．刃物等鋭利なものに接触させないこと。［切断の恐れ］
５．何回も滅菌による高温に曝されると、弾性が減じたり、亀裂を生じます。このような場合は、使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】＊
１．保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】
１．本品を再使用する場合は、感染を防止するために、洗浄・消毒・ＥＯＧ滅菌を行なってから再使用してください。
滅菌温度：60℃以下

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊
製造販売業者：eastsidemed 株式会社 ＊＊
東京都文京区本郷3-24-5
TEL 03-3815-0056　FAX 03-3818-4085