

機械器具（35）医療用はさみ
眼科用せん刀 35327001 一般医療機器

I M G眼科剪刀

【警告】

本品が破損状態にある場合は、絶対に使用しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・ 本品は、使用目的以外に使用しないこと。[誤った使用は、本品が破損する恐れがある]
- ・ 本品を曲げたり、切断、打刻（刻印）等の加工・改造することは、絶対に行わないこと。[折損等の原因]

【形状・構造及び原理等】

本品は、眼科用手術機器として眼科手術に使用され、組織、糸等の切断に使用する。


本品のバリエーションには、先端が鋭いもの、鈍いもの、直剪刀、反（曲）剪刀など使用目的にあわせた種類が用意されており、種類は本品の包装にある表示ラベルに記載してあります。

本品の種類には、次のバリエーションがあります。

- ・ 刃形状：直型、反型
- ・ 刃先：両鈍、両尖

1. 形状及び寸法

形 状 （写真は、刃形状：両尖の種類の例を示す）

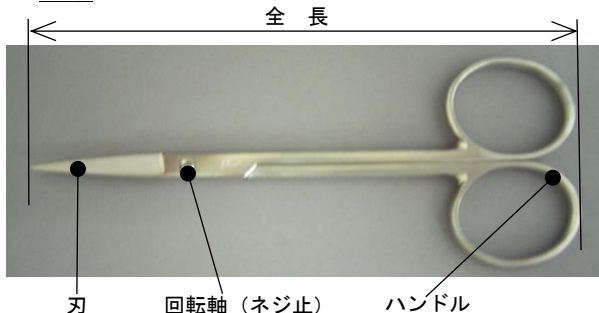

寸 法：全長 10cm～20cm

【使用目的又は効果】

眼科手術時に組織を切断するために用いる眼科用手術機器をいう。例えば、2枚の回転刃のほか、手指及び母指で掴むハンドルから成るものもある。刃は様々な形状のものがある。

【使用方法等】

1. 使用前に、本品を洗浄・消毒・滅菌（【保守・点検に係る事項】参照）等を行なって清潔にする。
2. ハンドルの穴に指を入れハンドルを開閉操作することにより、先端部の刃が開閉する。
3. 2つの刃の間に組織、布、糸等挟み、刃を狭めてこれを切断する。
4. 使用後は、洗浄・消毒・滅菌（【保守・点検に係る事項】参照）等を行ない清潔に保管する。

【使用上の注意】

1. 使用目的にあった種類の本品を使用すること。
2. 本品を包装から取り出す際、及び使用後、洗浄・消毒・滅菌時には先端に十分注意して取り扱うこと。
3. 本品の使用前に、変形や傷がないか、ネジの緩みや外れ等がないか、正常に作動するかを確認してから使用すること。
4. 本品に使用しているステンレス鋼は、繰り返し使用すると腐食が発生することがあるので、特に次の点を注意すること。

- ・ 使用後は、付着している血液・体液・組織・薬品等が乾燥する前に直ちに洗浄液等に浸漬するなどして除去すること。
 - ・ 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因となるのでできるだけ使用は避けること。これらが付着したときには水洗いをする。
 - ・ 洗浄後、完全に乾燥させること。特に金属が重なり合っている部分には十分注意すること。[乾燥不足は、錆が発生する]
5. 電気メスの使用中は、本品を併用しないこと。[感電・火傷をする恐れがある。また、本品の表面を損傷する恐れがある]
 6. 本品の異常に気がついた場合は、直ちに使用を中止すること。
 7. 本品は、使用方法・使用回数による金属疲労により破損することがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管期間の長短にかかわらず、保管にあたっては、必ず洗浄をし、乾燥させること。[錆の発生を防ぐため]
2. 保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触や、衝撃を避けるよう注意すること。
3. 高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。特に、水漏れや直射日光は避けるよう細心の注意をすること。
4. 異なる金属と接触して保管しないこと。[錆が発生する]

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、付着している血液・体液・組織等を除去し、洗浄・消毒・滅菌等を行うこと。[感染の防止]
 - ・ 超音波洗浄装置等で洗浄するときには、可動部分は開放してキット等に収納し、汚れが落ちやすいようにすること。
 - ・ 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには浄化水（ろ過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨します。
 - ・ 洗浄後は、本品を直ちに乾燥させること。[錆の発生]
 - ・ 強アルカリ性洗剤・強酸性洗剤・消毒剤は使用しないこと。[錆の発生]
 - ・ 金属ブラシ、クレンザー（磨き粉）等は、付着物除去及び洗浄に使用しないこと。[表面の損傷、錆の発生]
 - ・ 本品の再使用にあたっては感染を防止するために、洗浄後、消毒・E O G滅菌・高圧蒸気滅菌等を行ってから使用すること。
 - ・ 滅菌をするためのセットまたは包装では、本品の刃は開いて、重なる部分を少なくして、確実に滅菌できるようにすること。
2. 可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨します。
 3. 汚れ、傷、曲がり、刃の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：eastsidemed 株式会社 * *

東京都文京区本郷3-24-5

TEL 03-3815-0056 FAX 03-3818-4085