

類 別：機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 管理医療機器
 一般的名称：医用電子血圧計（JMDN コード 16173010） 特定保守管理医療機器

医用電子血圧計 UM-211

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

（血圧計を適正にご使用頂くための注意事項です。）

- ・傷など未治癒の腕にカフを巻かないでください。[出血など症状を悪化させるおそれがあります。]
- ・点滴や輸血を行っている腕にカフを巻かないでください。[怪我や事故をおこすおそれがあります。]
- ・病院内の麻酔ガスなど可燃性ガスの近くで使用しないでください。[引火の可能性があります。]
- ・病院内の高圧酸素室や酸素テント内など高濃度酸素下で使用しないでください。[発火の可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

（１）各部の名前 UM-211

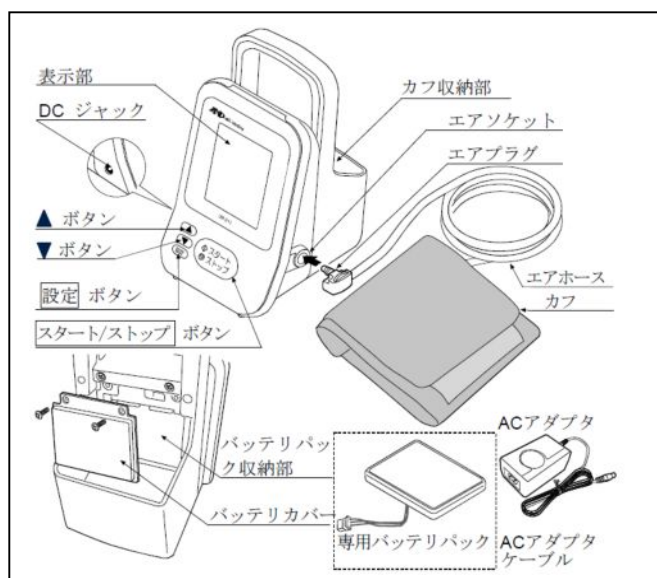

標準付属品

取扱説明書（保証書付き）	1 冊
専用バッテリーパック	1 個
添付文書	1 枚
カフ	1 個
ACアダプタ	1 個
ACケーブル	1 本

（２）体に接触する部分の原材料

カフ	：綿・ポリエステル
ボタン	：シリコンゴム
エアホース	：PVC

（３）本体寸法及び質量

外形寸法	：120(幅)×201(高さ)×145(奥行き)mm
質 量	：約 550 g（専用バッテリーパック除く）

（４）電氣的定格

電 源	：DC3.6V 3W (Ni-MH 二次電池)
	AC100V 50-60Hz 12VA (ACアダプタ使用時)

電撃保護：内部電源機器 BF 形（バッテリー使用時）
 クラスⅡ BF 形（ACアダプタ使用時）

（５）作動・動作原理

カフ圧力を最高血圧以上に加圧後、徐々に減圧するとカフ内圧力に心拍に同期した脈動現象が現れます。この脈動は、出始めは小さく、減圧に従い大きくなり、やがて最大振幅を示した後、再び小さくなる山型のパターンになります。オシロメトリック方式の血圧計は、この脈動分の振幅波形情報をマイクロコンピュータで解析して最高血圧および最低血圧を決定しています。

（６）品目仕様等

測定方式	：オシロメトリック方式
血圧測定範囲	：0～299mmHg（数値表示圧力）
最高血圧測定範囲	：60～279mmHg
最低血圧測定範囲	：40～200mmHg
脈拍測定範囲	：40～200 拍/分
精度	：圧力 ±3mmHg 以内 ：脈拍 読み取り数値の±5%以内
測定可能腕周	：約 22～32 cm（付属のカフ）
動作環境条件	：+5～+40℃、10～85%RH、 800hpa～1060hpa
保存環境条件	：-20～+60℃、10～95%RH、 700hpa～1060hpa

EMD 適合

本製品は EMD 規格 IEC60601-1-2:2014 に適合しています。


【使用目的又は効果】

動脈血圧の非観血的測定により、収縮期及び拡張期血圧を表示すること。

【使用方法等】


（１）専用バッテリーパックの入れ方

1. 本体の電源が切断されていることを確認してください。
2. 本体背面のバッテリーカバーを固定しているネジを外します。
3. バッテリーカバーを外します。
4. 専用バッテリーパックからのびているコネクタをバッテリーパック収納部にあるコネクタに、左側にあるツメを押しながら接続します。
5. バッテリーカバーを閉めます。
6. バッテリーカバーをネジで固定します。

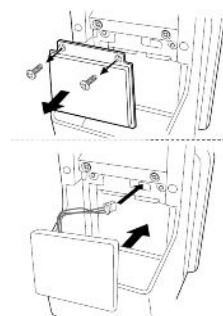

（２）AC アダプタの接続方法

1. AC アダプタプラグを DC ジャックに差し込みます。
 2. AC アダプタをコンセントに接続します。
- ※必ず指定の AC アダプタを使用してください。



取扱説明書を必ずご参照ください。


お知らせ：AC アダプタから本体に電源が供給されないとき血圧計はバッテリーで動作します。

(3) 電池の充電方法

- ・AC アダプタを血圧計に接続すると、充電が開始します。
- ・AC アダプタが血圧計に接続された後、約 4 時間で充電は完了します。
- ・充電中、充電マーク (⇒) が点滅します。
- ・充電が完了すると充電マークは点灯し続けます。


(4) カフの巻き方

1. 手のひらを上に向け、ひじ関節内側から 1~2 cm 上に巻いてください。
カフの適正範囲は、INDEX マークが RANGE マークに重なる範囲となります。
2. ●マークを動脈に重なるようにカフを当てます。
3. カフを腕に、指が 1~2 本入る程度のゆるみをもたせて巻いてください。

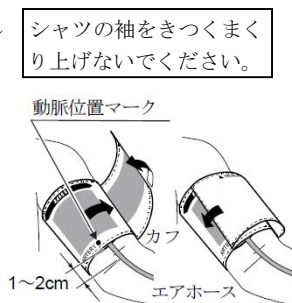

(5) 血圧測定方法

1. 腕にカフを巻きます。測定中はリラックスして座ってください。
2. **スタート/ストップ** ボタンを押してください。
表示が全点灯します。「0」を表示後、測定を開始し、右図のように表示が変化していきます。
カフの加圧が開始します。加圧中はカフがきつく感じるかもしれません。
お知らせ：測定中、加圧を止める場合は、**スタート/ストップ** ボタンをもう一度押してください。
3. 加圧が終了すると、自動的に減圧が開始し、測定中であることを示す♥ (ハートマーク) が点灯します。脈拍が検出されると、拍動に合わせてマークが点滅します。
4. 測定が終了すると、最高・最低血圧値と脈拍が表示されます。カフ内の空気が全て排気されます。
5. **スタート/ストップ** ボタンを押すことで、再測定が開始されます。
一定時間操作されない場合、血圧計は自動的に待機モードに移行します。

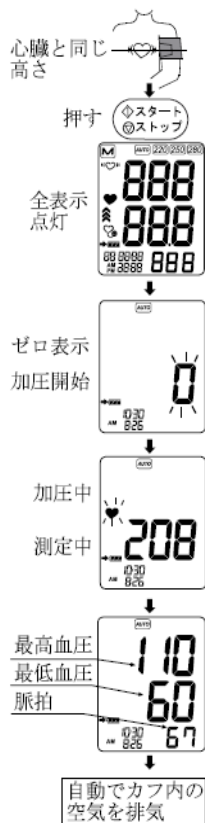

- ・直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください。
- ・ホコリ、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください。
- ・傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください。
- ・携帯電話など電磁波を発生する機器を近づけないでください。誤作動する可能性があります。
- ・血圧測定の目的以外には、使用しないでください。
- ・分解や修理・改造を行わないでください。発火したり故障や事故をおこすおそれがあります。
- ・他の医療用具や器具と接続しないでください。事故のおそれがあります。
- ・動作温湿度範囲内でご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

高温・高湿・直射日光は避けてください。
また、ホコリの多い所も避けてください。
長期間(約1ヶ月)使用しない場合は、専用バッテリーパックを取り出してください。

(2) 耐用期間

製造日から正規の保守点検を行った場合、製品本体5年間とする。(当社データによる) ※消耗品は除く

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- ・しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動すること(電源が入る、加圧するなど)を確認してからご使用ください。
- ・清掃を行う場合は、AC アダプタを外してください。
- ・本体やカフが汚れたときは、ガーゼ等を水またはぬるま湯に浸し、よくしぼってから拭き取ってください。
- ・DC ジャックおよびエアソケットは濡れた布などで拭かないでください。また、濡れたままにもしないでください。
- ・感染防止のため、本体、カフは定期的に消毒を行ってください。消毒する際は、消毒液に浸したガーゼ等をよくしぼってから軽く拭き、その後、水またはぬるま湯に浸したよくしぼったガーゼ等で消毒液を拭き取り、更に乾いた柔らかい布等で水気を拭き取ってください。なお、希釈率はその製品の注意書きの指示に従い、水溶液として使用してください。
使用可能な消毒液(成分表)例は以下のとおりです。
エタノール/イソプロパノール/次亜塩素酸ナトリウム/クロルヘキシジングルコン酸塩/ベンザルコニウム塩化物
- ・清掃は病院の定めた方針や手順をもとに、1ヶ月に1回程度行ってください。
- ・シンナー、ベンゼンなどの有機溶剤を用いて清掃しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社エー・アンド・デイ
住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
電話：048-593-1434

お問い合わせ先

名称：株式会社エー・アンド・デイ
ME 機器相談センター
電話：0120-707-188

【使用上の注意】

- ・カフを正しく巻かないと測定できない場合があります。
- ・衣類の上から巻くと測定誤差の原因になります。
- ・本機は万が一電源を切り忘れても一定時間で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を備えております。
- ・表示部にバッテリー不足マークが点灯した場合は、AC アダプタを接続しバッテリーを充電してください。