

＊ ＊ 2018年3月改訂（第10版）

＊ 2017年9月改訂（第9版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X000880KS149

機械器具(25) 医療用鏡

一般医療機器 レゼクトスコープ用吸引器 37143000

エバキューエーター

【警告】＊

二球タイプはガラス製なので、取扱には十分注意すること。特にホースやゴム球体の取り外しの際に注意のこと。


【禁忌・禁止】＊

本製品の原材料には一部ラテックスが含まれているため、ラテックスアレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

※代表的な形状を記載する。


1. 二球タイプ

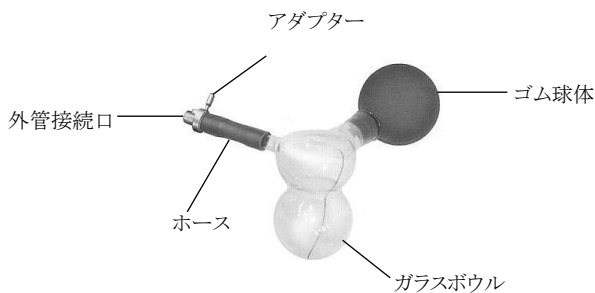

名 称	機 能 及 び 動 作	原 材 料
外管接続口	外管を接続するための口。	ステンレス鋼 ※
ホース	外管接続口とガラスボウルを接続する。	シリコーンゴム ※
ガラスボウル ＊	灌流液を満たし、ゴム球体のポンピングによって洗浄及び組織切片の回収を行う部分。	ガラス ※
アダプター ＊	外管に接続する補助具。	ステンレス鋼 ※
ゴム球体 ＊	操作者がポンピングすることで灌流液の出し入れを行う部分。	スチレンブタジエンゴム・天然ゴム混合物※

※:組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分

2. シリンジタイプ

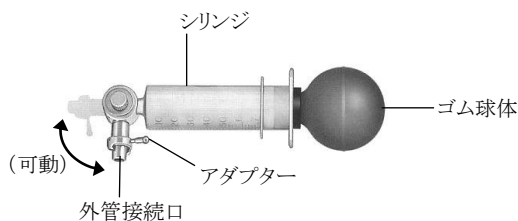

名 称	機 能 及 び 動 作	原 材 料
外管接続口	外管を接続するための口。	ステンレス鋼 ※
シリンジ ＊	灌流液を満たし、ゴム球体のポンピングによって洗浄及び組織切片の回収を行う部分。	ポリプロピレン ※
アダプター ＊	外管に接続する補助具。	ステンレス鋼 ※
ゴム球体 ＊	操作者がポンピングすることで灌流液の出し入れを行う部分。	スチレンブタジエンゴム・天然ゴム混合物※

※:組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分

【使用目的又は効果】

本品は、下部尿路系の手術、経尿道前立腺切除術後に、膀胱及び尿道部の洗浄及び組織切片の回収の目的で使用する。

【使用方法等】

1. 使用前に所定の方法で滅菌を行う。
2. ガラスボウル(シリンジ)内に生理食塩水又は非電解質洗浄液を適量満たす。
3. 本品の外管接続口にレゼクト用の外管(品番例:K27040SL)を取り付ける。(シリンジタイプは先端部の角度の調節が可能)
4. ゴム球体を手でポンピングすることで、ガラスボウル(シリンジ)内の液体が体内に出入りし、洗浄・回収を行う。(二球タイプの場合、下のガラスボウルへ組織片等が貯まる仕組みになっている。)
5. ゴム球体を外し、灌流液を廃液する。

＜使用方法等に関連した使用上の注意＞ ＊

1. 本品は未滅菌品のため、使用前に所定の方法で滅菌を行うこと。
2. 滅菌は常に同一の方法で行うことを推奨する。[異なる滅菌方法を実施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・損傷を招き、故障につながる可能性が高い]

【使用上の注意】＊

＜重要な基本的注意＞

1. 使用前に二球タイプのガラスボウル部分に割れやヒビ等がないことを必ず確認すること。わずかでも異常が見られたら使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. よく洗浄後、必ず乾燥させてから保管すること。
2. 水のかからない場所に保管すること。
3. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分やイオウ分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
4. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
5. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】＊

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。(特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。)
3. 器具は使用後速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。[付着物は修復不能な損傷の原因になる]
4. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。

5. 本品を洗浄、消毒、滅菌する際は、他の器具類とは別に取扱うこと
[他の器具が重なり合うことにより、損傷の原因となるため]

6. 洗浄方法

(1) 自動洗浄器

- ① 内視鏡のプログラムが設定されている自動器具洗浄器を使用し、管腔を有する器具は専用洗浄チューブを接続して使用すること。
- ② 適切なラック(K39219 又は K39501 シリーズ)を使用し、他の器具と重なり合わないように入れること。[他の器具と重なり合うことにより損傷の原因となり、また、重なっている部分で洗浄効果が減衰する]
- ③ 器具の接続部を開放し、ストップコックやシーリングを分解してラックに入れること。
- ④ 温水の温度が、硬性鏡は 90℃、軟性鏡は 60℃を超えないこと。
- ⑤ 洗浄剤や水質によっても製品にダメージを与える場合があり、器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中止し、洗浄剤、水質の確認を行うこと。

(2) 超音波洗浄器

- ① テレスコープの超音波洗浄は行わないこと。[光学系に損傷を与える可能性がある]
- ② プラスチック等軟性部品には使用しないこと。[超音波振動を吸収するためには効果が無いのみならず、材質の劣化を促進する可能性がある]
- ③ 剪刀・ネジを有する器具には使用しないこと。[超音波の振動によって繊細な剪刀の刃先が欠損する可能性や、微細なネジの緩みが発生し、機能に影響を与える可能性がある]

(3) マニュアル洗浄

- ① 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行う。
- ② 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
- ③ 管腔内を洗浄するため適切なブラシ(K27650 シリーズ)やクリーニングピストル(K27660)を準備すること。
- ④ 洗浄、浸漬用にフタ付きで水きり用の内かごが付いている容器(K27645 等)を準備すること。
- ⑤ 洗浄手順
 - a. ストップコックやシーリング等、器具の接続部をすべて分解する。
 - b. 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。水温は 35～40℃前後(暖かいと感じる温度)が適温である。薬剤による器具の損傷の可能性があるので、溶液には 60 分以上浸漬したままにしないこと。
 - c. スポンジで全ての外表面を注意深く清掃する。
 - d. 管腔内は適切なブラシやクリーニングピストルを用いて洗浄する。
 - e. 純水で時間をかけて十分な濯ぎを行う。
 - f. 埃の出ないやわらかい布や圧縮空気で乾燥させる。

7. 洗浄後の器具の点検とお手入れ

- (1) 外観の目視(特に体内に入る部分は入念に)確認、可動部の機能確認を行うこと。(異常が見られたら使用を中止し、交換すること。)
- (2) プラスチック又はシリコン部品の変色・変質・柔軟性(硬化の有無)・孔の有無を確認し、異常が認められた場合は直ちに部品を交換すること。
- (3) 高周波適用器具の絶縁部のはがれ・めくれ・傷・亀裂等を目視確認すること。(これらが認められたら使用を中止し交換すること。)
- (4) ストップコックの接触面に専用グリス(K27657)を必ず塗布すること。

(5) 鉗子のジョウ等すべての可動部分には、滅菌による熱損傷を防止する為、専用オイル(K27656B)を必ず塗布すること。

8. 洗浄剤

- (1) 材質にアルミニウム、真鍮を使用している製品にはアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤は使用しないこと。[材質に損傷を与える可能性が高い]
- (2) その他の製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純水にて十分に濯ぎを行うこと。
- (3) 内視鏡および内視鏡関連器具に適した洗浄剤又は消毒剤を使用すること。

9. 使用前に必ず下記の何れかの方法で滅菌又は消毒を行うこと。

注1: 滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。

(1) オートクレーブ滅菌方法

本品を専用滅菌ケース又はトレイに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。

<滅菌条件>

・温度 : 134 ℃～137 ℃

・時間 : 4～18 分間

※真空式高圧蒸気滅菌(pre-high vacuum)方式のオートクレーブを推奨する。

※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。

(2) 薬液消毒方法

容器を2 個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。薬液に 30 分浸した後、本品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。

<消毒条件>

・使用薬液 : 2%グルタールアルデヒド

※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。

また、本品を 60 分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*,**




製造販売業者: エム・シー・メディカル株式会社

電話: 03-5715-2800 (代表)

製造業者: カールストルツ社 (KARL STORZ SE & Co. KG)

国名: ドイツ



添KS149-10