

2021年6月 21日作成（第1版）
2023年2月 3日作成（改訂第2版）
2023年3月 6日作成（改訂第3版）

管理番号 20210621028OP-3
届出番号 18B3X00004AT0028

医療器具（71）視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000
老眼鏡 A28

【禁忌・禁止】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

- 眼鏡レンズ(アクリル樹脂)1組とプラスチック/メタルフレームからなる器具。
- プラスチック製(アクリル樹脂)視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 老眼鏡。 レンズ度数 +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50 +4.00まで7度数。


種類	フレーム形状		フレームカラー	レンズ度数	
	プラスチック				
		R2014	BK	+1.00	
		ACRL13C	BW	+1.50	
		CCRL11C	NAVY	+2.00	
		FUR2000	WHT	+2.50	
		SPR02	DEMI	+3.00	
		SF3000R	WIN	+3.50	
		LT P301 1 CWI	CWI	+4.00	
		LT P301 2 CBR	CBR		
		LT P301 3 CBU	CBU		
		LT-P12	BKM		
		LT-P13	DEMI		
		LT-P14	BK		
		LT-P15	DEMI		
		LT-P16	WN		
		LT-P17	TC		
		LT-P18	DEMI		
		LT-P19	VI		
		LT-P20	PK		
		LT-P21	GR		
		LT-P22	DEMI		
		LT-P23	KH		
		メタル/ プラス チック	SF3004	黒 BK	
				DEMI	
	2種		15種	7種	

形状 構造

プラスチック	
PBRK01C	
PBRK02C	
PBRK03C	




形状 構造

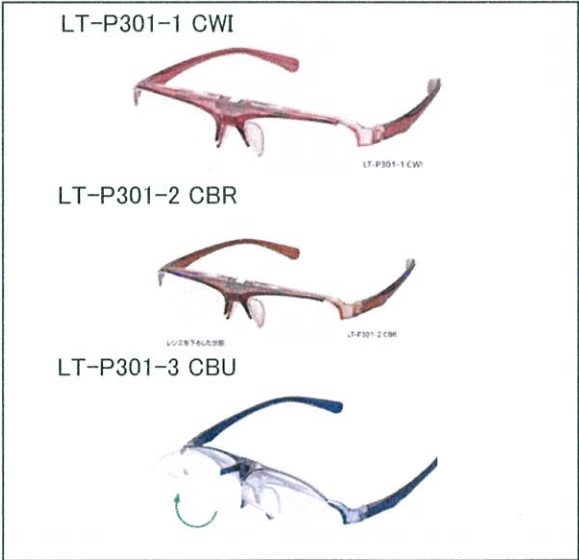

形状 構造



形状 構造

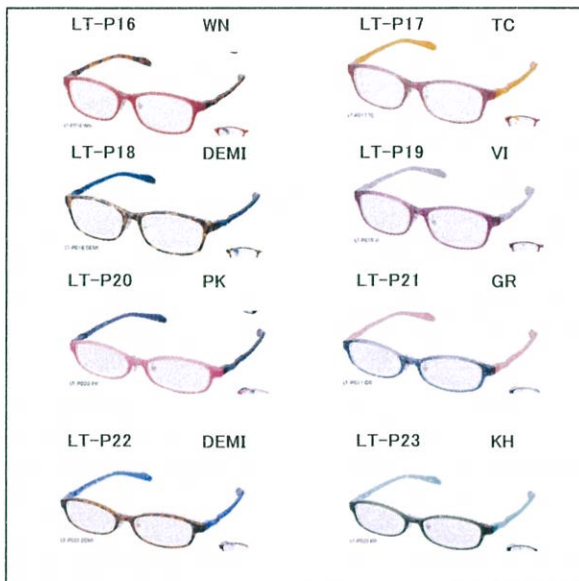

動作原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより視力を補正する、

【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

- 老眼鏡。手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、度数の外観検査
(検眼器、社内基準書に基づく)

【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

- 1pc個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス

福井県 福井市 文京6-21-5

☎0776-21-4472

18B3X00004

18BZ200051

販売元 株式会社エニックス

福井県 福井市 菅谷2-3-14

外国製造業者

APEX EYEWEAR PRODUCT CO.,LTD

中国

BG10501328