


一般医療機器 歯科材料09 歯科用研削材料
歯科用研磨器材 JMDNコード70907000
パワーブラスタースリム

【警告】**＜使用方法＞**

- ・煙や異臭などの異常が発生した場合は直ちに電源スイッチをオフにし、差込プラグをコンセントから抜くこと。[火災につながるおそれがあるため]
- ・研磨材を噴射する時は、クリア窓を閉めてから使用すること。[目や顔などを傷めるおそれがあるため]

【禁忌・禁止】**＜使用方法＞**

- ・電源は本体の電気容量を考慮して、15アンペア以上の3Pコンセントを使用すること。[火災につながるおそれがあるため]
- ・設定エア圧力は、0.2～0.6MPaで使用すること。[0.8MPaを超える高圧を加えると、本機の故障や傷害を負うおそれがあるため]

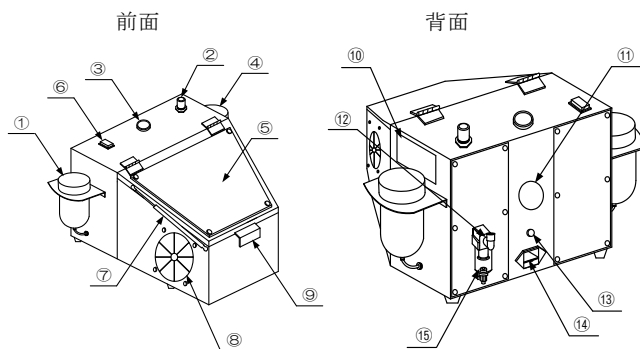【形状・構造及び原理等】**＜外形図＞**

番号	名 称	番号	名 称
①	左研磨材タンク	⑩	定格銘板
②	圧力調整ツマミ	⑪	ダストロ
③	圧力計	⑫	エア接続口
④	右研磨材タンク	⑬	フットスイッチ接続コネクタ
⑤	クリア窓	⑭	電源コード接続コネクタ（ヒューズホルダ付き）
⑥	電源スイッチ	⑮	エアーフィルター
⑦	ダンパー	⑯	
⑧	サイドラバーゴム	⑰	
⑨	クリア窓開閉ツマミ	⑱	

＜付属品（その他）＞

- ・フットスイッチ
- ・電源コード
- ・補綴物用棚
- ・ダストコレクター
- ・ダストアダプタ
- ・六角棒レンチ
- ・研磨材識別シール
- ・研磨材ふるい
- ・底板固定フック
- ・刷毛
- ・エアーチューブ
- ・研磨材排出ホース
- ・電源用ヒューズ(250V1A)
- ・クリア窓フィルム（2枚）

＜電気的定格＞

- ・電源電圧：AC 100V ±10%
- ・電源周波数：50/60Hz ±1Hz
- ・消費電力：26VA
- ・本機器はEMC規格JIS C 61326-1:2022に適合している

＜寸法及び重量＞

- ・寸 法：464W×250H×344D（mm）
- ・重 量：約7kg

＜使用環境条件＞


- ・温 度：5～40℃
- ・湿 度：30～80%RH（結露無きこと）

＜動作原理＞

本機器は、外部から供給されるエア源により、研磨材タンクに充填された研磨材を噴射することができ、補綴物等の研磨及び研削、埋没材の除去ができる。
詳細は取扱説明書を参照すること。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨及び研削に用いる器材。埋没材の除去にも用いる。



番号	名 称
①	ペンシル切替スイッチ
②	照明LED
③	左ペンシル
④	右ペンシル
⑤	底板
⑥	底板持ち上げツマミ
⑦	研磨材排出口（底面）

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

＜操作方法＞

詳細は取扱説明書を参照すること。

1) 運転準備

- ① 付属の電源コードとフットスイッチを接続する。
- ② 付属のエアーチューブを用いてコンプレッサーなどの一次供給源と接続する。
- ③ 研磨材タンクにガラス研磨材とアルミナ研削材を投入する。

2) 運転操作

- ① 電源スイッチを入れる。
- ② コンプレッサーなどからエアーを供給し、圧力を調整する。
- ③ 作業室内に被研磨物を置き、クリア窓を閉める。
- ④ ペンシル切替スイッチで希望の研磨材を選択する。
- ⑤ 選択した研磨材のペンシルを持ち、フットスイッチを踏むと研磨材が噴射される。
- ⑥ 作業終了後は、被研磨物を取り出す。

【使用上の注意】

＜使用方法＞

詳細は取扱説明書を参照すること。

- ・必要に応じて、防塵めがね、マスクなどの保護具を着用して作業すること。[目や顔などを守るため]
- ・噴射する際は、ゴム手袋を着用して作業すること。[手指を守るため]

【保管方法及び有効期間等】

① 保存温度・湿度

温度 : -20～60℃
湿度 : 10～85%RH (結露無きこと)

② 耐用期間 (当社データによる自己認証)

本体 : 7 年
(消耗品を除く)

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

詳細は取扱説明書を参照すること。

① 作業室内の清掃

日常のお手入れとして使用前または定期的に作業室内のダストを排出すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

名 称: S K メディカル電子株式会社
住 所: 滋賀県長浜市七条町 3 0 5 - 1
電話番号: 0 7 4 9 - 6 3 - 1 2 6 3

発 売

名 称: 株式会社歯愛メディカル
住 所: 石川県能美市福島町に152番地
電話番号: 0 7 6 - 2 7 8 - 8 8 0 0

取扱説明書を必ずご参照ください。