**2023 年 09 月（第 5 版）
*2021 年 02 月（第 4 版）

届出番号：13B1X00167000146

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器　手術台アクセサリー　　JMDN コード：　70469000

シーラー・手術台アクセサリー（ＡＸＩＳ用）

【警告】
＜使用方法＞
①患者を長時間にわたって同一の体位に保つことや、皮膚に過度な圧迫がかかることは避けること。［神経麻痺や褥瘡等の原因となる場合があるため］
②正しく患者の位置を決めて、継続的な観察を維持すること。［間違った患者のポジショニングにより生命機能が害される場合があるため］

**【形状・構造及び原理等】

1.　形状

番号	品番	品名 取付方法
①	90271	Ｘ線カセットチャンネル（ＡＸＩＳ５００用）
	90908	手術台へ直接
②	90528	Ｘ線カセットフレーム
		サブアクセサリー
③	90943	ショートシートバー
		手術台へ直接
④	90951	延長板（カット無）
		手術台へ直接
⑤	90952	延長板（カット付）
		手術台へ直接
⑥	90421	コレクティングトレイ
		サブアクセサリー
⑦	92024	ベースユニットアダプター
		手術台へ直接
⑧	91450	頭板
	91490	手術台へ直接
⑨	91491	頭板（アダプター付）
		手術台へ直接
⑩	90900	頭板（ショート）
		手術台へ直接
⑪	90040	ヘッドレストホルダー（六角穴）
		サブアクセサリー（頭板、９０４５６使用）
⑫	90041	ヘッドレストホルダー（丸穴）
		サブアクセサリー（頭板、９０４５６使用）
⑬	90456	９００４１用アダプター
		サブアクセサリー（頭板使用）
⑭	90001	フラットヘッドレスト
		サブアクセサリー（ヘッドレストホルダー使用）
⑮	90003	馬蹄型ヘッドレスト
		サブアクセサリー（ヘッドレストホルダー使用）
⑯	91440	脚板（Ｔｙｐｅ－Ａ）
		手術台へ直接
⑰	91496	脚板（Ｔｙｐｅ－Ｂ）
		手術台へ直接
⑱	90914	脚板（Ｔｙｐｅ－Ｄ）
		手術台へ直接
⑲	90940	脚板（Ｔｙｐｅ－Ｅ）
		手術台へ直接
⑳	90501	軽量脚板／カバー
		手術台へ直接
㉑	90624	ＳＰカーボン板・ＡＸＩＳ
	90627	手術台へ直接
㉒	90625	ＨＬカーボン板・ＡＸＩＳ
		手術台へ直接

①Ｘ線カセットチャンネル（ＡＸＩＳ　５００用）

②Ｘ線カセットフレーム

③ショートシートバー

④延長板（カット無）

⑤延長板（カット付）

⑥コレクティングトレイ

⑦ベースユニットアダプター

⑧頭板

⑨頭板（アダプター付）

⑩頭板（ショート）

⑪ヘッドレストホルダー（六角穴）

⑫ヘッドレストホルダー（丸穴）

⑬９００４１用アダプター

⑭フラットヘッドレスト

⑮馬蹄型ヘッドレスト

⑯脚板（Ｔｙｐｅ－Ａ）

⑰脚板（Ｔｙｐｅ－Ｂ）

⑱脚板（Ｔｙｐｅ－Ｄ）

⑲脚板（Ｔｙｐｅ－Ｅ）

⑳軽量脚板／カバー

㉑ＳＰカーボン板・ＡＸＩＳ

㉒ＨＬカーボン板・ＡＸＩＳ

2. 構造及び原理

本品の各構成品をシーラー社製ＡＸＩＳ手術台（別売品）に接続することにより、手術時に必要な体位を得ることが出来る。各部はネジにより固定される。

3. 原材料

品名	原材料
Ｘ線カセットチャンネル（ＡＸＩＳ５００用）	ポリエステルフォーム、アルミニウム合金、ステンレス鋼、硬質ポリウレタンフォーム
Ｘ線カセットフレーム、ベースユニットアダプター、ヘッドレストホルダー、９００４１用アダプター	ステンレス鋼、サーモプラスチック
ショートシートバー、脚板	ポリエステルフォーム、ステンレス鋼
延長板	ポリエステルフォーム、ステンレス鋼、サーモプラスチック
コレクティングトレイ	ステンレス鋼、シリコーンゴム
頭板	ステンレス鋼、ポリエステルフォーム、アルミニウム合金、サーモプラスチック
フラットヘッドレスト	ステンレス鋼、サーモプラスチック、モルトプレンフォーム
馬蹄型ヘッドレスト	モルトプレンフォーム、アルミニウム合金、サーモプラスチック
軽量脚板	ステンレス鋼、ポリアセタール
ＳＰカーボン板・ＡＸＩＳ、ＨＬカーボン板・ＡＸＩＳ	ポリエステルフォーム、ステンレス鋼、炭素繊維強化プラスチック

4. 寸法等

外装に記載

＊**【使用目的又は効果】**

本品は、シーラー社製ＡＸＩＳ手術台（別売品）に接続するアクセサリーである。

【使用方法等】

必要に応じてシーラー社製ＡＸＩＳ手術台（別売品）に取付け、患者を支える。代表的な併用医療機器は下記のとおり。
取付方法については【形状・構造及び原理等】の項を参照。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

販売名	製造販売届出番号
電動式手術台　ＡＸＩＳ５００	13B1X00167000158

＜使用例＞

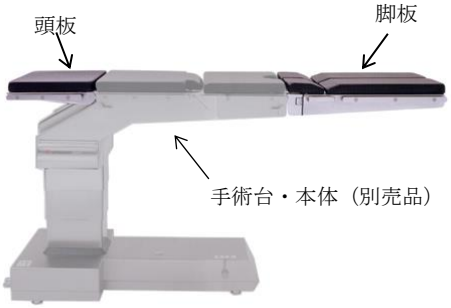

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用前に本品と手術台、本品の各構成品が確実に接続・固定されていることを確認すること。[落下事故防止のため]

2. 手術台（別売品）に本品を接続した後、各アクセサリーの上だけに乗ったり、座ったりしないこと。[手術台の横転、破損防止のため]

3. 操作中は各部位の隙間に手や指を入れないこと。[怪我防止のため]

【保管方法及び有効期間等】

ネジ等の部品の紛失に注意し、高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄方法

①使用後は速やかに中性洗剤で洗浄(手洗い)又は消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取り除くこと。

②機械による洗浄（ウォッシャーディスインフェクターの類）及び水中に浸け置きはしないこと。

③苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤は腐食の原因となり、材質の劣化を著しく早めるため使用しないこと。

④中性洗剤であってもアルミニウムには使用できないタイプがあるため、事前に洗浄剤の説明書にて使用の可否を必ず確認すること。

⑤金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

⑥乾熱乾燥器の類は使用しないこと。

⑦本品は滅菌の必要はない。

※本品は度重なる洗浄及び使用による金属疲労により、破損する場合がある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

欧和通商株式会社：TEL　03（5803）7172

＜製造業者＞

日本語名：シーラー・メディカル社（スイス）

英　　名：Schaerer Medical AG（Switzerland）

＜問い合わせ先＞

欧和通商株式会社　札幌営業所：TEL　011（708）7725

東京営業所：TEL　03（3813）8201

大阪営業所：TEL　06（6304）9305

福岡営業所：TEL　092（526）3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス　http://www.ohwa-tsusho.com