**2024 年 09 月（第 4 版）
*2023 年 09 月（第 3 版）

届出番号：13B1X00167000319

機械器具　01　手術台及び治療台
一般医療機器　手術台アクセサリー　JMDN コード：70469000

オーワ・オーバーテーブルＶ２

【形状・構造及び原理等】

１．形状・構造

＜セット＞

名称
オーワ・オーバーテーブルＶ２

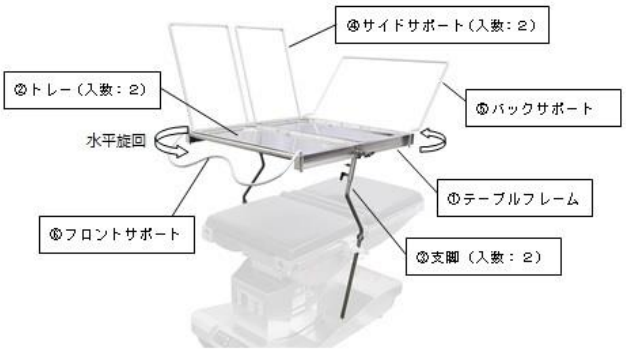

＜セット構成品＞

番号	上段：品名／下段：概要
①	テーブルフレーム 支脚へ取り付け、支脚の傾斜の範囲で水平旋回する
②	トレー 滅菌を行った上でテーブルフレーム上へ設置し、外科手術の際に鋼製小物等を置く
③	支脚 手術台へ接続する
④	サイドサポート
⑤	バックサポート テーブルフレームへ取り付け、滅菌済みの覆布を掛けて、清潔野との区別をする（④⑤共通）
⑥	フロントサポート テーブルフレームへ取り付け、滅菌済みの覆布をかけて頭皮フック等を保持する

①テーブルフレーム

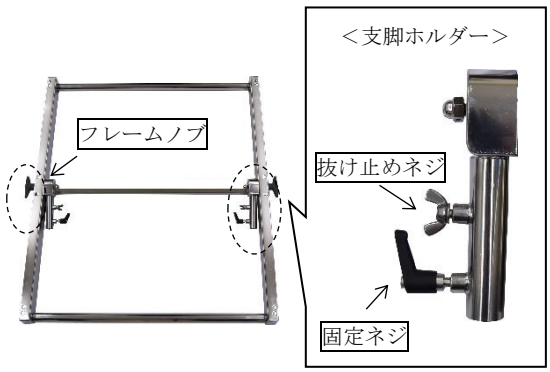

※サイドサポート用の内穴 8 カ所、バックサポート・フロントサポート両用の外穴 4 カ所を持つ。

②トレー

③支脚

**④サイドサポート

⑤バックサポート



⑥フロントサポート

＊２．原理
市販のサイドレールクランプに接続した支脚が回転し、支脚の傾斜の範囲でテーブルフレームが水平旋回する。

＊３．原材料
①テーブルフレーム：ステンレス鋼、ナイロン
②トレー、③支脚：ステンレス鋼
④サイドサポート、⑤バックサポート、⑥フロントサポート：アルミニウム

４．寸法等
外装に記載

５．耐荷重
10kg

【使用目的又は効果】
本品は外科手術の際、手術台に取り付けて使用することを目的とする。

取扱説明書を必ずご参照下さい

＊【使用方法等】

1. トレーは使用前に洗浄し、覆布で包んで滅菌を行う。

2. テーブルフレームのフレームノブ、抜け止めネジ、固定ネジを緩める。

3. テーブルフレームの支脚ホルダーに支脚を奥まで差し込み、抜け止めネジを締めて支脚が抜けないようにする。

4. 手術台のサイドレールに市販のサイドレールクランプを装着する。

5. 市販のサイドレールクランプに、テーブルフレームと接続した支脚を差し込む。

6. 支脚を回転させることでテーブルフレームが水平旋回し、位置を調節できる。適切な位置で市販のサイドレールクランプのネジを締め、支脚を固定する。

7. 固定ネジ、フレームノブの順に締め、テーブルフレームを固定する。

8. 必要に応じてテーブルフレームにフロントサポート、サイドサポート、バックサポートを取り付ける。内穴にサイドサポート、外穴にフロントサポート・バックサポートを取り付ける。

9. テーブルフレームにトレーをのせ、トレーの上に覆布を数枚かけて清潔区域と不潔区域を区別する。

10. 使用後、トレーは速やかに洗浄し、覆布で包んで滅菌を行い、適切に保管する。その他の機器は清拭し、汚れを落としてから適切に保管する。

＜使用例＞

＊【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品は使用前に必ず洗浄を行うこと。トレーは、洗浄後に滅菌を行うこと。トレー以外は滅菌の必要はない。(【保守・点検に係る事項】の項を参照)

2. 各ネジには抜け止め防止の機能がないため、ネジの紛失に気をつけること。

【保管方法及び有効期間等】

ネジ等の部品の紛失に注意し、高温、高湿、直射日光を避けて保管すること。

＊【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄方法

＜トレーの洗浄＞

①使用後は速やかに中性洗剤で洗浄し、付着物を取除くこと。

②苛性ソーダ、ホルマリン、グルタルアルデヒド及びブリーチを含む洗浄剤や、その他のアルカリ性、酸性の洗浄剤は腐食の原因となり、材質の劣化を著しく早めるため使用しないこと。

③金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

④脱イオン水又は脱塩素水で十分すすぎ、乾燥させること。

＜トレー以外の洗浄＞

①使用後は速やかに消毒用エタノール等で清拭し、付着物を取除くこと。

②付着物等を取り除く際、シンナー、ベンジン等の溶剤は腐食の原因となるため、使用しないこと。

③機械による洗浄（ウォッシャーディスインフェクターの類）は行わないこと。

④薬液等が付着した状態で放置しないこと。

⑤金属たわし、磨き粉（クレンザー等）の類は使用しないこと。

2. 滅菌方法

①トレー以外は滅菌の必要はない。

②トレーは使用前に必ず洗浄し、各医療機関により確証された条件にて滅菌を行うこと。
※本品は度重なる洗浄・滅菌及び使用による金属疲労により、破損する場合がある。

滅菌条件の一例

滅菌方法	滅菌温度	保持時間
高圧蒸気滅菌	121℃	15 分
	126℃	10 分
	134℃	3 分

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
欧和通商株式会社：TEL　03（5803）7172

＜製造業者＞
株式会社英技研

＜問い合わせ先＞

欧和通商株式会社　札幌営業所：TEL　011（708）7725
東京営業所：TEL　03（3813）8201
大阪営業所：TEL　06（6304）9305
福岡営業所：TEL　092（526）3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。
ホームページアドレス　http://www.ohwa-tsusho.com