

オサダサージェリーサクセス

(OSS-1・3、OSS-2・3、OSS-3・3)

【警告】

- 1) ロングバーを用いる時は、必ずバーに合うノーズコーンをご使用下さい。バーの長さに合うノーズコーンを使用せずに回転させるとバーが回転中曲がったり破折することがあり、患者や術者に損傷を与える恐れがあります。
- 2) 術者は安全メガネをご使用して下さい。
- 3) 必ずアースを取りご使用して下さい。


【禁忌・禁止】

ペースメーカーをご使用の患者及び術者は、使用しないこと。

【併用禁忌】

- 1) 他の機器と併用する場合は、それぞれ別の電気系回路から電源を取ること。
- 2) 本装置は EMC (電磁両立性) 規格に適合しているが、強い電磁妨害波が存在する環境下では誤動作を起こす可能性がある。強い電磁波を発生する機器 (電気メス等) の周辺で使用する場合はメインスイッチを切ること。
- 3) 可燃性物 (気管内チューブなど)、可燃性気体 (可燃性麻酔剤)、可燃性薬品を使用する際は十分注意すること。また、高濃度酸素環境下では使用しないこと。
(爆発、火災の恐れ)

【形状・構造及び原理等】

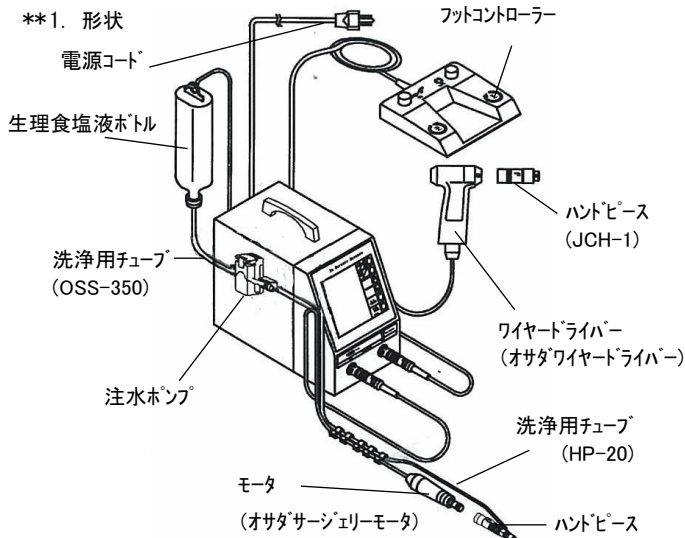

2. 原理・メカニズム

フットコントローラー又は操作パネルによりモーター、注水ポンプを制御する。制御されたモーターによりチャックを備えたハンドピースに接続された刃物が作動する。

3. EMC 規格

JIS T 0601-1-2:2002 に適合している。

【使用目的・効能又は効果】

骨手術に使用する。

	代表術式
形成外科	手足の小骨切除・形成・固定
整形外科	手足の関節切除・形成・固定
口腔外科	顎変形症の顎骨切除・形成・固定
他	骨の切削・切断・研磨・固定

【品目仕様】

- ① 電源
電源電圧 交流 100 V
電源周波数 50/60Hz
電源入力 0.3 A (最大 3.0 A)
- ② 本体
ポンプ ON・OFF 可
ポンプ注水量調節 5-100mL/min
ポンプとモーターとの連動
モーターとワイヤードライバーの切換え
ワイヤードライバーでのオシレイトの切換え
回転速度の設定
・オサダサージェリーモーター 2,000-30,000 min⁻¹
・オサダワイヤードライバー 100-1,900 min⁻¹
・オサダワイヤードライバー 50-750 min⁻¹ (オシレイト)
設定した回転速度が上限
- ③ フットコントローラー
モーター、ワイヤードライバー-回転速度のコントロール
モーター、ワイヤードライバー-回転方向の切換え
(正・逆回転、オシレイト)
正回転と逆回転は専用のペダル
モーターとワイヤードライバーの出力切換え
- ④ オサダサージェリーモーター
回転速度 2,000-30,000 min⁻¹
停止トルク 5Ncm
ハンドピース接続 ISO カップリングのハンドピース
等速スレートハンドピース
回転速度 2,000-30,000 min⁻¹
- ⑤ オサダワイヤードライバー
回転速度 100-1,900 min⁻¹
オシレイト (反転) 50-750 min⁻¹
停止トルク 50Ncm
- ⑦ ジャコブスチャックハンドピースφ5 (JCH-1)
刃物柄の径φ5mm まで

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件

下記条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	10-40 °C
相対湿度	30-75 %
気圧	700-1,060 hPa

2. 設置方法

機器の据付は、取扱説明書を参照すること。

**3. 操作方法

機器の詳細な操作方法及び使用方法は、使用前に必ず取扱説明書を参照すること。

1) 使用前の準備

※機器表面に防錆材を塗布していないため、初回洗浄は不要。

- ① フットコントローラーの接続
- ② モーターと本体の接続
- ③ モーターとハンドピースの接続
- ④ 洗浄用チューブと生理食塩水ボトル・ポンプ及び洗浄用チューブとハンドピースの取り付け

2) 操作

- ① 電源コードの接続
- ② モード選択
- ③ メインスイッチの ON
- ④ 使用するハンドピース、回転速度、注水量の設定
- ⑤ フットコントローラーの操作

取扱説明書を必ずご参照下さい

3) 使用後の処理

- ① メインスイッチの OFF
- ② 清掃・保守

**【使用上の注意】

1. 本体質量が約 7.4kg です。この重さに耐えるキャビネット、ワゴンに載せて下さい。
2. 生理食塩液ボトルをセットしますので平らな面（傾き 3° 以内）に載せて下さい。
3. 他の機器と併用して使用する場合、電磁波障害に注意して下さい。
4. 可燃性ガスの雰囲気中には設置しないで下さい。
5. フットコントローラーは液体が留っている床面には置かないで下さい。
6. 使用前には必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認して下さい。
7. モータ、ワイヤードライバーの両方がセットされている時は、どちらが作動するのか必ず確認した後、作動させて下さい。
8. 使用されるバー、ドリル類は各メーカー指定の回転速度以下でご使用下さい。
9. 1 回に使用する時間は下記の目安に基づいてお使い下さい。使用時間をオーバーするとオサダサージェリーモータ（含むオサダワイヤードライバー）ハンドピースの過熱を招き、事故発生の恐れがあります。

使用時間の目安

		使用時間	使用回数	中断時間
オサダサージェリーモータ・ハンドピース	正回転/逆回転	連続 20 秒 休止 20 秒	10 回	20 分
オサダワイヤードライバー・ハンドピース	正回転/逆回転	20 秒 20 秒	10 回	20 分
	オシレイト	20 秒 20 秒	10 回	20 分

10. モータのインスツルメントは使用後すぐにハンドピーススプレーで注油（洗浄）して下さい（インスツルメント内部に入った血液や薬液の除去・ベアリング保護のため）
11. モータには注油（ハンドピーススプレーにて）しないで下さい。
12. ワイヤードライバーとワイヤードライバー用インスツルメントは注油（ハンドピーススプレーにて）しないで下さい。
13. ロングバーを用いる時は、必ずバーに合うノーズコーンをご使用下さい。バーの長さに合うノーズコーンを使用せずに回転させるとバーが回転中曲がったり破折することがあり、破片が高速で飛散し、患者や手術スタッフに損傷を与える恐れがあります。又、術者は安全メガネの着用をおすすめします。

ノーズコーンについて

ノーズコーン S (SP) : 刃物全長 40—45mm, シャンク長 32mm 以上
 ノーズコーン M (MP) : 刃物全長 55—60mm, シャンク長 49mm 以上
 ノーズコーン L (LP) : 刃物全長 65—75mm, シャンク長 58mm 以上
 ※ ノーズコーン S (SP)、M (MP)、L (LP) の刃物全長を越えるものはご使用になれません。

刃物について

必ずバーメーカーの指定する回転速度以下でご使用下さい。
 使用するバーはシャンク径φ 2.35_{-0.016}⁰mm の範囲のものをお使い下さい。

14. ノーズコーンの発熱が大きい場合は、使用を中止し、修理を依頼して下さい。ノーズコーンベアリングの劣化と考えられ、そのまま使用するとベアリングが分解して先端からでてくることがあります。ベアリングは消耗しますので手術に際してはノーズコーンの予備を準備されることをおすすめします。

15. 本体にサージェリーモータ、ワイヤードライバーを接続してからフットコントローラーを踏んで下さい。どちらも接続されていない状態で、フットコントローラーを踏むと安全装置が作動します。その状態でモータ等を接続し、フットコントローラーを踏んでもモータ等は動きません。モータ等を動かすには、メインスイッチを入れ直し安全装置を解除して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管場所の環境条件

下記条件にて貯蔵・保管すること。（但し、結露しないこと）

周囲温度	-10—60 °C
相対湿度	10—90 %
気圧	700—1,060 hPa

直射日光に長時間さらさないこと

2. 耐用期間

製造の日から、正規の使用法、保守点検を行った場合に限り 7 年間。（自己認証による）

【取扱上の注意】

1. 熟練した者以外は機器を使用しないこと。

2. 機器を設置するときには、次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に設置すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- (5) 電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注意すること。
- (6) アースを正しく接続すること。

*【保守・点検に係わる事項】

機器の保守・清掃・滅菌方法は、取扱説明書を参照すること。

1. 清掃・消毒・滅菌

○：適用可 ×：適用不可

	清掃	消毒	滅菌		
	中性洗剤 水拭き	アルコール 清拭	E0G 滅菌	高圧蒸気	135℃ 以下 乾燥工程
装置本体	○	○	×	×	—
操作パネル	○	○	×	×	—
フットコントローラー	○	○	×	×	—
モータ	○	○	○	○	○
モータコード	○	○	○	○	○
電源コード	○	○	×	×	—
カバー	○	○	×	×	—
ハンドピース スタンド	○	○	○	○	○
ハンドピース	○	○	○	○	○

・口腔内に接触する部分については患者ごとに滅菌すること。

・上記方法以外での清掃・消毒・滅菌はできない。

※清掃・消毒・洗浄・滅菌については、

取扱説明書 10 使用 (10.4 使用後の処置)

11 清掃・消毒・滅菌を参照すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい

2. 保守・点検

使用者による保守点検事項

頻度	内容(概略)
使用前	設置の状態確認
	メインスイッチのオン・オフ確認
	回転速度の調節及び確認
	回転中の異音、振動確認
	ハンドピースの保守
終業後	メインスイッチのオフ確認
	電源コードの確認

※詳細については、取扱説明書「保守点検チェックリスト」を参照すること。

【包装】

包装単位：1 個口

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：長田電機工業株式会社
住所：〒459-8001
愛知県名古屋市緑区大高町字中道 11
TEL：052-621-3126
FAX：052-621-8310
ホームページ：<http://www.osada-electric.co.jp>

製造元：長田電機工業株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい