

ダブルペダルフットスイッチ WA91301W

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

1.構成

本製品は以下のものより構成される。

- ・ダブルペダルフットスイッチ WA91301W

2.各部の名称

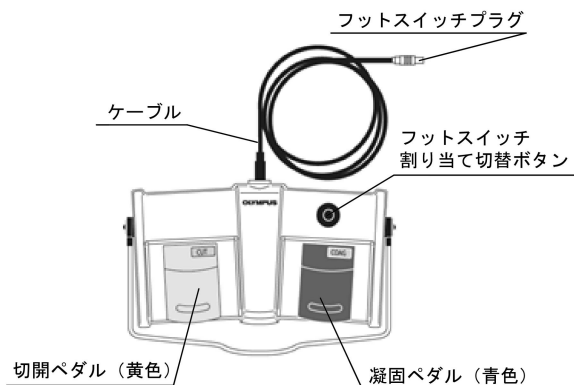

3.仕様

項目	仕様
寸法（ケーブル部は除く）	幅 391×高さ 49×奥行 198mm
ケーブル長	4000mm

作動・動作原理

切開ペダルまたは凝固ペダルを踏むと、本製品が接続された高周波手術装置が出力する。ペダルをはなすと、高周波手術装置の出力が停止する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社指定の高周波手術装置に接続し、出力を制御する信号を伝達することを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

1.準備

フットスイッチプラグを高周波手術装置に接続する。

2.使用前点検

本製品の『取扱説明書』に従って点検を行う。

3.処置

術内容に応じて本製品のペダルを踏んで、出力を行う。

必要に応じてフットスイッチ割り当て切替ボタンにて、高周波手術装置の出力ソケットのフットスイッチの割り当てを切り替える。

4.処置後の操作

高周波手術装置の電源スイッチを OFF にして、本製品を高周波手術装置から取りはずす。

5.手入れ

本製品の『取扱説明書』に従って適切な方法で手入れを行う。

詳細は、本製品の『取扱説明書』を参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は、以下の機器または同等品と接続して用いる。

販売名	医療機器承認番号
高周波手術装置 ESG-410	30400BZX00264000

使用方法等に関連する使用上の注意

- 1.不適切にフットスイッチの切開／凝固ペダルを押すと、出血、穿孔およびやけどを患者にもたらしおそれがある。

(1)正しいペダルを必ず押すこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1.使用方法

処置中にフットスイッチに予期せぬ不具合が起きた場合、治療、例えば止血が中断されるおそれがある。

(1)フットスイッチが、確実に高周波手術装置に接続されていることを確認すること。

2.手入れと保管

フットスイッチプラグは防水構造ではない。プラグへ入り込んだ何らかの液体、例えば水などがフットスイッチに損傷を与えることがある。

- ・フットスイッチプラグがぬれないように注意すること。
- ・フットスイッチプラグは液体に浸さないこと。

詳細は、本製品の『取扱説明書』を参照すること。

不具合

その他の不具合

機器の破損、作動不良

有害事象

その他の有害事象

出血、穿孔、やけど、熱傷、感電、治療の中断

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

高温、高湿、水の掛かるところを避け、直射日光、紫外線を浴びない場所に保管する。

詳細は、本製品の『取扱説明書』を参照すること。

耐用期間

本製品は消耗品（修理不可能）である。本添付文書や本製品の『取扱説明書』、同時に使用する製品の『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、点検結果により必要であれば新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 1.使用前は、本製品の『取扱説明書』に従い点検し、異常が確認された場合は使用しないこと。
- 2.使用後は、本製品の『取扱説明書』に従い、手入れおよび保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

シュトイテ社
Steute Technologies GmbH AND Co. KG
国名：ドイツ連邦共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。