**2019 年 07 月（第 10 版）
*2017 年 09 月（第 9 版）
製造販売届出番号： 13B1X00119003200
機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器　　コルポスコープ　　JMDN ： 10960000

特定保守管理医療機器

コルポスコープ OPMI pico

【警告】

- 使用前に毎回以下の項目を確認すること
  - 本装置の機械的な接続が適切になされていて、各部取り付けネジが確実に締められており、各部に緩みなどがないこと。[部品落下、接続不良のおそれ]
  - 本装置のバランス調整が最適になされていること。[誤動作、機器の故障のおそれ]
  - 光源装置内に、2 つの電球が格納されており、いずれの電球も正しく点灯すること。[手術延長、遅延、中止のおそれ]
  - 電源コードは医用施設の接地された医用コンセントに直接接続すること。[電気の不具合、感電（電気ショック）、発火（発煙）、機器の故障のおそれ]
  - キセノンランプは構造上破裂の恐れがあり、使用時間によってその確率が高くなるため、点灯時間 500 時間を超過したキセノンランプは使用せず、速やかに予備のランプと交換すること。
- 使用中は以下の項目に気をつけること
  - 光源を直接見たり、対物レンズを覗きこんだりしないこと。[眼機能障害や眼、後眼部、網膜疾患のおそれ]
  - 手術部位に対する照明の明るさと照射時間は最小限に抑えること。どのような種類の放射も、生体組織には悪い影響を及ぼす可能性がある。[組織障害のおそれ]
  - 手術用顕微鏡の観察視野範囲以上にわたり、手術部位及びその周辺組織へ照明がされている場合には、手術部位及びその周辺組織の変異に注意すること。組織乾燥や熱傷が発生するおそれがある。[組織障害のおそれ]
  - 特に次の場合に注意を必要とする。
    - 鏡基対物レンズの焦点距離（作業距離）が短い状態で、手術部位及びその周辺組織へ長時間照明をする場合。
    - 照明の明るさを高く設定している場合。
    - 血流の少ない組織へ照明をする場合。

  冷却対応例：
    - 手術対象部位へは、生理食塩水を頻繁にかけること。冷却対応により、照明光による熱作用を軽減させることができる。
    - 手術対象部位以外は、滅菌済み濡れガーゼ等で覆うこと。これにより、照明にさらされることが避けられる。
    - 光源装置の換気口を塞がないこと。火災を起こすおそれがある。
- 使用後は以下の項目に気をつけること
  - 移動時には当社指定の位置にアームを移動し、ロック機構で固定してから移動すること。本装置の破損や他の機器への破損を起こす可能性がある。[部品破損、機器の故障のおそれ]

【禁忌・禁止】

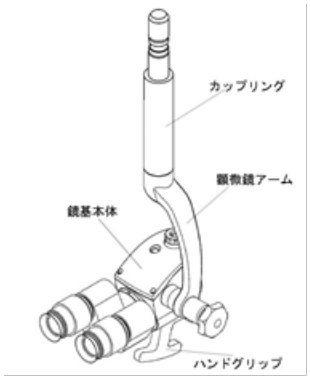

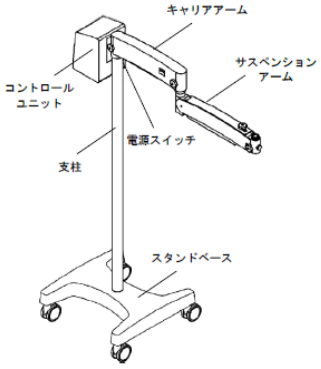
- 以下の場所では使用しないこと。
  - 爆発の危険のあるところ。
  - 引火性の麻酔薬、アルコール、ベンジン、又は類似薬品等、揮発性又は引火性の溶剤のあるところ。
  - 湿気のあるところ。
- 当社が提供する付属品、オプション品以外は使用しないこと。他社のアクセサリは、安全上及び性能上問題がないことを製造元へ確認すること。
- キセノンランプは高輝度で、昼色光に近似したスペクトラムであるため、眼科手術あるいは直接眼に照明を行う手術には絶対に使用しないこと。
- 点灯時間が 500 時間を超えたキセノンランプは使用しないこと。
- 当社が認めた者以外は修理しないこと。絶対に分解、改造を行わないこと。
- 機器の近くで携帯電話の使用はしないこと。電磁波障害により機器の誤作動の原因となりえる。

- 使用前点検時もしくは使用時に故障と判断した場合には、直ちに使用を中止もしくは停止すること。この場合、適切な処置が完了するまで、本装置を使用しないこと。
- 発煙、火花、異臭又は異音がする場合またはそれ以外の異常を感じた場合には、直ちに電源から電源コードを外すこと。この場合、適切な処置が完了するまで、本装置を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

＜構成＞

本品の形状、構造は以下の通り。

<table>
<tr><td>外観</td><td>顕微鏡基</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>S100 ユニット用</td><td>S100 フロアスタンド</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

構成についての詳細は取扱説明書の【構成】章を参照のこと。

フィルタ：

オプションとして、以下のフィルタを追加することが可能。

フィルタ 1

- 光源用：ブルーフィルタ
- 観察用：オレンジグリーンフィルタ（2 種類）

フィルタ 2

- 光源用：グリーンイエローフィルタ
- 観察用：イエローレッドフィルタ

＜機能＞

機能	仕様
ズーム	5 段階手動ズームで術野を拡大
フォーカス	f=200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm 焦点調整機能付 ： f=200mm, 250mm
照明	ハロゲンランプ、キセノンランプ又は LED による照明

取扱説明書を必ずご参照ください。

＜寸法＞

・S 100 フロアスタンド：650(W)mm x 1425(D)mm x 1730(H)mm
（顕微鏡基部含まず）
・S 100 ユニット用　：250(W)mm x 1770(D)mm x 425(H)mm
（顕微鏡基部含まず）

上記はアームを水平にした場合による。実使用時の必要範囲は取扱説明書を参照のこと。

＜機器の分類＞

- 電撃に対する保護の程度：B 形装着部を持つ機器
- 電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器
- 液体の有害な侵入に対する保護の程度：IP20
- 可燃雰囲気内での使用の安全の程度：
可燃性雰囲気内での使用に適さない機器
- 作動モードによる分類：連続作動機器
- 移動による分類：可搬形機器

＜電気的定格＞

- 電源電圧：交流　100V　50/60Hz
- 最大消費電力　：230VA 及び 250VA（ハロゲンタイプ）
250VA（LED タイプ）
575VA および 350VA（キセノンタイプ）
- EMC 適合規格：IEC60601-1-2 CLASS A 準拠

＜重量＞

- 顕微鏡基部　：1.7kg
（ただし、観察鏡筒、対物レンズ及び接眼レンズは含まず）
- S 100 フロアスタンド　：約 90kg
- S 100 ユニット用　：約 35kg

＜原理＞

顕微鏡懸架装置に設置された光源の照明がライトガイドおよび光学系を経由して術部に送られる。照明された術部は対物レンズ、変倍機構、接眼レンズによって拡大され使用者が観察することができる。顕微鏡の変倍、焦点は手動で切り替える。各種付属品、オプション品は任意に追加することができる。これらは弊社の他の手術顕微鏡にも互換汎用される。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

女性器（膣、子宮頸等）の診察に用いる特殊な顕微鏡

【使用方法等】

1) 電源コードと本体の接続等が確実に成されているかを確認する。
2) 電源プラグを医用コンセントに接続する。
3) 本体電源スイッチを入れる。
4) 診察に最適な照明の明るさに調整する。
5) 左右眼の視度調整と瞳孔間距離の調整を行う。
6) 顕微鏡基本体を観察野へ移動し、最適な作業距離を選択する。
7) 必要に応じて倍率を変更する。
8) 本装置を使用しないときは、光源装置の電源および本体の電源を切り、医用コンセントより電源プラグを抜いておく。

詳細は取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 当社推奨の滅菌された滅菌キャップあるいはマイクロドレープを使用すること。[汚染による最近の発生のおそれ]
- 本装置の操作者は、取扱説明書を読了し、本装置を使用するための訓練を受けた者のみとすること。
- 本装置は医科向けに設計されており、それ以外の用途には使用しないこと。

＜その他の注意＞

- 移動時以外はキャスターに装備されているブレーキストッパーを効かせておくこと。
- ライトガイドは光源及び手術用顕微鏡の接続口に適切に接続すること。[発火（発煙）機器の故障のおそれ]
- ライトガイド、電源コードあるいは他のケーブル接続を引っ張らないこと。[破損、接続不良のおそれ]
- 本装置に設定されている電圧が使用場所での電圧に対応していること。接続される医用コンセントの電気容量は、本装置の可動に十分であること。[電気の不具合のおそれ]
- 必要に応じて、等電位化装置に接続すること。[電気の不具合、感電（電気ショック）、発火（発煙）機器の故障のおそれ]
- 付属の電源コードセットは、本装置専用であるため、他の機器には使用しないこと。
- 機器の突然の故障により、手術の目的の達成や患者の安全が脅かされることがないよう、予備の対応を検討しておくこと。
- 必ず予備のランプを実装しておくこと。(LED 照明は、除く)

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 本装置を保管する前に、下記の条件を満たす事を確認すること。
  - 水の被らない場所。
  - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、水分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所
  - 温度 ： -40℃～+70℃
  - 相対湿度（結露不可）:10%～90%
  - 気圧:500 hPa～1060 hPa
- 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意すること。
- ほこりがかからないようカバーをかけること。
- 本装置を使用しない保管時には、スタンドベースに装備されているブレーキストッパーを効かせておくこと。

＜耐用期間＞

定期的に業者による点検を行った場合：5 年（自己認証）
[保守用等の部品は製造中止後 8 年間保持]

【保守・点検に係る事項】

点検の項目は以下のとおり。使用を妨げないように十分に余裕を持って行うこと。点検中に異常を感じた場合は、取扱説明書の【トラブルシューティング】章を参照して確認すること。それでも解決しない場合は、当社テクニカルサービスに連絡すること。

また、本装置を安全に使用するために、当社による 12 ヶ月毎の点検を推奨する。

＜使用者による保守点検事項＞

- 外装に瑕疵、変形などがないこと。
- 配線等に亀裂、断線がないこと。
- 機械的な接続が適切になされていること。
- 各部取り付けネジが確実に締められていること。
- 各部に緩みなどがないこと。
- 電源を入れて問題なく起動すること。
- 照明が問題なく点灯すること。
- バランスがしっかり取れて入ること。
- 照明の設定が必要最低限になっていること。
- 本装置から異音、異臭がしないこと。
- 実装されている電球以外に予備電球が用意されていること。（LED 照明は、除く）
- 本文書ならびに取扱説明書が本装置の使用者が参照できるところに置いてあること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

＜業者による保守点検事項＞
12ヶ月以内に各部清掃、機能点検、安全点検を行う。

＜外観の手入れ＞
外装に汚れがある場合は、エチルアルコールと蒸留水の5対5の混合液に少量の中性洗剤を含ませたやわらかい物で拭くこと。
クリーニングを行う際は、本体の電源スイッチを切ること。

＜レンズの清掃＞
レンズに汚れがある場合は、クリーニング剤は決して使用せず、ブロアーか清潔で油分のないブラシなどで払うこと。

＜曇り止め＞
レンズを曇りから守るため、市販の曇り止めを使用すること。

詳細は取扱説明書の【保守・点検について】章を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：　カールツァイスメディテック株式会社
**電話　0570-021311
輸入先国：ドイツ
製造業者：Carl Zeiss Meditec AG

取扱説明書を必ずご参照ください。