*2017 年 11 月 改訂（第 2 版）　（新記載要領に基づく改訂）
2007 年 4 月 作成

器具器械 2 医療用照明器　　医療機器届出番号 ： 13B1X00268000029

一般医療機器　汎用光源　JMDN : 32037000

CUDA 光源装置 XLS-300W

【警告】
・本体に損傷がある場合には使用しないこと。また、定期的に目視で点検すること。

【禁忌・禁止】
・いかなる液体からも遠ざけること。
・故障・損傷の際は使用しないこと。定期的に内外部を見て点検すること。
・装置を落下させるなどして故障した場合には勝手に分解せずに、すみやかに修理を依頼すること。
・ヒトの眼に直接照射しないこと。また光を凝視しないこと。
・可燃性ガスが充満している状況に放置しないこと。

【形状・構造及び原理等】
本機器は手術時に術者手元の影部分の照明に使用するファイバーケーブル照明用光源装置である。

1. 外観図

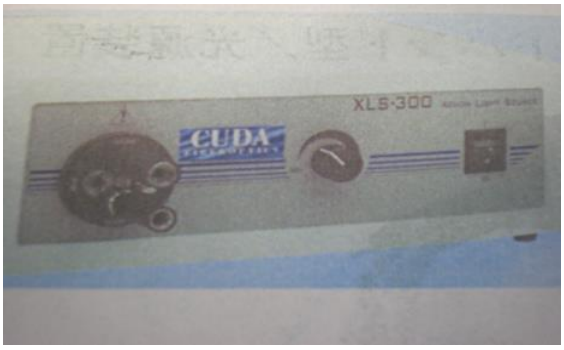

2. 構造
額帯灯の各メーカーに対応する差込口（ポート）を備えている。
光源本体　1、電源コード　1

3. 寸法及び重量
(1) 寸法　(H) 13cm×(W)35.5cm×　(D) 25cm
(2) 重量　6.0kg

4. 品目仕様等
(1) ３００Wキセノンランプ使用　照度調整機構付き
(2) ４ポート(ACMI、Wolf、Storz, Olympus)
(3) ランプ色温度　約６０００ｋ
(4) ランプ寿命　約６５０時間
(5) 許容入力電圧範囲　１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ
(6) 消費電力　４５０W
(7) 使用温度/湿度　１０～４０℃/３０～８０％（結露なき事）

【使用目的又は効果】
本機器は手術時に術者が使用するファイバーケーブル照明の光源に使用する。

【使用方法等】
取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】
1. 光源点灯時はファイバーケーブルの取付孔やファイバー先端を直接見ないこと。
2. 光源点灯時は装置の空気流入孔を塞ぐなど、ファン作動中の空冷を妨害することのない様に充分注意すること。
3. ランプ劣化の進行を予防する目的で、使用後は照度調整ノブを Min
＊ 位置に戻し、必ず５分以上ランプを冷却してから装置電源を切ること。

【取扱い上の注意】
本体に損傷がある場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
特別な保管方法はなし。

【保守・点検に係る事項】
定期的に目視で点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
1. 製造販売業者 ：
株式会社 キーラー・アンド・ワイナー
TEL ： 03-3815-7787
2. 製造業者 ：
Sunoptic Technologies
(サンオプティック テクノロジース社 ：アメリカ合衆国)

取扱説明書を必ずご参照下さい。