

## 器 58 整形用機械器具

一般医療機器

骨手術用器械

70962001

## 骨接合プレート用手術器械 (Z00140-006)

## 【禁忌・禁止】

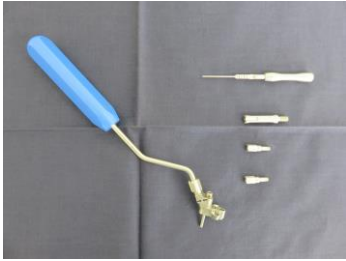
- ・骨手術手技以外の手術に使用しないこと。
- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと。[相互作用の項参照]
- ・本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

## 【形状・構造及び原理等】

## (1)形状及び構造

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示または本体に記載されているので確認すること。

製品外観

| No.                                                                                | 製品名            | カタログ番号                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                  | DVR CL CS デバイス | SV-AT18-039-00                          |
| 製品外観                                                                               |                | 材質                                      |
|  |                | 金属製品<br>：ステンレス鋼<br><br>樹脂製品<br>：ポリアセタール |

## (2)原理

本品は、骨接合プレートを用いる骨接合術において使用する器械である。

本器械を用いて、骨接合プレートの設置を行うものである。

## 【使用目的又は効果】

本器械は再使用可能な手術器械であり、骨接合プレートを用いる骨接合術に用いる。

## 【使用方法等】

## (1)使用方法

- ① 骨接合プレートに組付用スクリューを用いて装着し、プレート設置操作を行う。スタンダードとナローの 5～11 穴プレートに装着する場合は、組付用スクリューを本体の尺側のホールに入れて組付ける。ワイドと 4 穴ミニプレートに装着する場合は桡側のホールを利用する。
- ② エクストラナロープレートには組付けられない。
- ③ チルト調節ネジを用いて Volar Tilt の調節を行う。目盛は橈骨との角度の目安であり、最終的な調整は透視下または直視下で確認すること。
- ④ ガイド超しにデプスゲージを用いて、スクリュー長決定の為の測深を行う。

## (2)使用方法に関連する使用上の注意

- ① 変形等の異常が発生した場合は直ちに使用を中止すること。
- ② 本品は未滅菌品のため、使用前に滅菌すること。
- ③ 本品は医療機関内において 10<sup>-6</sup> 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。滅菌方法として高圧蒸気滅菌を行う。参考として以下に一般的な滅菌法及び材質ごとの諸注意事項を列挙する。

## 参考資料

## ①滅菌方法

## ・高圧蒸気法

- ・適当な温度及び圧力の飽和水蒸気中で加熱することによって、微

生物を殺菌する方法をいう。本法は、主としてガラス製、磁製、金属製、ゴム製、プラスチック製、紙製もしくは繊維製の物品、水、培地、試薬・試液又は液状の試料などで熱に安定なものに用いる。通例、高圧蒸気法の場合は、次の条件で滅菌を行う。

| 温度   | 時間    |
|------|-------|
| 121℃ | 20 分間 |

- ・上記条件は滅菌後の製品の無菌性を保証するものではない。滅菌後の製品の無菌性の保証については各医療機関の責任の下、行うこと。
- ・条件、方法については滅菌器製造業者の取扱説明書の指示に従うこと。

②材料特性 (AAMI<sup>1)</sup>、AORN<sup>2)</sup>)

以下の材質の材料は AORN に準じて高圧蒸気滅菌が可能である。

- ・ステンレス鋼
- ・アルミニウム (同じくアルマイト及びテフロン処理されたものを含む)
- ・コバルトクロム合金
- ・チタンとチタン合金
- ・ポリアセタール
- ・ポリアセタール共重合体
- ・ポリアセタール共重合体ポリスルホン
- ・ポリエーテルイミド
- ・サルフォン系樹脂
- ・ポリエーテルエーテルケトン
- ・ニチノール
- ・ベークライト
- ・シリコーン
- ・アルミニウム及びアルマイト処理のアルミニウム製品は、酸性超音波洗浄剤にさらさないこと。
- ・滅菌ケース内部が滅菌サイクル後に湿っている場合、次の処理は行わないこと。
  - a. 滅菌直後にケースを開ける。
  - b. 滅菌の有効性に悪影響を与えないことを証明せずに乾燥時間を増やすこと。
  - c. これまで以上の排水のため、ケースに新たな穴を開ける。
- ・最初の滅菌処理の間、ポリアセタール又はポリアセタール共重合体製材料表面から、ある程度のホルムアルデヒドが蒸発し、これが顕著になる場合がある。しかし数回の滅菌処理により臭気は低減する。
- ・ポリアセタール又はポリアセタール共重合体などのポリホルムアルデヒド樹脂は、反復蒸気滅菌にさらす場合、寿命が多少短くなる。ポリアセタール製材料は、約 50 サイクルのオートクレーブに耐性があることが知られている。このような材料の表面が灰白色になれば、使用せずに交換すること。
- ・水溶性の器具用潤滑剤と蒸気ボイラー処理に用いる特定の化学薬剤による汚染は、サルフォン系樹脂材料のクレージング、さらに亀裂につながるがあるので注意すること。
- ・滅菌中、特にサルフォン系樹脂とポリエーテルイミドのプラスチック製材料は、上に重いトリアルを積み重ねて重量を加えないこと。これにより変形が発生し、材料の内部応力により最終的に材料の亀裂を引き起こすと考えられる。
- ・ポリエーテルエーテルケトンは、反復蒸気滅菌 (曝露条件：温度 200℃ 圧力 1.4Mpa) で強度低下することはないことが保証されている。

## 【使用上の注意】

## (1)重要な基本的注意

- ・併用するインプラントや器械の添付文書を必ず読んでから使用

- ・ すること。
- ・ 本製品の使用に際し、手術手技を十分に理解すること。
- ・ 本品を長期間支障なく使用するには、取扱、事前水洗、洗浄、水洗、滅菌による汚染除去、保管及び使用を適切に行うことが重要である。
- ・ 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷する危険性があり、又器械の表面を損傷する恐れがあるので、本品とともに電気メスを使用しないこと。
- ・ 術後感染症が生じることがある。術前、術中及び術後にわたり感染症の予防処置を十分に行うこと。なお、感染症が発症した場合は、適切な処置を施すこと。

## (2)相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

- ・ 併用禁忌(使用しないこと)
- ・ 弊社が指定した製品以外との併用はしないこと。[専用品でない  
と設計・開発方針が異なるため、適合しない恐れがある]。

## (3)不具合・有害事象

- ・ 重大な不具合  
過度な力を加えて整復した場合、スクリューのバックアウト、  
腱断裂、神経障害、血管損傷を引き起こす恐れがある。

## (4)その他の不具合・有害事象

- ・ 本品使用時の不具合・有害事象として、組織、靱帯、腱、神経、  
血管、骨等の損傷及び感染症が考えられる。
- ・ 手術による外科的侵襲などによっても次の不具合・有害事象の発  
生が考えられる。
  - ・ 本品の破損、折損、磨耗。
  - ・ 金属アレルギー。
  - ・ 周囲の神経障害。
  - ・ 感染症。
  - ・ 血管系の合併症。

## (5)高齢者への適用

高齢者は、骨が粗鬆症化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後、緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・ 貯蔵・保管方法  
常温・常湿にて保管すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- ・ 使用する前に、必ず全ての器械を点検すること。
- ・ 本品に傷・割れ・有害なまくれ・さび・ひび割れなどの損傷、摩  
滅が無いことを外観検査によって確認すること。
- ・ 刃部の切れ味が落ちた場合使用しないこと。
- ・ 従来からある外科用器械を再研磨する専門の研磨サービスがあ  
るが、性能や寸法（切削の深さや直径）が製造業者の所定の許容  
限度から外れる恐れがあるので、外注業者には研磨等を依頼しな  
いこと。
- ・ 器械は特定の時点で摩滅し、交換が必要になるので注意すること。
- ・ 分解できる器械は必ず分解し、また中空部分をもつ器械はその内  
部まで洗浄すること。中空部分は細いブラシやピンを用いて内部  
の汚れを除去すること。分離される型の器械は使用後分離し、蒸  
留水・洗浄液を用いて十分にブラシ洗いを行い、必要であれば超  
音波洗浄をした後滅菌すること。
- ・ 器械の使用後は付着した組織片の乾燥を防ぐため、使用直後は速  
やかにすすぎ洗いを行い、血液、組織片及び生理食塩水を除去す  
ること。使用直後に行えない場合は、洗浄するまで器械を浸漬し  
ておくこと
- ・ 洗浄装置（超音波洗浄機等）を使用する時は、鋭利部同士が接触  
して損傷することがないように十分注意して行うこと。
- ・ 使用後は、分解可能な器械は分解し、損傷が無いか検査すること。
- ・ 超音波洗浄をした後、必要であれば滅菌すること。
- ・ 滅菌方法は、[使用方法に関連する使用上の注意]を参照すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 K S I

電話番号 0550-88-3660

## 【販売業者の氏名又は名称及び住所等】

ジンマー・バイオメット合同会社  
東京都港区芝公園二丁目 11 番 1 号  
電話番号 03-6402-6600（代）