＊ 2017 年 6 月 改訂　第 2 版（新記載要領に基ずく改訂）
2009 年 2 月 作成　第 1 版

医療機器届出番号：13B1X10033000002

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器　歯科用インプラント手術器具　70965001

アルファツール（トルク付ラチェットレンチ）

【警告】

- 本品使用の際は、適切な治療計画を行い、特徴や組み合わせ、使用方法などを正確に把握し、最良の選択を心がけるようお願いするものである。
- 関連製品と組み合わせて使用すること。
- 再使用する場合は、汚れや傷、損傷等の異常がない事を確認の上、機能的に問題がないと判断した場合にのみ使用すること。
- バネは太線を超えて操作しないこと。（太線を超えるような使い方をすると目盛のトルク値と実測に誤差が出る恐れがあるため。）

【禁忌・禁止】

- 本品又は本品に使用される材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状・種類

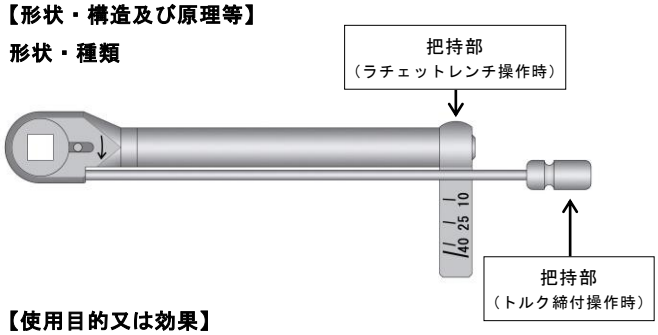

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で再使用可能である。

【使用方法等】

使用方法

アバットメントの締め付けやフィクスチャーの植立に使用する。
トルクの目盛：10Ncm／25 Ncm／40 Ncm／最大値(45Ncm)
※バネは太線（最大値）を超えないようにして下さい。

【25Ncm の場合】



上図の位置にバネがきた時、約 25Ncm です。

【最大値(45Ncm)の場合】



※これ以上バネを曲げないようにして下さい。

使用方法に関連する使用上の注意

- 使用する直前に滅菌を行うこと。
（滅菌法：高圧蒸気滅菌、滅菌条件：121℃ 20 分間）
- 再使用する場合は、医療機器洗浄剤で洗浄し汚れを完全になくすこと。必ず洗浄剤の使用方法に従うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 金属アレルギーによる異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 過度の衝撃を加えないよう注意して取り扱うこと。また水濡れに注意し直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管すること。
- 血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しないこと。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ケンテック株式会社
住所：東京都新宿区早稲田南町 52-2
電話番号：03-5155-2596

添付文書 ATTL_1706-020

販売名：アルファツール
（トルク付ラチェットレンチ）
届出番号：13B1X10033000002
一般医療機器
歯科用インプラント手術器具
製造販売業者：ケンテック株式会社
東京都新宿区早稲田南町 52-2
電話番号：03-5155-2596

注意，添付文書参照　未滅菌

取扱説明書を必ずご参照ください。