機械器具 32　医療用吸引器

一般医療機器　吸引器用キャニスタ（34858000）

ヨックスディスポ用ライナー　O

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。[感染防止のため]
2. 本品を使用する前には必ずヨックスディスポ S711、ヨックスデュアル S503 の取扱説明書と添付文書および本添付文書をよく読み、理解された上で正しく使用すること。[記載事項に従わないと重大な事故に結びつくことがあるため]
3. 本品はヨックスディスポ S711、ヨックスデュアル S503 に使用する専用のライナーである。他には使用しないこと。[正常な機能や安全を保てなくなるため]
4. 本品は、ヨックスディスポ S711、ヨックスデュアル S503 のキャニスタボトルにセットし外科手術や治療などによって生じる血液、痰、生理食塩水などの排液を吸引し、固形化させる排液収集バッグである。[再使用は行わないこと。感染の原因となるため]
5. 本品は樹脂製品である。穴を開けたり、高温にさらしたりしないこと。[排液の飛散、フィルター作動不良によるアウトレットバルブへの吸引などにより感染の原因となるため]
6. 本品内の排液が 1200mL の「FULL LEVEL」になる前に吸引を中止すること。[満杯まで吸引すると、医療ガス配管設備及びアウトレットバルブが排液により汚染されることがあるため]
7. 本品は、ディスポーザブル製品である。[ライナーの再利用は絶対しないこと]
8. 本品をキャニスタにセット後、ネオ・コントローラーのハンドルの「赤ライン」の位置を目盛「10」に合せペイシェントホースの先端で吸引できることを必ず確認してから使用すること。[正常な機能や安全を保てなくなるため]
9. 当社の純正部品以外は使用しないこと。[正常な機能や安全を保てなくなるため]

【形状・構造及び原理】

本品はバッグ及び凝固剤から構成されており、ヨックスディスポ S711（届出番号 10B2X00014C00011）、ヨックスデュアル S503（届出番号 10B2X00014C00004）に使用するライナーである。

1. 形状

・1200mL

寸法：φ130×高さ 230mm

容積：1200±100mL

重量：110±10g

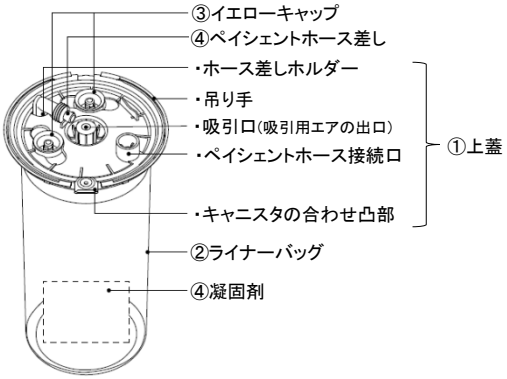

2. 性能

入口吸引圧力　0kPa～−60kPa

3. 原理

真空吸引器（ヨックスディスポ S711、ヨックスデュアル S503）からの吸引圧により、体液等の排液を吸い込み、ライナーに貯留させる。貯留された排液が満杯になると吸引が停止する。また、体液等の排液が凝固剤に触れると排液が凝固される。

【使用目的または効果】

本品は、体液等の排液の回収を目的とし、真空吸引器とともに使用する吸引器用キャニスタである。

【使用方法等】

1. 使用準備

1）ライナーのセット

① ライナーを用意する。

② ホース差しホルダーよりペイシェントホース差しを抜き取る。

③ 本体のキャニスタヘッドを外しキャニスタにライナーを差し込む。

④ ライナーの凸部とキャニスタホルダーの凹部を合せ差し込む。

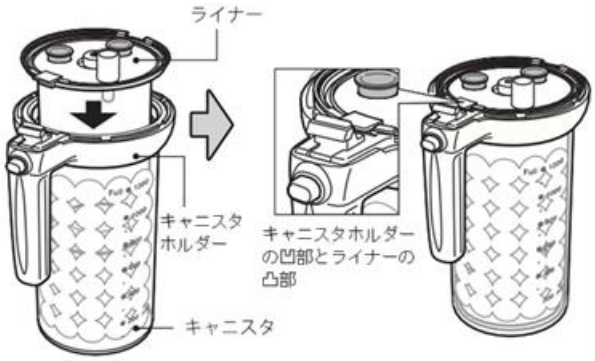

2）キャニスタヘッドとキャニスタのセット

① キャニスタホルダーの突起部をキャニスタヘッドのヒンジ窓に差し込む。

② キャニスタヘッドを「パチン」と音がするまで押し下げる。（セット品をキャニスタセットと言う）

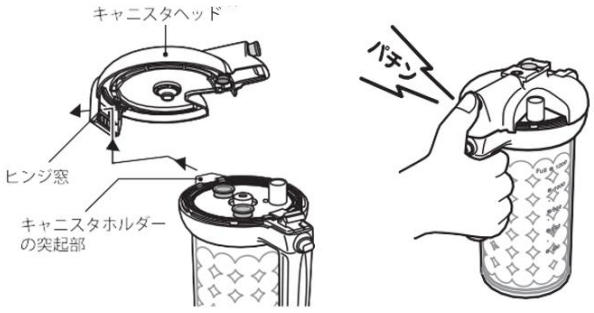

3）ネオ・コントローラーの接続

キャニスタヘッドのガイドとネオ・コントローラーのガイドを合わせ、「カチッ」と音がするまでスライドさせる。

2. 操作方法

1）吸引の準備

① ネオ・コントローラーにキャニスタセットを接続した状態でネオ・コントローラーの背面のハンガーをアウトレットパネルに取り付ける。

② アダプターホースのアダプターを吸引アウトレットに差し込む。

③ ペイシェントホース差しをペイシェントホースに取り付け、ライナーに接続する。

2) 吸引の確認

① ネオ・コントローラーのハンドルを時計方向に回転させ目盛「10」程度に設定する。

② キャニスタ内のライナー内に吸引圧が作用し、ライナーの膨らみが確認できれば吸引は OK である。

③ ライナーがしぼんでしまった場合は、部品を確認し再度セットする。

④ ペイシェントホースの先端を水に入れるかペイシェントホースの先端に親指の腹を当て吸引ができるか確認する。

3) 吸引の開始

① ネオ・コントローラーのハンドルの「赤ライン」を必要とする吸引圧に目盛を合わせる。

② ライナーが膨らむと、吸引を開始できる。ライナーがしぼんでしまった場合は、部品を確認し再度セットする。

4) 吸引の中断及び停止

① 吸引を一時的に中断したいとき、又は短時間使用しないときにはネオ・コントローラーのハンドルを「OFF」にする。

② 使用後は速やかにライナーからペイシェントホースを外し、キャニスタセットのグリップを握り、キャニスタヘッドの「カラーボタン」を押し、ネオ・コントローラーからキャニスタセットを外す。



3. 廃棄方法

1) キャニスタヘッドの取り外し

キャニスタセットを机上に置きキャニスタホルダーのグリップを握り「ホワイトボタン」を押しキャニスタヘッドを外す。

2) ライナーの抜き取り

ライナーの「吸引口」と「ペイシェントホース接続口」を付属のイエローキャップで密閉し、ライナー吊り手を持ってキャニスタ内のライナーを抜き取る。

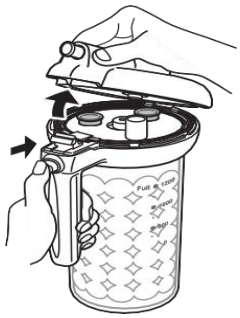

3) 廃棄

ライナーを所定の処理場所に廃棄する。

【使用上の注意】

1. ライナーとキャニスタ及びキャニスタヘッドは確実にセットすること。
2. チューブ類を抜き差しするときに無理な力を掛けないこと。

1) ライナーのセットは机上で行う。

2) ライナーは確実にセットすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

1) ライナーはポリ袋などに収納し、所定の保管場所にて保管すること。

2) 保管場所の条件：高温、ほこり、水、湿気等がない場所であること。温度、ほこり、湿度、風通し、塩分、いおう分等を含んだ空気等により、悪影響の生じるおそれのない場所であること。化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと。

2. 使用期限

本品は上記の保管方法に於いて使用期限：3 年

【取扱い上の注意】

1. ライナーを転倒及び落下等の衝撃を加えないこと。
2. 包装を開梱する際は、カッターなど鋭利なものは使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

ライナーは使用前に必ず下記のことを目視で確認する。

1. ライナーに亀裂、損傷及び変色、劣化、落下等による変形等がないか。
2. ライナー内にセット部品が外れておちていないか。
3. ライナー内に凝固剤等の部品がセットされているか。
4. ペイシェントホース差しが付属されているか。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　：株式会社小池メディカル
電　　話　：03-5662-6605（代）