[LN-10]

2016年10月作成（第1版）

届出番号：13B1X00074000036

機械器具（58）整形用機械器具

一般医療機器　非能動型簡易型牽引装置　35519001

特定保守管理医療機器　**リネット牽引装置（タイプM）**

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 本装置の最大許容重量を超える荷重をかけないでください。［本装置が故障する可能性があります。］
2. ベッドに患者さんが寝ている場合は、本装置の組み立てを行わないでください。［患者さんが傷害を受ける可能性があります。］
3. 電動ベッド上に取り付けられた本装置のクリーニング、及びメンテナンスを行う場合は、ベッドの電源プラグを電源コンセントから外してください。［感電の危険性があります。］
4. 洗浄機械類で本装置を洗浄しないでください。［本装置が故障する可能性があります。］

【形状・構造及び原理等】

＜構造・構成ユニット＞

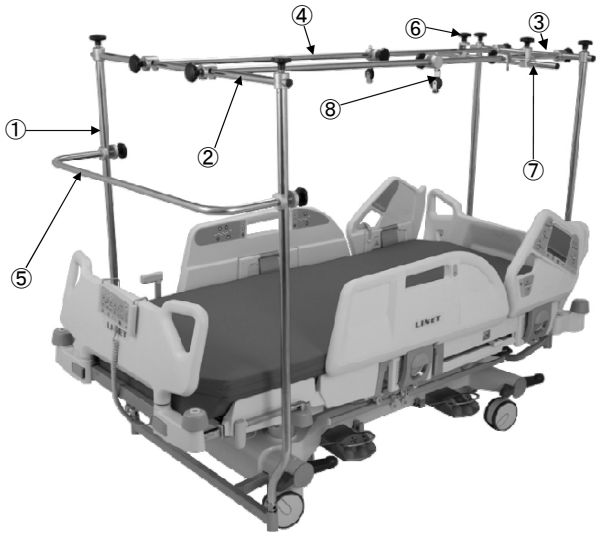

※電動ベッドは本装置には含まれません。

①	縦型チューブ	⑤	C型チューブ
②	横断チューブ長	⑥	留め具
③	横断チューブ短	⑦	輸液ホルダー
④	縦断チューブ	⑧	滑車

＜作動・動作原理＞

滑車等を経由して、適切な錘を付けたワイヤ等で身体の対象部位（肢節、背骨、骨盤等）を牽引し、必要な方向に整復、固定します。

＜機能＞

1. 最大許容重量：75kg

＜動作環境＞

1. 温度　：　10～40℃
2. 湿度　：　80%以下

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本装置は、治療時に変動なし（静止）で牽引力を作用させる非能動型牽引装置です。

【使用方法等】

＜組立方法＞

1. 本装置を組み立てる際は、2名以上で行うことをお勧めいたします。
2. 本装置を組み立てる際は、必ず取扱説明書に従い適正に行ってください。

＜使用方法＞

1. 対応するベッドに、本装置を設置する。
2. 滑車を経由して、適切な錘をつけたワイヤなどで身体の対象部位を牽引し、固定する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 本装置の構成品、アクセサリ等がベッドからはみ出さないようにしてください。但し、錘は患者さんに接触しないように、本装置の外側に吊るしてください。
2. 本装置を取り付けた電動ベッドを横転（ラテラルチルト）させたり、マルチケアALTのALT機能を使用したりしないでください。
3. 本装置を取り付けた電動ベッドのベッドフレームを延長しないでください。
4. 電動ベッドの機能は、本製品を設置しても全て機能します。使用すべきでない機能は、誤使用されないようにロックするようにしてください。
5. 本装置を取り付けた電動ベッドで、牽引中の患者さんを搬送しないでください。どうしても搬送が必要な場合は、錘を揺動させないでください。
6. 本装置を取り付けた電動ベッドを移動させる場合には、ベッドの高さを最低位まで下げてください。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

1. 本装置は、マルチケアALT、マルチケアLE（販売名：医療用電動ベッド、届出番号：13B1X00074000039）と併用して使用します。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本装置は、リハビリ用ではありません。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

1. 温度　：　-40～+70℃
2. 湿度　：　90%以下

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 本装置のメンテナンスは6ヶ月毎に行ってください。特に可動部や、ジョイント部等に注意してください。詳細については、取扱説明書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

［製造販売業者］

株式会社TKB

電話番号：03-5762-3077

［外国製造業者］

リネット社

（Linet spol sro）

チェコ共和国

2305-2

販売元　TOKIBO CO., LTD. 株式会社 東機貿

2305-1-0-MKT

取扱説明書を必ずご参照ください。