＊2021 年 05 月（第２版）（新記載要領に基づく改訂）
2010 年 06 月（第１版）　　製造販売届出番号　27B3X00066000011

器０９　医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器　汎用Ｘ線診断装置用電動式患者台　JMDN 40655000

特定保守管理医療機器／設置管理医療機器

電動式人体上下架台　ＳＣ－Ｈ１Ａ

【形状・構造及び原理等】＊

１．形状＊

本装置は以下のユニットにより構成される。

（１）　昇降架台
（２）　ステップ部
（３）　リモートスイッチ

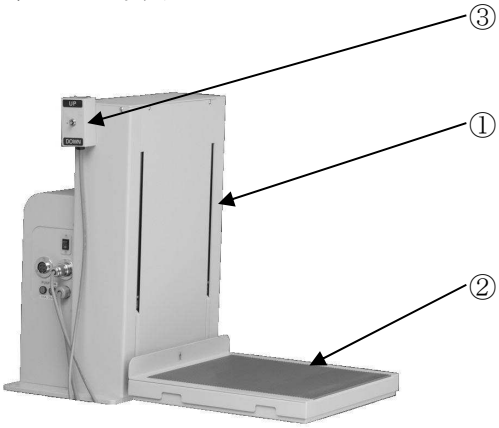

２．動作原理＊

本装置は電動駆動にてステップ部を上下動させる電子制御機構を備えた電動式患者台です。患者の撮影位置合せのために電動の昇降モーターが作動し、チェーン駆動の昇降フレームに取付けられたステップ部が上下動します。

【使用目的又は効果】＊

１．概要
本装置は電動駆動にてステップ部を上下動させる電動式患者台です。

２．電気定格
定格電圧　：AC100Ｖ±10%
周波数　　：50-60Hz
保護の形式：クラスⅠ
保護の程度：B 形

３．本体寸法及び重量
寸法（mm）：400(W)×720(D)×815.5(H)
重量　　：約 65kg

詳細は取扱説明書を参照してください。

【使用方法等】＊

使用環境条件
温度　　１５～３０℃
湿度　　４０～８０%ＲＨ（結露なきこと）

設置上の注意
１．水等のかからない場所に設置してください。
２．気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に設置してください。
３．傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意して設置してください。
４．可燃性および爆発性の気体が発生する場所に設置しないでください。

操作方法
１．本体のメインスイッチをＯＮにしてください。
２．ステップ部を最下点にしておきます。
３．ステップ中央部に被検者を立たせます。
４．リモートスイッチのレバーをＵＰ側へ押して、ステップを上昇させてポジショニングをします。
５．撮影が終わりましたら、リモートスイッチのレバーをＤＯＷＮ側へ押して再び最下点までステップを下げます。
６．被検者を下ろして終了です。

装置の詳細な操作方法は、取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞＊
①撮影を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認すること。
②ステップ部を動かすときには、本体の下に足や物が存在しないことを確認すること。
③本装置の傍で携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置に障害を及ぼす恐れがあるので使用しないこと。
④全てのコード類の接続が確実に、正確にされていることを確認すること。
⑤装置に不具合が発生した場合は、電源を切り「故障中」等の適切な表示を行い、弊社の指定するサービス業者に連絡すること。
⑥この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
⑦この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

詳細は取扱説明書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】＊

＜耐用期間＞＊＊
６年　［自己認証（当社データ）による］
（但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある）

【保守・点検に係る事項】＊

１．医用機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
２．使用者による日常および定期点検、指定された業者による定期保守点検を必ず行ってください。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

３．使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容（概要）
駆動部	日常	装置をひととおり動作させ、異常音や異常な振動が無いか確認してください。
ステップ部上下動	日常	昇降スイッチを操作して、ステップ部を上下方向に動かし、異常音が無いか確認してください。
外観	日常	外装の破損（へこみ、破れ等）が無いか ケーブル類に傷やよじれが無いか

４．業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
上限下限スイッチの確認	１年	上下動させてﾏｲｸﾛｽｲｯﾁの動作を確認
安全スイッチの確認	１年	上限から下降させてﾏｲｸﾛｽｲｯﾁの動作を確認
ケーブル類の点検	１年	傷やよじれの確認
各部重要固定部	１年	固定ねじの増し締め

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：　株式会社　三協
電　　話：　06－6309－5261

〔販売業者（販売店）〕

取扱説明書を必ずご参照下さい。