＊＊2026 年 2 月（第 3 版）
＊2018 年 10 月（第 2 版）

認証番号：230AGBZX00012000

歯科材料 04　歯科用根管充填材料
管理医療機器　　歯科用根管充填固状材料　　70873000

# プロテーパー・ネクスト ガッタパーチャＣＦ

**再使用禁止**

**【禁忌・禁止】**
1. 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

形状：本品は、プロテーパー・ネクスト（電動式歯科用ファイル）で拡大形成された根管に用いる、コーン状のガッタパーチャである。

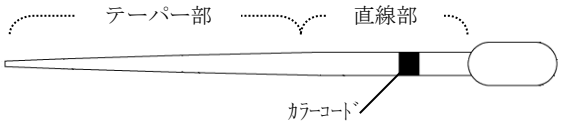


種類：４種類

| 種類 | 先端直径 (mm) | 直線部の直径 (mm) | ｶﾗｰｺｰﾄﾞ |
|---|---|---|---|
| X2 | 0.23 | 1.13 | 赤 |
| X3 | 0.28 | 1.18 | 青 |
| X4 | 0.38 | 1.19 | 黒 |
| X5 | 0.48 | 1.17 | 黄 |

（全長：28mm、テーパー部：先端~16mm）

材質： 酸化亜鉛、ガッタパーチャ、他

**【使用目的又は効果】**

歯の根管の充填に用いる。

**【使用方法等】**
1. 電動式歯科用ファイル「プロテーパー・ネクスト」（医療機器認証番号：225AKBZX00158000）を用いて根管拡大形成を行います。
2. 最終拡大形成に使用したプロテーパー・ネクストの種類に対応する本品を選択し、根尖から 1 ~ 2mm 程度離して本品の適合を確認します。
3. 根管内を洗浄、乾燥させた後、本品に少量の歯科用根管充填シーラを塗布します。
4. 本品を根管内に挿入し、ヒートキャリアを用いて歯冠部側の余剰分を切断します。
5. ヒートキャリアで根管内の本品を加熱し、プラガーを用いて本品を加圧します。その際、ヒートキャリアを引き出して本品の上部を切断します。
6. 大・小サイズのヒートキャリア及びプラガーを用いて 5.のステップを繰り返し、根尖部 3 ~ 4mm を確実に充填させます。
7. 歯冠部側は歯科用根管充填シーラを塗布し、本品を少しずつ加熱しながら、プラガーで加圧して充填します。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1. 本品を使用する前に必ずアルコールなどで消毒すること。
2. 使用するファイルシステムの取扱い方法に従い、根管拡大形成を行うこと。
3. 側方加圧法により充填させる場合は、通法のとおりスプレッダーを用いて凝縮させ、必要に応じてアクセサリーポイントを使用すること。
4. 同一歯牙の複数根管に充填する場合は、シーラを全ての根管に同時に塗布すること。
5. 高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌は行わないこと。
6. 完全抜髄した歯髄に対して適用すること。

**【使用上の注意】**

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
(1) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
(2) 本品は再使用しないこと。
(3) 本品を根管内に装着する時、根尖孔から突出させないよう、十分注意すること。
(4) 本品を根管充填した後の数日間、打診痛が出る場合があります。

**【保管方法及び有効期間等】**

［保管の条件］
本品は、直射日光及び高温多湿を避けて涼しい場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**


製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
＊＊製造国　スイス
＊＊／＊製造業者　メルファー　インスツルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
＊＊電話番号　0120-667-467