*２０２１年０７月０１日(第７版)
**２０２１年１０月０１日(第８版)

*機械器具（１３）聴診器

機械式聴診器

聴診器ダブル

届出番号　１２Ｂ２Ｘ１００１１０００００４

一般医療機器

ＪＭＤＮ：１３７５５０００

[禁忌・禁止]

本品に強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。又、医療の目的以外では使用しないで下さい。

[形状・構造及び原理等]

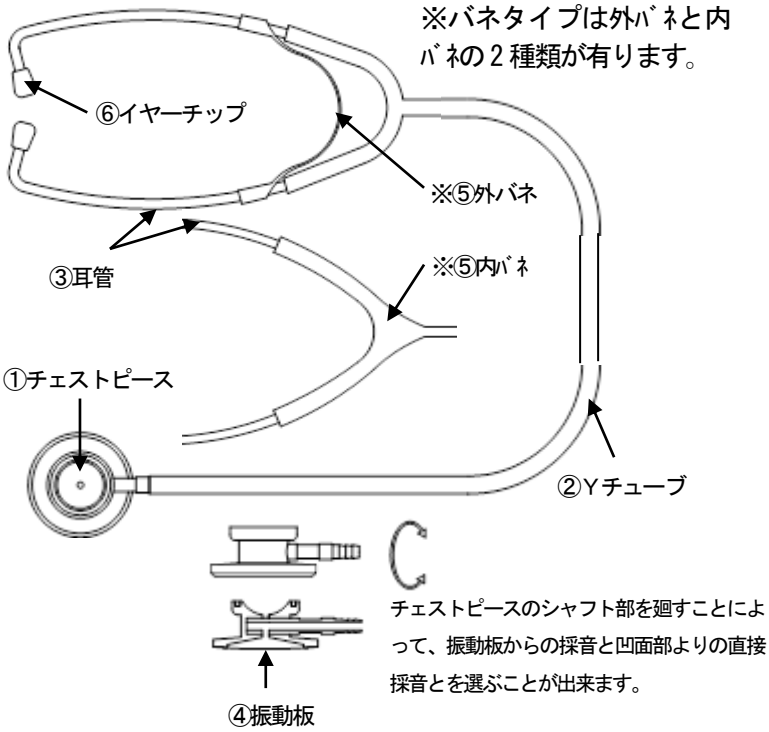

チェストピースのシャフト部を廻すことによって、振動板からの採音と凹面部よりの直接採音とを選ぶことが出来ます。

名称	材質	寸法
①チェストピース	アルミニュウム合金	直径46mm×20mm
②Ｙチューブ	塩化ビニール	直径8mm. 長さ60cm
③耳管	真鍮、クロームメッキ	直径5mm
④振動板　**	テトロン繊維入りエポキシ樹脂　又は　PVC	直径43mm, 厚さ0.2mm
⑤バネ	鋼	厚さ0.7mm
⑥イヤーチップ	塩化ビニール	直径12×13mm

《原理》

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置であり、振動板からの採音と凹面部よりの直接採音する構造である。

[使用目的又は効果]

本品は、心臓及び肺の音を採音し、医師等による診断に用いる汎用聴診器である。

[使用方法等]

１．①チェストピース、②Ｙチューブ、③耳管の各部品をしっかりと連結します。
２．耳管部イヤーチップを両耳に差し込み　チェストピースの振動板を人体の皮膚に押し当てて聴診します。

[使用上の注意]

１．チェストピースの変形、Ｙチューブの劣化、耳管の破損等直接聴診に影響を与える部品は必ず交換してください。
２．無理にバネを広げると閉じにくくなり変形する恐れがあります。
３．聞こえにくい場合は、当てる向きを変えるか、バネを固定し耳管をゆっくり回し微調整を行ってください。

[保管方法及び有効期間等]

使用環境：温度10℃-40℃　　湿度30%-75%（結露無し）
保管環境：温度 -5℃-50℃　　湿度30%-85%（結露無し）
高温、多湿、直射日光は避けて保管してください。
標準的な使用期間の目安：３年　（自己認証による）

[保守・点検に係る事項]

１．各部品の消毒は消毒用アルコールの清拭でお願いします。
　又、シンナーなどの有機溶剤での拭取りはしないでください。
２．取り外しの出来るイヤーチップ、Ｙチューブは軟質の石鹸水で洗ったあと乾いた布等でよくふき取ってください。

[包装]

包装単位　１個

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等]

製造販売業者名　株式会社　三　　恵
住　　所　千葉県市原市八幡海岸通１９６９－３３，３４
電　話　番　号　０４３６－４１－１８２０