機械器具（１３）聴診器

機械式聴診器

ティーチング聴診器シングル

届出番号　１２Ｂ２Ｘ１００１１０００５２

一般医療機器

ＪＭＤＮ：１３７５５０００

*２０２１年１０月０１日（第５版）
**２０２６年０９月０４日（第６版）

[禁忌・禁止]

本品に強い衝撃を与えますと変形する恐れがあります。又、医療の目的以外では使用しないで下さい。

[形状・構造及び原理等]

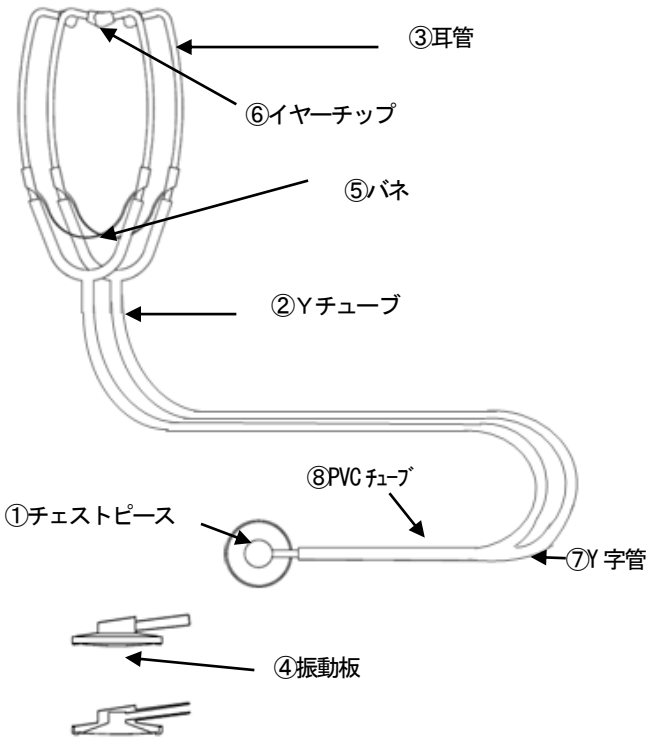

名　小	材　質	寸　法
①チェストピース	アルミニュウム合金	直径 46mm×20mm
②Ｙチューブ	塩化ビニール	直径 8mm. 長さ各 60cm
③耳管	真鍮、クロームメッキ	直径 5mm
④振動板　＊	テフロン繊維入りエポキシ樹脂　又は　PVC	直径 43mm, 厚さ 0. 2mm
⑤バネ	鋼	厚さ 0. 7mm
⑥イヤーチップ	塩化ビニール	直径 12×14mm
⑦Y 字管**	塩化ビニール	直径 6. 5 x 55mm
⑧PVC チューブ**	塩化ビニール	直径 8mm 長さ 53cm

《原理》

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置であり、振動板から直接採音する構造である。

[使用目的又は効果]

本品は、心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置である。
又、臨床・病棟活動に用いる汎用聴診器である。
主に教育用に採音を共有するために使用する。

[品目使用]

本品は採音部で採った音を耳に伝える。

[使用方法等]

1. ①チェストピース、②Ｙチューブ、③耳管、⑦Y 字管、⑧PVC チューブの各部品をしっかり連結します。**
2. 耳管部イヤーチップを両耳に差し込み　チェストピースの振動板を人体の皮膚に押し当てて聴診します。

[使用上の注意]

1. チェストピースの変形、Ｙチューブの劣化、耳管の破損等直接聴診に影響を与える部品は必ず交換してください。

[保管方法及び有効期間等]

使用環境：温度 10℃-40℃　　湿度 30%-75%（結露無し）
保管環境：温度 -5℃-50℃　　湿度 30%-85%（結露無し）
高温、多湿、直射日光は避けて保管してください。
標準的な使用期間の目安：３年　（自己認証による）

[保守・点検に係る事項]

1. 各部品の消毒は消毒用アルコールで清拭してください。
シンナー等の有機溶剤での拭取りはしないでください。
2. 取り外しの出来るイヤーチップ、Ｙチューブは軟質の石鹸水で洗ったあと乾いた布等でよくふき取ってください。

[包装]

包装単位　１個

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等]

製造販売業者名　株式会社　三　　恵
住　　所　千葉県市原市八幡海岸通１９６９－３３，３４
電　話　番　号　０４３６－４１－１８２０