2016年01月　第2版（新記載要領に基づく改訂）　23B2X00038000012
2007年02月08日　（第1版）

機械器具　４９　医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器　歯科用根管リーマ（31875001）

ジーシー　リーマ

【形状・構造及び原理等】

形状

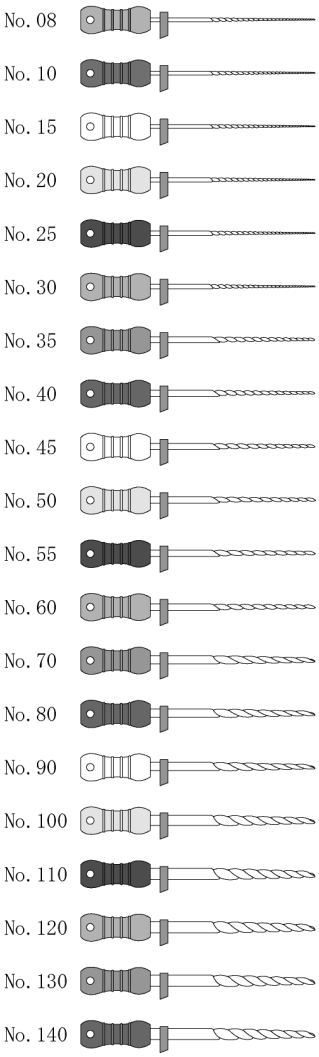

太さ：＃08、＃10、＃15、＃20、＃25、＃30、＃35、＃40、＃45、＃50、＃55、＃60、＃70、＃80、＃90、＃100、＃110、＃120、＃130、＃140
長さ：21㎜、25㎜、28㎜

１パック＝６本

＃15・20・25・30・35・40	各１本
又は＃08～＃40	単一形態６本、
＃45・50・55・60・70・80	各１本
又は＃45～＃140	単一形態６本

材質
針：ステンレススチール
柄：ナイロン樹脂

原理
・回転操作により、根管内をサイドカットして拡大する。

【使用目的又は効果】

本品は手用の歯科用リーマ（国際規格型）であり、根管拡大に用いる。

【使用方法等】

通法に従い、回転操作し、根管拡大に用います。

［使用方法に関連する使用上の注意］
１）使用中はしっかり保持して、患者の口腔内に落下させないようにすること。（特にじっとしていることができない子供などの場合には、誤飲防止のため、ラバーダムの装着をお勧めします。）
２）破折の原因となるため、無理な角度や力で操作しないこと。

【使用上の注意】

１）使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
①薬剤、食品、アクセサリー、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

２）重要な基本的注意
①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②ステンレススチールに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
④術前に必ず滅菌してから使用すること。
⑤根管内での破折を防ぐため、使用前には必ず針の点検を行い、異常のないものを使用すること。また、術中に針の劣化などが見られた場合、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。
⑥本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑦本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
・本品は錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しない。
・本品は湿度の高い場所に長時間保管すると錆びる恐れがあるので、乾燥した場所に保管する。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

［使用者による保守点検事項］
１）再使用する際には、清掃液を用いて付着物を除去し、滅菌を行う。
２）塩素系などの金属腐食性の高い薬液での消毒は行わない。その他の消毒薬で長時間浸漬する場合は錆びる恐れがあるので、防錆剤を添加する。
３）オートクレーブ滅菌するときは、熱によるハンドル部の変質を防ぐため、135℃以下に温度設定する。
４）清掃液・滅菌器については各製造業者の指示に従い、正しく使用する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元　：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元　：株式会社ジーシー
住所　：〒113-0033
東京都文京区本郷３丁目２番14号
電話番号　：（お客様窓口）0120-416480

13000519
08026400