

機械器具 (58) 整形用機械器具  
一般医療機器 靱帯・腱手術用器械 (JMDN コード : 70966001)

## VersaLok インスツルメンツ

### 【形状・構造及び原理等】

1. 本品は靱帯再建術等の靱帯又は腱手術に用いる再使用可能な未滅菌の手術器械である。本品は アンカー (販売名 : VersaLok アンカー、承認番号 : 22200BZX00688000) とともに用いるように設計されている。

2. 外観

ガン

オウル



製品番号 : 214710



製品番号 : 214711

3. 直接体液に接触する部分の原材料

ガン : ステンレス鋼 (ニッケル、クロムを含む)

オウル : ステンレス鋼 (ニッケル、クロムを含む)

### 【使用目的又は効果】

本品は、靱帯再建術等の靱帯又は腱手術に用いる手術器械である。

### 【使用方法等】

1. 本品は未滅菌で提供されるため、使用前に以下の推奨滅菌方法又は本品使用施設指定の滅菌方法及び滅菌条件にて滅菌して使用すること。なお、滅菌を行う際は、温度が 137℃を超えないようにすること。

#### ＜滅菌方法及び滅菌条件＞

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 滅菌方法 | 高圧蒸気滅菌 (プレバキューム型)                       |
| 滅菌条件 | 温度 132℃ 4 分間以上 又は<br>温度 134～137℃ 3 分間以上 |
| 乾燥時間 | 30 分                                    |

2. 操作方法

- (1) アンカーを挿入する部分の骨表面が固い場合は、アンカーの挿入を妨げないよう、オウルで骨孔を作成します。
- (2) アンカーの添付文書に従い、アンカーを骨に挿入します。挿入時にエンドキャップをシャフトに装着した場合は取り外します。ガンのロック/リリースボタンがロックポジションになっていることを確認した後、ガンをアンカーのインサーターに沿わせ、「カチッ」という音がしてインサーターシャフトとガンがしっかりと合はまるまで押し進めます。
- (3) ガンを前方に軽く押ししながら、縫合糸を引いて修復箇所を引き寄せます (図 1(a))。縫合糸に張力をかけた状態でガンのテンションホイールに縫合糸をセットします。縫合糸をテンションホイールにセットするときは、縫合糸の両端に同じ力がかかるようにします。縫合糸をテンションホイールに時計回りに 1 回転させ、1 度強く引いてテンションホイールに巻きつけます (図 1(b))。テンションホイールを時計回りに回転させ、縫合糸にさらに張力をかけていきます。最大で 2 本の縫合糸をテンションホイールにセットできます。

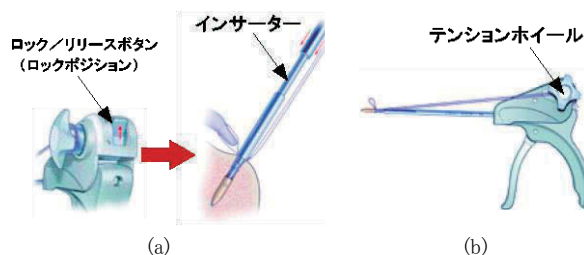


図 1

- (4) ガンを軽く押ししながらガンのトリガーを引いて、アンカーピンをスリーブ内に装填します (図 2)。



図 2

- (5) テンションホイールのロック/リリースボタンを押し下げて縫合糸を開放します (図 3)。



図 3

- (6) ガンをインサーターシャフトからゆっくりと外します。その際、必要に応じて縫合糸を把持します。

3. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 万一本品が術中に破損した場合は、本品を術部から慎重に引き抜き破片を術部から注意して取り除くこと。
- (2) 本品の滅菌は正しく整備、校正およびバリデーションされた高圧蒸気滅菌器を使用し、推奨滅菌方法を参考に行うこと。
- (3) 骨孔作成用の本品は必ず適合するドリルガイドと併用すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 術中医師及び手術室スタッフは本品の鋭利部 (刃先) などの取扱いに充分注意を払い、偶発的な穿孔事故などを防止するよう対策を施すこと。
- (2) 強アルカリ又は強酸性洗剤および塩素系及びヨウ素系の消毒剤は本品を腐食させるおそれがあるので使用を避けること。これらの消毒剤が付着した場合は直ちに水洗いすること。
- (3) 本品に過剰な力を加えないこと。

#### 2. 不具合・有害事象

- (1) 重大な不具合
- 1) 破損・変形
- (2) 重大な有害事象
- 1) 感染
- 2) 塞栓 (脂肪、血液、組織片など)

- 3) 骨折
- 4) 過敏症

(3) その他の有害事象

- 1) 関節部の亜脱臼又は転位
- 2) 関節部の一過性又は永続性の神経障害
- 3) 血管損傷
- 4) 体内遺残

3. 高齢者への適用

高齢者は、骨粗鬆症などにより骨が脆くなっている場合があります、術中に過度の力を加えることにより、骨折やインプラント埋没後の緩みや脱転などを起こす可能性が高いため慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・ 必要に応じて、複数の機器をセットとして保管する場合は、セット用の機器トレーを使用すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品使用後はできるだけ早く以下の手順に従って洗浄、すすぎなどの付着物除去を行い、血液、体液、薬液、組織などの異物が付着していないことを目視で確認した後、滅菌を行い保管すること。
2. 付着物除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 強アルカリ／強酸性洗剤及び消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジなどを使用し、金属ブラシ、クレンザー（磨き粉）は本品の表面が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しないこと。
4. 本品にスレッド又は中内腔がある場合は、やわらかいナイロンブラシを用いて十分洗浄すること。
5. 自動洗浄装置を使用するときには、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
6. 自動洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順は使用する洗浄装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
7. 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥させること。できるだけフィルターを通した圧縮空気を用いて内部を乾燥させること。
8. 付着物除去及び洗浄後は、【使用方法等】に示す滅菌方法及び滅菌条件を参考に滅菌を行い保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

**ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社**

電話：03-4411-7911

製造業者：

デピュー マイテック社 (DePuy Mitek) 米国