

**2025年12月改訂（第12版）
*2022年3月改訂（第11版）

医療機器承認番号：21400BZY00056000

医療用品4. 整形用品
高度管理医療機器 人工膝関節脛骨コンポーネント (JMDNコード：35669000)

P. F. C. Σ RP 人工膝関節システム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止

**

<適用対象（次の患者には使用しないこと）>

- (1) 局所または全身の進行性の感染症のある患者〔患部に病巣が移り、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (2) 膝関節を構成している筋肉、靭帯や関節神経の欠如等の、筋組織の作用喪失、神経疾患による筋肉と神経の相関作用喪失、または循環障害のある患者〔患肢の治癒を妨げ、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (3) 骨粗鬆症、骨質不良の患者のうち、インプラントのシンキング及びマイグレーションや大腿骨骨幹部の骨折の可能性がある、またはインプラントを支持する骨が十分ではないと医師が判断した患者〔埋植したインプラントを支持できないことがある〕
- (4) 高度の骨欠損あるいは骨萎縮又は骨変形のある患者〔本品を適切に固定できず良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (5) 本品の材質、成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- (6) 高度の軟骨構造の消失または側副靭帯の欠如により二次的に起こる、重度の膝の不安定性のある患者〔軟部組織の質または量が不十分の場合には、良好な埋植結果を得られないことがある〕
- (7) 骨髓炎、骨化性筋炎または、膝関節における著明な塞栓が認められる患者〔本品を適切に固定できず良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (8) X線撮影にて、急速な骨破壊や骨吸収が認められる患者〔本品を適切に固定できず良好な埋植結果が得られないことがある〕

【形状・構造及び原理等】

本品は、関節機能再建を目的として、人工膝関節置換術の実施時に使用する人工膝関節脛骨コンポーネントであり、インプラントとして使用する。

本品は、脛骨側に使用する全置換用のコバルト-クロム-モリブデン合金製の脛骨トレー及び超高分子量ポリエチレン製の脛骨インサートからなり、既承認品〔例：販売名「P. F. C. 膝関節システム」、承認番号

「16300BZY00109000」中の大腿骨コンポーネント等と組合せて使用する。

脛骨トレーと脛骨との固定には、骨セメントを使用する。

1. 形状・構造等

(1) 脣骨トレー

品名	形状	サイズ
M.B.T. セメント 脣骨トレー		1 1.5 2 2.5

M.B.T. セメント キール 脣骨トレー		3 4 5 6 7
材質：コバルト-クロム-モリブデン合金		

(2) 脣骨インサート

品名	形状	サイズ
Sigma/Univ RP カーブド 脣骨インサート		1.5, 10mm 1.5, 12.5mm 1.5, 15mm 1.5, 17.5mm 2, 10mm 2, 12.5mm 2, 15mm 2, 17.5mm 2.5, 10mm 2.5, 12.5mm 2.5, 15mm 2.5, 17.5mm 3, 10mm 3, 12.5mm 3, 15mm 3, 17.5mm 4, 10mm 4, 12.5mm 4, 15mm 4, 17.5mm 5, 10mm 5, 12.5mm 5, 15mm 5, 17.5mm 6, 10mm 6, 12.5mm 6, 15mm 6, 17.5mm
Sigma/Univ RP スタビライズド 脣骨インサート		

材質：超高分子量ポリエチレン

2. 原理

脣骨トレー：脣骨インサートを取り付け、支える。膝関節にかかる荷重を支持するために使用する。

脣骨インサート：近位脣骨側の患った関節面を補い、膝関節にかかる荷重を緩衝する。大腿骨コンポーネントとともに膝関節機能を再建し、膝関節の異常運動を制御し、安全性を保つために使用する。

** 【使用目的又は効果】

本品は、コンポーネントを設置し、支持するための十分な骨を有すると判断される患者の損傷した膝関節を置換することを目的とする。

本品は、骨格が成熟した患者のうち、以下の適応の患者に使用する。


1. 变形性関節症による重度の疼痛及び/又は関節炎を伴う関節
2. 過去の膝関節手術の不成功

* 【使用方法等】

本品は、関節機能再建を目的として、人工膝関節置換術の

手術手技書を必ず参照して下さい

実施時にインプラントとして使用する。本品の1. 脛骨トレーの上に、2. 脂骨インサートを組み合わせ、弊社既承認品[例:販売名「P. F. C. 膝関節システム」、承認番号16300BZY00109000]の大腿骨コンポーネントと組み合わせて使用する。

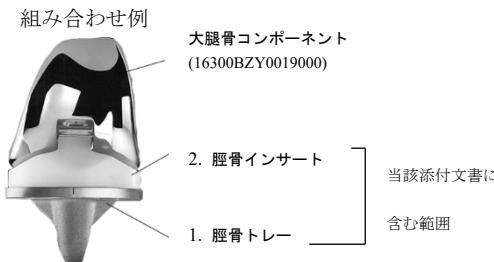

本品の1. 脂骨トレーと骨との固定には、骨セメントを使用する。本品は再使用しないこと。また、置換術にあたっては、適切なトライアルと手術器械を使用して正確かつ最適なサイズのインプラントを慎重に選択すること。

使用方法例

- 下肢のX線検査と診断を行い、適切な本品サイズを選択する。
- 専用器械を用い、以下の手術手順にて置換術を行う。
 - 大腿骨髓腔へのドリリング及びIM(髓内)ロッドの挿入



2) 大腿骨遠位部の骨切除



3) 大腿骨コンポーネントのサイジング及び回旋アライメントの決定



4) 大腿骨頸部前面、後面及びチャンファー(面取り)部の骨切除



5) 脂骨近位端の骨切除(EM(髓外)式及びIM(髓内)式)



6) 膝蓋骨の形成



7) トライアルによる試整復



8) セメントの準備

9) インプラントの設置

- 関節内を十分に洗浄し、吸引ドレーンを留置して通常の方法で膝創部を閉鎖し、術後管理を行う。

<サイズの互換性について>

コンポーネントのサイズ適合性については、機能不全、ゆるみ、摩耗、破損または早期不全をきたす場合があるので、下記の適合表に従うこと。脂骨インサートのサイズは、大腿骨コンポーネントのサイズと一致させること。

脛骨トレーのサイズ

	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7
脛骨インサートのサイズ	●	●	●						
1.5									
2		●	●	●					
2.5			●	●	●				
3				●	●	●			
4					●	●	●		
5						●	●	●	
6							●	●	●

<組み合わせて使用する医療機器>

構成品	販売名	医療機器承認番号等
大腿骨コンポーネント	P. F. C. 膝関節システム	16300BZY00109000
	S i g m a C R 1 5 0 人工膝関節システム	22300BZX00069000
	P. F. C. シグマ R P F 人工膝関節システム	21600BZY00467000
	S i g m a P S 1 5 0 人工膝関節システム	22300BZX00476000
	シグマ PS 大腿骨コンポーネント	22700BZX00107000
インサート	P. F. C. Σ R P 人工膝関節システム	21400BZY00056000
	P. F. C. シグマ R P F 人工膝関節システム	21600BZY00467000
	L C S コンプリート ベアリング	21600BZY00629000
	P. F. C. Σ R P 人工膝関節システム	21400BZY00056000
トレイ	P. F. C. Σ R P 人工膝関節システム	21400BZY00056000
	L C S コンプリート 人工膝関節システム	22300BZX00003000
	M B T モジュラーシステム	22400BZX00425000

** <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 術前の注意

- (1) 医師は、術前に患者と手術に伴う当該患者の身体的、精神的な制限、手術内容、人工関節について患者に説明し、患者の同意を得ること（インフォームドコンセントを実施すること）。その際に、人工関節の限界とその使用により起こり得る事象、医師の術後指示に従う必要性、特に体重の問題と活動の制限について説明を加えること。なお、人工関節の機能寿命は現時点では明確に確立されていない。体重や活動レベルなどの要因が製品の摩耗に影響を与えることを患者に伝える必要がある。
- (2) 医師は、患者が以下の条件を満たしているときのみ、本品による人工膝関節置換術を実施すること。
 - 1) 大腿骨、脛骨間の関節面の重度の関節症
 - 2) 側副靱帯が安定しているか再建可能である
 - 3) 荷重軸が正しいまたは修正可能である
 - 4) 大腿四頭筋およびハムストリングが完全である
- (3) 術中に適切なサイズのインプラントを選択できるように、術前に決定したサイズの前後のサイズのインプラントも併せて準備しておくことが望ましい。

2. 術中の注意

- (1) インプラントのゆるみ、変形による機能障害や骨吸収、再置換手術を避けるために、骨切除の量及び複数のピンの使用はインプラント埋植に必要な最小限とすること。
- (2) 保護カバーは、インプラントの埋植直前まで取り外さないこと。
- (3) 本品は適切なサイズを決定した後に無菌操作により滅菌済み包装から取り出すこと。
- (4) コーティング表面への纖維接着による異物混入を避けるため、コーティングされたコンポーネントと衣服、または他の纖維製材料との接触は避けること。
- (5) 使用前に全てのテープ一面とスレッド面が清潔で乾燥した状態であることを確認すること。
- (6) インプラントを落としたり硬いものにぶつけた後は、使用しないこと。目に見えない破損が生じている可能性があり、術後早期のゆるみ等の埋植の失敗が起こり得る。
- (7) 試整復時には、適切なアライメントが得られているかを必ず確認すること。
- (8) インプラントの不適切な設置・アライメントはインプラントに異常な負荷をかけ、その寿命を短縮するおそれがあるので注意すること。
- (9) 再置換手術の際には、新しいインプラント固定が妨げられないように、骨切除面に残存する纖維性組織を完全に除去すること。また、骨セメントにより固定されている場合には、骨折に注意しながら骨セメントを完全除去すること。
- (10) インプラント摺動面の異物は過剰な摩耗につながるため、摺動面に異物等がないかをよく確かめること。また、試整復にてインプラント同士の不安定性やインビンジメントがないことを確認すること。
- (11) 縫合前に、手術部位から骨片、余剰な骨セメント、異所性骨を除去すること。異所性骨および/または骨棘により、脱臼や痛みを伴い動きが制限される可能性がある。
- (12) 膝蓋骨を含む可動範囲全体において、不適切な嵌合、不安定性、またはインビンジメントについての確認を行い、適切に修正を行うこと。

3. 術後の注意

- (1) 医師は、患者の退院時に、患者にリハビリのための運動、今後の治療についての指示、生活上の運動制限などの注意事項を文書等で患者に喚起すること。また、患者に、体重や活動性等が、インプラントの

摩耗の要因として著しく影響することを知らせるこ
と。

- (2) 医師は患者に、インプラントの位置変化や摩耗を引き起こすような過度の運動や外傷に注意よう指示すること。
- (3) 定期的な経過観察は必須であり、医師は検診時にX線撮影を行い、前回のX線検査と比較して患者の臨床所見と見比べて検討すること。骨透亮像、骨吸収またはインプラントの位置変化などが観察された場合、それらが静止状態なのか進行性なのかを見極め、それに応じて患者の治療を実施すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ** (1) 以下の患者は、患肢に過度の荷重がかかる傾向があり、人工膝関節置換術の失敗のリスクが高い。
- 1) 肥満症及び体重過多の患者【患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となることがある】
 - 2) 重労働、激しいスポーツ等の活動性の高い患者【患肢に過度の負担がかかり、インプラントの緩み、脱転、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となることがある】
 - 3) 転倒の可能性の高い患者【転倒により、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの緩み、脱転、摩耗、折損、骨折等によるインプラントの位置の修正や、再置換手術が必要となることがある】
 - 4) アルコールまたは薬物中毒の患者【リハビリテーション等の術後管理が不十分になることにより、患者の術後回復が遅れることがある。また、無防備な状態で転倒したり不良肢位を取る可能性が高いため、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの緩み、脱転、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となりやすい】
 - 5) 必要に応じ、その他障害を有する患者【患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となることがある】
- (2) 上記に加え、以下の身体状態は人工膝関節インプラントの固定に悪影響を与える恐れがある。
- 1) 著しい骨粗鬆症またはインプラントを支持する骨量が減少する可能性のある発育性骨形成不全症を有する患者【インプラントが固定不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある。また、患肢に負荷がかかり、良好な埋植結果が得られないことがある】
 - 2) 糖尿病等の代謝障害がある患者【インプラントを支持できなくなるおそれがある。また、感染が起こりやすく、患肢の遷延治癒等が起こり得る】
 - 3) ステロイド療法、免疫抑制療法等の全身薬物療法を受けている患者【インプラント固定の不良により、良好な埋植結果が得られないことがある。また、こうした患者は、関節周囲の骨粗鬆症により、術後骨折が起こりやすい。さらに、抵抗力が弱いので感染が起こりやすい】
 - 4) 全身または局所の感染症の病歴のある患者【手術後しばらくしてから、感染に弱い人工関節の部分に病巣が移ることにより、インプラントの固定が不良となり、インプラントの再置換手術が必要となることがある】

- 5) 重度の変形のある患者〔インプラント固定の不良や不適切なアライメントにより、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- 6) 支持骨に骨腫瘍のある患者〔インプラント固定が不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- 7) インプラントの腐食、またはインプラント摩耗粉に対する組織反応のある患者〔インプラント固定が不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- 8) 他の関節（股関節や足関節）に障害のある患者〔インプラント固定が不良となり、良好な埋植結果が得られないことがある。また、患肢に負荷がかかり、良好な埋植結果が得られないことがある〕
- (3) 医師の指示を遵守できない患者または精神障害のある患者〔リハビリテーション等の術後管理が不十分になることにより、患者の術後回復が遅れることがある。また、無防備な状態で転倒したり不良肢位を取る可能性が高いため、患肢に過度の負担がかかり、インプラントの位置変化、摩耗、折損等によるインプラントの再置換手術が必要となりやすい〕
- (4) 再置換手術の患者〔手術時間が初回の置換術と比較し長いこと、切開の位置の難しさ、異所性骨と骨セメントの除去、インプラントの配置や固定、十分な支持骨の獲得の困難、出血多量等により、有害事象の発現頻度及びその重症度が初回手術の患者より大きくなる傾向がある〕
- (5) 現在のところ、糖尿病は禁忌として設定されていない。ただし、重症糖尿病患者に対する人工膝関節置換術の実施については慎重に検討すること。〔感染症、創傷治癒遅延等の合併症のリスクが増加する可能性がある〕

** 2. 重要な基本的注意

- * (1) 後十字靭帯の有無、A/P 及び M/L の安定性、必要とされる大腿骨や脛骨の補綴処置及び脛骨用及び大腿骨システムあるいはフルートロッドによる人工的な固定補強の必要性を考慮して、大腿骨コンポーネント及び脛骨コンポーネントを選択すること。
- (2) 本品を埋植することにより、患者の関節可動域が制限されることがある。
- (3) 関節外感染（例：肺炎、尿路感染、経皮感染、う歯、歯周病、蓄膿、または歯科治療や侵襲性の検査における細菌感染）のある患者において、本品埋植後しばらくしてから、病巣が本品埋植部位に転移し感染することがある。
- (4) 手術後の屈曲角度は、当該品の埋植により保証されるものではなく、手術手技や患者の状態、術前の屈曲角度、患者の年齢等の様々な要因が関係している。
- (5) **MRI 安全性情報**

非臨床試験によって、以下の条件において本品を装着した患者に対して MR 装置を用いてスキャンを実施することが可能であることが示されている。 (自己認証による) これらの条件に従わない場合、患者に障害をもたらす可能性がある。	
販売名	P. F. C. Σ RP 人工膝関節システム
公称静磁場強度[T]	1.5 T または 3.0 T
最大空間磁場勾配 [T/m 及び gauss/cm]	32 T/m (3200 gauss/cm)
ラジオ波 (RF) 励起	サーチュラリーポラライズド (CP)
ラジオ波 (RF) 送信 コイルタイプ	全身送信コイル、送受信ヘッドコイル
1.5T および 3.0T における全身の最大 SAR	2.0 W/kg

〔W/kg〕	
スキャン時間の制限	2.0 W/kg 全身平均 SAR にてスキャンを最長 15 分間実施した後、15 分間冷却する（1 回のイメージングセッションで最長 3 回繰り返すことができる）
アーチファクト情報	本インプラントがあつても 158 mm を超えるアーチファクトは生じない。

** 3. 不具合・有害事象

(1) 重大な不具合

- 1) 折損：本品に金属疲労によりひびが入ったり、折損する場合があるので、観察を十分に行い、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 2) 破損、摩耗、ゆるみ：経時的に摩耗が生じ、破損やゆるみが生じる場合がある。また、一時的であっても過度な応力を受けることにより摩耗、破損、ゆるみが生じる場合がある。さらに、脛骨インサート、膝蓋骨コンポーネントが摩耗し、ポリエチレンの摩耗粉が骨とインプラントの間に入り込むことにより骨溶解を生じ、インプラントのゆるみが発生し、荷重時の疼痛や支持性が悪化することがある。さらに、これらのゆるみにより荷重が集中し、インプラントが破損したり、インプラント周辺骨において術後骨折が起こることがあるので、術後の経過観察を十分に行い、インプラントを抜去し、再置換を実施する等の適切な処置を行うこと。

(2) その他の不具合

- 1) 金属製インプラントの腐食
2) インプラントの脱転、位置変化

(3) 重大な有害事象

- 1) 早期感染：発熱、埋植部位の疼痛、熱感、腫脹、発赤、術後創からの持続的な滲出液などが現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。（早期感染は、術中の感染または静止感染が原因であると考えられている）
- 2) 遅発性感染：埋植部位の熱感や腫脹などの炎症所見が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。（遅発性感染は、他の感染巣からの血行感染または術後の抗生素の使用により、細菌の活動が抑制され、術後早期には症状が発現せず、遅れて感染症状を示す場合が考えられている。深部感染では、インプラントの抜去、再置換を含む外科的な治療が必要になる場合もある）
- 3) 塞栓（脂肪、空気、血液等）：脳塞栓においては半身の麻痺、感覺の低下、意識障害が、肺塞栓においては呼吸困難や強い全身倦怠感、胸部痛、咳が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 4) 深部静脈血栓症及び心筋梗塞などの心血管疾患：腹部の浮腫、熱感、腫脹、倦怠感が現れることがあるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 5) 術中骨折及び骨穿孔：術中に、埋植部位の処置が不適当であったり、インプラントの埋植操作中に過度の力を加えると、術中骨折及び骨穿孔が起こるおそれがあるので、観察を十分に行い、異常が認められ

- た場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 6) 術後骨折：術後に、外傷や患肢への過度の負荷、重度の骨粗鬆症、骨吸収や骨質不良、再置換手術においては前回の置換術時の骨欠損等により、インプラント周辺部及び膝蓋骨の骨折が発生するおそれがあるので、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 7) 金属アレルギー：創部のアレルギー性接触皮膚炎、アレルギー性肉芽腫、また、創部以外の部位のアレルギー反応が現れる場合があるので、異常が現れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- 8) 骨吸収：骨に適切な応力が加わらなくなり、インプラント周囲の骨が廃用萎縮により吸収されてインプラントがゆるんだり、シンキング、破損する場合があるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- (4) その他の有害事象
- 1) 神経障害、神経損傷
 - 2) 骨化筋炎
 - 3) 金属腐食、金属アレルギー、摩耗粉、セメント粉による組織反応
 - 4) 骨溶解
 - 5) 血管損傷
 - 6) 軟部組織（筋、靱帯、腱）の損傷
 - 7) 脱臼、亜脱臼
 - 8) 血腫
 - 9) 遷延治癒、創離開
 - 10) 内外反変形
 - 11) 脚長差及び脚長差により引き起こされる反対側の障害
 - 12) 屈曲拘縮、過伸展
 - 13) 異所性の骨形成、関節周囲の石灰化または骨化及び、それに伴う関節可動性及び可動域の低下
 - 14) 疼痛
 - 15) 膝の不安定性
 - 16) 過剰な張力または術中の不注意による膝蓋骨骨折
 - 17) 不適切なコンポーネントの選択、設置位置不良、インピングメントによる不十分な関節可動範囲
 - 18) 患肢の延長または短縮

4. 高齢者への適用

- (1) 高齢者には、術中骨折あるいは骨穿孔を起こす可能性が高いので慎重に使用すること。また、術後、転倒等により術中の過剰な骨切除に起因する骨折が起きる可能性が高い。[高齢者は、骨粗鬆症を伴っている場合が多い]
- (2) 高齢者には、術前、術中、術後の全身管理に特に気をつけること。[高齢者は、全身性の合併症を有している場合が多い]

5. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等に対しては、特に、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。[妊婦、産婦、授乳婦及び小児等に対する安全性は確立していない]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

室温保存

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

使用期限は、外箱に表示 [自己認証(自社データ)による]

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

URL : jnj.co.jp

製造業者:

・ デピュー・オーソペディックス社

(DePuy Orthopaedics, Inc)米国