**2024年1月改訂（第3版）
*2017年5月改訂（第2版、新記載要領に基づく改訂）　　届出番号：17B2X10001000435

機械器具（69）歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器　歯科技工用重合装置　JMDNコード：35761000

アクアプレス

【禁忌･禁止】
1. 注意事項を厳守の上、使用すること。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】
1. 形状・構造
下記の通り

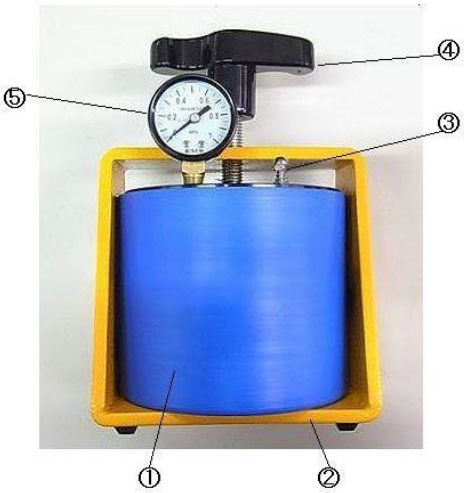

①	プレッシャーポット
②	フレーム
③	減圧弁
④	スクリューハンドル
⑤	加圧ゲージ

2. 包装
1個 / 箱

【使用目的又は効果】
本品は歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる装置で、水圧により重合を行う。

【使用方法等】
[使用方法]
1) スクリューハンドルを時計と反対に回してゆるめ、プレッシャーポットを本体から取り出す。
2) コンテナに水をすれすれまで満たし蓋を閉める。その際、空気がコンテナ内に入らない様に注意する。
3) ハンドルを時計回りに回し、加圧ゲージが0.4（MPa）以上になるようにセットする。（コンテナ内に空気が混入すると加圧がうまくいかないので、もう一度セットしなおすこと）
4) 材料の規定の重合時間が経過した後、減圧弁を押して内部の圧力を完全に抜いてから、ハンドルを回し蓋を開ける。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
1) 使用中は減圧弁に触れないこと。プレッシャーポット内の水が抜け、重合がうまくいかないことがある。
2) 減圧弁を押し、中の圧力を完全に抜いてから蓋をあけること。
3) 重合の際は、必ず水を用いること。
4) コンテナ縁のゴムが劣化すると、十分な加圧が得られない恐れがあるので、交換すること。

***【保管方法及び有効期間等】**
1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3) 保管中、損傷しないように注意すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Shin myung Dental co.（シンミュン　デンタル社）
製造国：大韓民国