*2024年1月改訂（第2版）
2015年5月作成（第1版）

届出番号：17B2X10001000826

機械器具（60）歯科用エンジン
一般医療機器　歯科技工用電気エンジン　JMDNコード：38611000

ローター７０２

【禁忌･禁止】
1. 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】
［形状・構造］
下記の通り

［包装］
本体+付属品一式／箱

【使用目的又は効果】
本品は歯科技工で用いる歯科技工用バー等の回転器具を接続するためのチャックを備えた1つのハンドピースからなる歯科用器具である。

【使用方法等】
ハンドモード選択時
1)チャックを開きハンドピース先端に歯科技工用バーを差し込んだ後、チャックを締めてバーを固定させる。(カチッと音がするまで必ず締めること)
2)ハンドピースをコントロールユニット正面に接続する。
3)電源コードをコントロールユニット背面にある接続口に接続する。
4)電源スイッチがオフ(停止の状態)にあることを確認し、電源コードをソケットに挿し込む。
5)スピード調節ダイヤル(図1-⑥)を最低速度に設定し、電源スイッチをオンにする。
6)正逆回転選択ボタン(図1-⑧)で回転方向を選択する。
7)ハンド/フットモード選択ボタン(図1-⑩)で「HAND」を選択する。(ハンド/フットモード表示LED(図1-⑨が点灯する。)
8)モーターオン/オフボタン(図1-②)をオンにする。
9)スピード調節ダイヤル(図1-⑥)で希望の速度に設定する。
10)試運転してバーに振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

フットペダルを使用する場合
1) チャックを開きハンドピース先端に歯科技工用バーを差し込んだ後、チャックを締めてバーを固定させる。(カチッと音がするまで必ず締めること)
2)ハンドピースをコントロールユニット正面に接続する。
3)フットペダルをコントロールユニット背面に接続する。
4)電源コードをコントロールユニット背面に接続する。
5)電源スイッチがオフ(停止の状態)にあることを確認し、電源コードをソケットに挿し込む。
6)スピード調節ダイヤル(図1-⑥)を最低速度に設定し、電源スイッチをオンにする。
7)正逆回転選択ボタンで回転方向を選択する。
8)ハンド/フットモード選択ボタン(図1-⑩)で「FOOT」を選択する。(ハンド/フットモード表示LED(図1-⑨)が消える)
9)スピード調節ダイヤル(図1-⑥)で希望の速度に設定する。
10)フットペダルをゆっくりと踏み込み、モーターを作動させる。試運転してバーに振れ等がなければ、口腔外で補綴物等を研削する。

＜図1＞

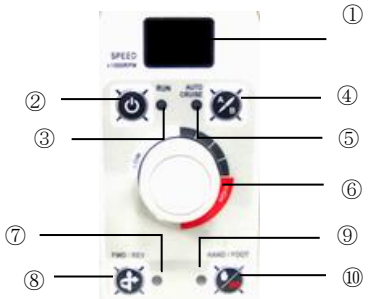

①	速度表示ディスプレイ	⑥	スピード調節ダイヤル
②	モーターオン/オフボタン	⑦	正逆回転表示LED
③	モーター　表示LED	⑧	正逆回転選択ボタン
④	オートクルーズボタン	⑨	ﾊﾝﾄﾞ/ﾌｯﾄﾓｰﾄﾞ表示LED
⑤	オートクルーズ表示LED	⑩	ﾊﾝﾄﾞ/ﾌｯﾄﾓｰﾄﾞ選択ボタン

［使用方法に関連する使用上の注意］
・無理な角度や過度な加圧での使用は避けること。
・ハンドピースを落としたりしないこと。万が一落としてしまった場合は、必ず使用前に再度、先端が曲がったり、過度の熱を帯びないか、テストすること。
・回転が確実にとまってから、終了すること。
・アダプターは専用のものを使用すること。

【使用上の注意】
1)使用前には必ず始業点検をすること。
2)本品を本来の使用目的以外には使用しないこと。
3)歯科の従事者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】
1)水のかからない場所に設置すること。
2)気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
3)歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：Saeyang　Co., Ltd.（セーヤン社）
製造国：大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。